

**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 615 DEL 09 APR. 2021**

**OGGETTO:** Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n. 2375068 (CIG 8015373F08), per l'acquisto di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca. Approvazione atti di gara ed aggiudicazione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 621 DEL 29/03/2021

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giuseppe Palumbo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Giuseppe Sanfilippo)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dott. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. P.M. 36481 DEL 30/3/21) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. Cai ordinat riferimento

C.E.

C.P.

A 101020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cell. Anni 330 700 800 0000  
e-mail: [giuseppe.sanfilippo@asprag.it](mailto:giuseppe.sanfilippo@asprag.it)

IL DIRETTORE U.O.C. S.P.E. e P.  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 31-03-2021

L'anno duemilaventuno il giorno NOVE del mese di APRILE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. TESSA CINQUE,  
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore dell'UOC Servizio Provveditorato, Dott. Oreste Falco**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

### **PREMESSO**

- ✓ CHE, con Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 07/08/2019, è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6 D. Lgs. 50/2016 – l'esperimento di apposita procedura negoziata – a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) – per l'affidamento della fornitura di n. 03 Sistemi per l'esecuzione di Test Cardiopolmonare, per le UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca, per un importo complessivo base di € 120.000,00=+IVA 22%, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- ✓ CHE con la suddetta Deliberazione è stata approvata il documento denominato "Condizioni particolari di contratto", che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti MEPA;
- ✓ CHE con la summenzionata Deliberazione, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto è stato nominato il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e che Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è stato nominato il Dott. Luciano Sutera Sardo, Direttore f.f. U.O. Cardiologia e UTIC del P.O. di Canicattì;
- ✓ CHE con la suddetta Deliberazione si è dato atto che l'onere per l'acquisto di che trattasi, pari presuntivamente ad € 120.000,00= oltre IVA e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e Regolamento Aziendale, al tempo in fase di revisione, come da seguente quadro economico:

Fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare	€ 120.000,00
IVA aliquota 22%	€ 26.400,00
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 2.400,00
Contributo ANAC	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 148.830,00</b>

è da iscrivere sul Conto Patrimoniale n. A101020501, giusta nota SEFP prot. N. 5155 del 09.01.2019 ed è finanziato con risorse del bilancio aziendale, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, con riserva di quantifi-

cazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

**ATTESO**

- ✓ **CHE**, in esecuzione della sopra citata delibera a contrarre, si è proceduto in data 27.08.2019 alla pubblicazione della RDO n. 2375068 (Cod. CIG 8015373F08), con pubblicazione del relativo avviso di indizione sul sito web aziendale, sezione Amministrazione Trasparente, conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ **CHE** in data 04.10.2019 ed in data 07.10.2019 sono stati resi i chiarimenti richiesti da alcuni Operatori Economici, che qui si allegano (All. A);
- ✓ **CHE** alla predetta RdO hanno presentato offerta n. 04 Ditte di seguito elencate:

Denominazione	P. Iva
Cosmed s.r.l.	01284691001
Carefusion Italy 237 s.r.l. Unip.	08086280156
Halsa Srl	03014960870
Medical Graphics Italia Srl	12642600154

- ✓ **CHE** constatata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, le suddette Società sono state ammesse alla fase di Valutazione Tecnica;
- ✓ **CHE**, con nota 179430 del 28.10.2019 che qui si allega (All. B) è stata nominata la Commissione Tecnica, incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse alla gara in oggetto;

**VISTI** i verbali della Commissione Tecnica, dai quali si evince:

- ✓ **CHE** in data 06.11.2019, la Commissione, esaminata la documentazione tecnica prodotta da alcune delle sopra riportate ditte, partecipanti ed ammesse, ha ravvisato la necessità di richiedere chiarimenti alle suddette Ditte, per le motivazioni riportate nell'allegata relazione di conformità tecnica (All. C);
- ✓ **CHE**, come da verbale del 06.12.2019, che qui si allega (All. D), la Commissione, esaminati i chiarimenti pervenuti dalle Ditte cui erano stati richiesti, nonché la documentazione tecnica prodotta dalle altre Ditte partecipanti, ha reso giudizio di conformità tecnica, per come riportato nell'allegata relazione di conformità tecnica summenzionata;
- ✓ **CHE**, preso atto del summenzionato giudizio di conformità tecnica, si è proceduto all'esclusione della Ditta Carefusion Italy 237 ed all'apertura delle buste economiche delle ditte rimanenti, rilevando il prezzo offerto dalle Ditte offerenti ed ammesse, per come di seguito riportato:

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
Cosimed s.r.l.	€ 70.719,15
Medical Graphics Italia Srl	€ 108.000,00
Halsa Srl	€ 110.400,00
Carefusion Italy 237	Esclusa

- ✓ **CHE** con pec del 17.12.2019, la Società Carefusion Italy 237, precedentemente esclusa, trasmetteva nota prot. 212080 richiedendo alla Commissione tecnica la revisione della valutazione espressa, per le motivazioni espresse nella suddetta nota;
- ✓ **CHE** con mail del 19.12.2019, questo Servizio trasmetteva la sopracitata nota della Società Carefusion Italy 237 alla Commissione Tecnica, perché potesse esprimersi in merito e per i conseguenziali provvedimenti:

- ✓ **CHE**, in data 17.01.2020, la Commissione Tecnica, come da allegato verbale (All. E), è tornata a riunirsi al fine di valutare l'istanza prodotta dalla predetta Società Carefusion 237, confermando il precedente giudizio di non conformità tecnica ed al contempo di richiedere ulteriori chiarimenti tecnici alla Ditta Cosmed, per le motivazioni nell'allegato verbale riportate;
- ✓ **CHE**, in data 27.02.2020, la Commissione, esaminati i chiarimenti e le controdeduzioni tecniche prodotte dalla summenzionata Ditta Cosmed, ha ritenuto di rivedere il giudizio di conformità precedentemente espresso, giudicando non conforme l'offerta della Ditta medesima, per le motivazioni riportate nell'allegata relazione di conformità tecnica (All. F)
- ✓ **CHE** con comunicazioni Mepa del 04.03.2020 e 24.03.2020, qui allegati (All. G) la suddetta Società Cosmed si opponeva a tale esclusione, per le motivazioni tecniche in dette comunicazioni riportate, trasmessi da questo servizio alla Commissione Tecnica per le valutazioni di competenza;
- ✓ **CHE** con nota prot. 91941 del 19.06.2020, non riscontrata, questo Servizio sollecitava il Presidente della Commissione Tecnica a dare definitivo riscontro alle superiori rimostranze, e ciò all'ovvio fine di concludere al più presto la procedura in oggetto;
- ✓ **CHE**, come da allegata relazione di conformità tecnica (All. H), la Commissione Tecnica è tornata a riunirsi in data 01.03.2021 al fine di riesaminare i sopraindicati rilievi tecnici prodotti dalla Società Cosmed e, ritenendoli fondati, ha espresso parere favorevole di conformità tecnica, per le motivazioni in detta relazione riportate;
- ✓ **CHE** in data 22.03.2021, a seguito di intervento tecnico richiesto al MePa e finalizzato a riammettere alla procedura la Società Cosmed, si è proceduto all'aggiornamento della stessa, per come deciso dalla Commissione Tecnica;

#### **DATO ATTO**

- ✓ **CHE** l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., è garantito anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- ✓ **CHE** risulta possibile proporre l'aggiudicazione della procedura di cui alla suddetta RDO/MEPA n. 2375068 (Cod. CIG 8015373F08) per la fornitura di n. 03 Sistemi per l'esecuzione di Test Cardiopolmonare, per le UU.OO. Cardiologia/Utic/Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca alla Società Cosmed S.r.l., avente sede legale in Viale Bruno Buozzi, 77 - 00193 Roma, con Cod. Fiscale n. 04646530586 e P. I.V.A. n. 01284691001, per l'importo complessivo di € 70.719,15=oltre iva 22%, alle condizioni indicate nelle Condizioni particolari di Contratto e nell'offerta della medesima Ditta, come risulta dall'allegato documento "Ricopilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generato dalla piattaforma MePa (All. I);
- ✓ **CHE** l'intervento di acquisto di che trattasi risulta inserito nel Piano degli investimenti relativo al triennio 2020/2021/2022 e che l'onere derivante dal presente atto, ammontante a € 87.507,06=iva e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 incluse, come da seguente quadro economico, aggiornato rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre, sia sulla base delle risultanze di gara, sia per adeguare la misura delle competenze interne a quanto definito dalla Delibera 1283/2020:

Fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare	€ 70.719,15
--	-------------

IVA aliquota 22%	€ 15.558,21
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 1.200,00
Contributo ANAC	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 87.507,36</b>

è da iscrivere:

- Per € 86.307,36 sul Conto Patrimoniale n. A101020501 del corrente Bilancio d'Esercizio, ed è finanziato con risorse del bilancio aziendale;
- Per € 1.200,00 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del corrente Bilancio d'Esercizio;

#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta RDO/MEPA n. 2375068 (Cod. CIG 8015373F08), come risultano dall'allegato documento “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (All. I), generato dalla piattaforma MePa e riportate in premessa;
2. **AGGIUDICARE** la procedura di cui alla RDO/MEPA n. 2375068 (Cod. CIG 8015373F08) per la fornitura di n. 03 Sistemi per l'esecuzione di Test Cardiopolmonare, per le UU.OO. Cardiologia dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca alla Società Cosmed S.r.l., avente sede legale in Viale Bruno Buozzi, 77 - 00193 Roma, con Cod. Fiscale n. 04646530586 e P. I.V.A. n. 01284691001, per l'importo complessivo di € 70.719,15=oltre iva 22%, alle condizioni indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto e nell'offerta della medesima Ditta, come risulta dall'allegato documento “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute”, generato dalla piattaforma MePa (All. I);
3. **AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la suddetta Società, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
4. **DARE ATTO** che l'intervento di acquisto di che trattasi risulta inserito nel Piano degli investimenti relativo al triennio 2020/2021/2022 e che l'onere derivante dal presente atto, ammontante a € 87.507,06=iva e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 incluse, come da seguente quadro economico, aggiornato rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre sia sulla base delle risultanze di gara, sia per adeguare la misura delle competenze interne a quanto definito dalla Delibera 1283/2020:

Fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare	€ 70.719,15
IVA aliquota 22%	€ 15.558,21
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 1.200,00
Contributo ANAC	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 87.507,36</b>

è da iscrivere:

- Per € 86.307,36 sul Conto Patrimoniale n. A101020501 del corrente Bilancio d'Esercizio, ed è finanziato con risorse del bilancio aziendale;

- \* Per € 1.200,00 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del corrente Bilancio d'Esercizio;
  - 5. **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
  - 6. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
  - 7. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per consentire il celere avvio delle procedure conseguenziali all'adozione del presente provvedimento;
- Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato**

Dott. Oreste Falco

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere \_\_\_\_\_  
Data 06/04/2021

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

Parere \_\_\_\_\_  
Data 06/04/2021

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco, Direttore UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;  
 Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;  
 Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr. Oreste Falco, responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**


Dott. Mario Zappia

**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC  
"Ufficio Staff e Controllo IT Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque

Contabilita': Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2021  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 30/03/2021  
Alla data : 30/03/2021  
Dalla P.Nota: 36481  
Alla P.Nota : 36481  
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E A V E R E
N. Reg.	Num.	Doc		Protoc.		Causale Movimento		
36481	30/03/21	29/03/21		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	1.200,00	0,00
	1	P. N.	621/21 PROV.			P. N. 621/21 PROV. TO APPR.NE GARA N.3 SIST. CARDIOPOLMONARI		
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00	1.200,00
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							1.200,00	1.200,00

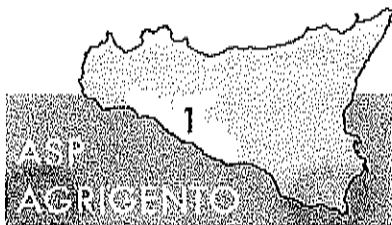

AQ. A

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407268 - 407145

Fax: 0922407211

Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)

[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. n. 2375068 – per l'affidamento della fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodynamiche dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca – Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano i chiarimenti resi a seguito di quesiti posti da più ditte:

D. 1) Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) la fatturazione va, secondo nuove disposizioni di legge, emessa entro 12 giorni dall'emissione del ddt; pertanto la Vs. richiesta di fatturazione differenziata 90% al collaudo e 10% alla fine del periodo di garanzia risulta, per quanto sopra, non praticabile. Inoltre, viene richiesta fidejussione definitiva a garanzia della corretta fornitura, che pertanto, esclude categoricamente l'eventuale "cauzione del 10%" da Voi richiesta nella fatturazione differenziata. Si chiede quindi di dare cortese riscontro alla presente, al fine di poter procedere alla presentazione dell'offerta di gara.

R. A parziale modifica di quanto indicato nelle Condizioni particolari di Contratto, sezione "MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, punto 6), la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura per l'importo della fornitura, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo (collaudo).

D. 2) Fra i criteri di aggiudicazione, viene riportata la richiesta di eventuale campionatura; si chiede se trattasi di refuso di stampa, atteso che la richiesta è indirizzata verso apparecchiature complesse composte da più moduli e parti, tali da definirne un sistema (sistema per prove da sforzo cardiopolmonare) e non di materiale di consumo di norma soggetto a presentazione di campionatura. Restiamo in attesa di Vs. cortese ed urgente riscontro. L'occasione è gradita per porgere, Distinti Saluti.

R. Si conferma la possibilità per questa Amministrazione di richiedere campionatura.

Il Collaboratore Amministrativo  
(Dott. Giuseppe Palumbo)

Il Responsabile Del Procedimento  
(Dott. Giuseppe Santilippo)

Il Responsabile Della Struttura  
(Dott.ssa Luciana Di Salvo)

D. 3) Buongiorno, In riferimento al disciplinare di gara richiediamo alcuni chiarimenti. In particolare :il sistema deve essere dotato di interfaccia TTL OUTPUT e in grado di collegarsi ad apparecchiature esterne: consumo di ossigeno (ergospirometro) e/o Misuratore di pressione automatica. E' inteso che l'offerta tecnica/economica preveda il misuratore automatico della pressione non invasiva? Se si ,questo misuratore può essere integrato nel cicloergometro?

R. Non è richiesto che nell'offerta debba essere incluso il misuratore automatico della pressione non invasiva.

D. 4) Deve essere possibile dotare il sistema di software ed hardware per la realizzazione di remote workstation, (in rete) per la revisione remota di prove da sforzo archiviate, con funzione di replay, editing e stampa. La configurazione proposta deve prevedere la possibilità futura di stazione di refertazione remote o le stesse devono essere incluse? Se si , quante ?

R. Si conferma la richiesta "possibilità futura di Remote Workstation".

D. 5) Buongiorno. Il cavo paziente a leads singolarmente sostituibili è esclusiva di una sola ditta del settore. Si chiede la possibilità di partecipare con un cavo paziente equivalente. Cordiali saluti.

R. Sono ammessi anche cavi Ecg con leads anche non singolarmente sostituibili.

D. 6) Chiediamo i seguenti chiarimenti: in riferimento alle seguenti caratteristiche:- "Campionamento dei gas con metodo respiro per respiro, con pneumotacografo, insensibile alla presenza di saliva, leggero e compatto per essere utilizzato direttamente con boccaglio o maschera senza l'uso di elmetti pesanti ed ingombranti.....Privo di parti elettriche o mobili". Al fine di permettere ai produttori di sistemi che utilizzano altri tipi di flussimetri, quali la turbina digitale, accettata e validata, si chiede se questa caratteristica è pena di esclusione, in modo da dare la possibilità di partecipare ad altre aziende e non restringere la gara a poche aziende.

R. In aggiunta al sistema così come richiesto, saranno ammesse anche le offerte di sistemi integrati per valutazioni cardiopolmonari con sistema di campionamento dei gas con metodo respiro per respiro, con pneumotacografo, anche a turbina

D. 7) "Possibilità di collegamento in rete tramite interfaccia HL7 e GDT". Questa caratteristica deve essere inclusa? Oppure serve per implementazione futura? Per l'HL7 serve interfacciarsi con i vostri informatici per capire modalità e protocolli di interfacciamento.

R. Si conferma che la possibilità di collegamento in rete tramite interfaccia HL7 e GDT deve essere inclusa.


D. 8) Deve essere possibile dotare il sistema di Software ed hardware per la realizzazione di Remote Workstation .....". Deve essere fornita una seconda postazione di lavoro adibita a solo revisione e stampa? saluti

R. In relazione al quesito, si rinvia a quanto indicato per la domanda D. 4)

Agrigento 04/10/2019

Per Tecnologie Sanitarie  
Ing. Angelo Russo

Direttore ff U.O. Cardiologia e/UTC del P.O. di Canicattì  
Dr. Luciano Sutera Sardo

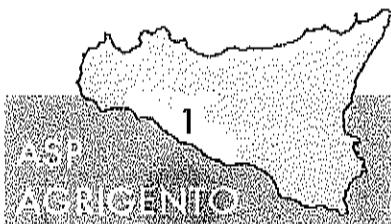

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

### UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407268 - 407145

Fax: 0922407211

Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)

[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. n. 2375068 – per l'affidamento della fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emordinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca – Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano i chiarimenti resi a seguito di quesiti posti da una ditta:

"In relazione alla risposta al quesito D2, di conferma della possibilità di richiedere campionatura, ed in considerazione che come già precedentemente segnalato, si tratta di apparecchiature/sistemi complessi, quindi non campionabili, si chiede quanto segue:

D. 1) Se la richiesta di campionatura ha finalità di verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'intero sistema in acquisto quindi da intendere come prova pratica.

R. Si conferma che la possibilità di richiedere la campionatura è finalizzata all'emissione del giudizio di conformità tecnica e, pertanto, alla verifica del possesso delle specifiche tecniche dichiarate in offerta.


D. 2) Se sia possibile effettuare tale prova pratica dimostrativa di verifica delle caratteristiche anche presso altri ENTI già utilizzatori con eventuali spese a carico della azienda partecipante. Ciò ovviamente con lo scopo di garantire la più ampia partecipazione alle aziende del settore.

R. E' ammessa la possibilità di visionare ed esaminare l'apparecchiatura presso altri enti, pubblici e/o privati, purché abbia la medesima configurazione tecnica di quella offerta in gara.

Il Collaboratore Amministrativo  
(Dott. Giuseppe Palumbo)

Il Responsabile Del Procedimento  
(Dott. Giuseppe Sanfilippo)

Il Responsabile Della Struttura  
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

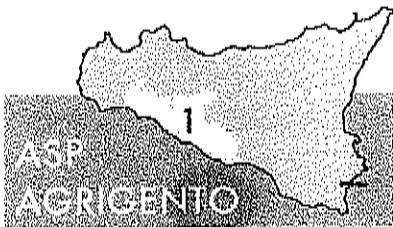

Att. B

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407268 - 407145

Fax: 0922407211

Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)

[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. n. 179630 del 28-10-2019

Al Componenti della Commissione Tecnica

Oggetto: Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n 2375068, per l'acquisto di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca. Nomina Commissione Tecnica

Premesso che con Deliberazione a contrarre n. 661 del 07/08/2019, questa Azienda ha indetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, una procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA, per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 120.000,00=+IVA 22%;

Che in data 27/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione della RdO n. 2375068 in oggetto;

Che entro la data di scadenza hanno presentato offerta tramite piattaforma n. 04 Ditte;

Che occorre procedere alla nomina di una Commissione tecnica incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse alla gara in oggetto.

Premesso e considerato quanto sopra esposto, si procede alla nomina di una Commissione tecnica, quale composta per competenza da:

1. Dott. Giulio Santocito (Presidente)
2. Dott. Ennio Cioffo (Componente)
3. Dott.ssa Paola Siliquini (Componente)

I lavori della suddetta Commissione saranno assistiti, nella qualità di segretario verbalizzante, da un funzionario amministrativo dell'UOC Servizio Provveditorato all'uopo incaricato.

La nomina in parola non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr.ssa Loredana Di Salvo

Il Direttore Sanitario Aziendale  
Dr. Gaetano Mancuso

Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santocito

P.D. 0

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento  
codice fiscale e partita Iva 02570930848

**RELAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA**

Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n. 2375068, per l'acquisto di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca

La Commissione tecnica, composta come di seguito indicato, nominata con nota n. 179430 del 28.10.2019 è stata incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse rispetto alle specifiche di gara indicate nel documento "Condizioni particolari di contratto", allegato alla RDO/ME.PA. n. 2375068, per la fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca, indetta con deliberazione n. 661 del 07.08.2019.

La Commissione tecnica è così composta:

- **Presidente:** Dr. Luciano Sutera Sardo, Direttore f.f. U.O. Cardiologia e UTIC PO Canicattì;
- **Componente:** Dr. Ennio Ciotta, Direttore f.f. U.O. Cardiologia PO Sciacca;
- **Componente:** Dr.ssa Paola Sidoti, Dirigente medico U.O.C. Cardiologia/Utic/Emodinamica del P.O. di Agrigento;

In data 06.11.2019, presso i locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato, la Commissione, con il supporto dell'Ing. Angelo Russi, ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a., nell'ambito del contratto in essere con questa ASP, ricevuta la documentazione tecnica, scaricata dalla piattaforma MEPA/Consip per il tramite del punto istruttore MEPA Dr. Giuseppe Palumbo (funzionario Servizio Provveditorato), delle ditte partecipanti alla RDO medesima, relaziona quanto segue in ordine alla conformità dei beni offerti rispetto alle specifiche tecniche di gara:

Esaminata la documentazione tecnica delle Ditte offerenti ed ammesse, la Commissione, al fine di esprimere parere circa la conformità della documentazione prodotta alle specifiche del Capitolato tecnico, ravvisa la necessità di richiedere alle sottoindicate ditte i seguenti chiarimenti:

- Ditta MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL: dalla documentazione tecnica prodotta non si evince la presenza dello zoom per la derivazione che slivella in maniera significativa con comparazione alla condizione pregressa. Richiedere pertanto da quale pagina della documentazione prodotta ciò possa evincersi.
- Ditta COSMED S.R.L.: dalla documentazione prodotta, e specificamente nella tabella comparativa, non si evince la presenza dello zoom per la derivazione che slivella in maniera significativa con comparazione alla condizione pregressa. Richiedere pertanto da quale pagina della documentazione prodotta ciò possa evincersi. Richiedere inoltre se la SaO<sub>2</sub> è gestita dall'apparecchiatura e da quale pagina della documentazione tecnica prodotta ciò possa evincersi

La Commissione pertanto delega il Dr. Giuseppe Palumbo (funzionario Servizio Provveditorato e punto istruttore MEPA) a fare tali specifiche richieste di chiarimenti alle summenzionate Ditte, postergando il relativo giudizio di conformità alla valutazione degli stessi.

A questo punto, la Commissione sospende i lavori e rinvia ad altra seduta per l'emissione del giudizio di conformità tecnica.

Agrigento, 06/11/2019

Dr. Luciano Sutera Sardo

Dr. Ennio Ciotta

Dr.ssa Paola Sidoti

Ing. Angelo Russi

E  
P.A.C.D.  
Angelo Russi

PDL D

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento  
codice fiscale e partita Iva 02570930848

**RELAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA**

Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n. 2375068, per l'acquisto di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca

In data 06.12.2019, presso i locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato, è tornata a riunirsi la Commissione tecnica, nominata con nota n. 179430 del 28.10.2019, ed incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse rispetto alle specifiche di gara indicate nel documento "Condizioni particolari di contratto", allegato alla RDO/MEPA. n. 2375068, per la fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca, indetta con deliberazione n. 661 del 07.08.2019.

La Commissione, con il supporto dell'Ing. Angelo Russi, ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a., nell'ambito del contratto in essere con questa ASP, esaminata la documentazione tecnica, scaricata dalla piattaforma MEPA/Consip per il tramite del punto istruttore MEPA Dr. Giuseppe Palumbo (funzionario Servizio Provveditorato), delle ditte partecipanti alla RDO medesima, nonché i chiarimenti pervenuti dalle ditte cui erano stati richiesti, relaziona quanto segue in ordine alla conformità dei beni offerti rispetto alle specifiche tecniche di gara:

- Ditta **Medical Graphics Italia Srl**: esaminata la documentazione tecnica presentata nonché i chiarimenti pervenuti a seguito di specifica richiesta, si esprime giudizio di conformità rispetto alle specifiche di gara;
- Ditta **Cosmed s.r.l.**: esaminata la documentazione tecnica presentata nonché i chiarimenti pervenuti a seguito di specifica richiesta, si esprime giudizio di conformità rispetto alle specifiche di gara;
- Ditta **Halsa s.r.l.**: esaminata la documentazione tecnica presentata, si esprime giudizio di conformità rispetto alle specifiche di gara;
- Ditta **Carefusion Italy 237 S.R.L. Unip.**: esaminata la documentazione tecnica presentata, si esprime giudizio di non conformità rispetto alle specifiche di gara per la seguente motivazione: "Lo spazio morto è pari a 30 ml e non inferiore a 20 ml come richiesto nel Capitolo Tecnico".

Agrigento, 06/12/2019

Dr. Luciano Sutera Sardo

Dr. Ennio Ciotta

Dr.ssa Paola Sidoti

Ing. Angelo Russi

All. E

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**  
Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento  
codice fiscale e partita Iva 02570930848

**RELAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA**

Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n. 2375068, per l'acquisto di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca

In data 17/01/2020, presso i locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato, è tornata a riunirsi la Commissione tecnica, nominata con nota n. 179430 del 28.10.2019, ed incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse rispetto alle specifiche di gara indicate nel documento "Condizioni particolari di contratto", allegato alla RDO/MEPA. n. 2375068, per la fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca, indetta con deliberazione n. 661 del 07.08.2019.

La Commissione è tornata a riunirsi a seguito di istanza, prodotta con nota pec del 19/12/2019 dalla Società Carefusion 237, partecipante alla procedura di gara di cui all'oggetto, di revisione del giudizio di NON CONFORMITA' espresso dalla stessa Commissione nella seduta del 06/12/2019 sulla documentazione tecnica presentata dalla suddetta Società e comunicata alla stessa con nota prot. n. 212080 del 17/12/2019 dal Servizio Provveditorato.

La Commissione, vagliate le controdeduzioni tecniche dalla Società Carefusion 237, determina di riesaminare la documentazione tecnica della suddetta Società nonché di esaminare nuovamente le schede tecniche delle altre Società partecipanti e dichiarate conformi, al fine di soppesare le specifiche tecniche del prodotto offerto dalla Società istante con le specifiche tecniche del prodotto offerto dalle altre Società partecipanti ed ammesse.

La Commissione, riesaminata la documentazione tecnica prodotta dalla Società Carefusion, anche alla luce dei chiarimenti prodotti nell'istanza di revisione, conferma il giudizio di NON CONFORMITA' espresso nella precedente valutazione tecnica relativamente allo "spazio morto" di 30 ml e non di 20 come richiesto, ed inoltre rileva anche che la risoluzione, come dichiarato nella documentazione tecnica, da 0 a 300 lt/min. è pari a 3 ml. e non < 1 ml., come richiesto nel capitolo tecnico.

La Commissione, riesaminata la documentazione tecnica prodotta dalle altre Società partecipanti, rileva che dalla documentazione tecnica prodotta dalla Società Cosmed s.r.l., non si evince l'entità dello spazio morto e il valore della risoluzione da 0 a 300 lt/min.

La Commissione pertanto delega il Dr. Giuseppe Palumbo (funzionario Servizio Provveditorato e punto istruttore MEPA) a richiedere alla Società Cosmed s.r.l. in quale pagina della documentazione tecnica prodotta sono rilevabili le summenzionate caratteristiche (valore spazio morto e risoluzione <1 ml., richiesta nel capitolo tecnico).

A questo punto, la Commissione sospende i lavori e rinvia ad altra seduta per l'emissione del giudizio di conformità tecnica.


Agrigento, 17/01/2020

Dr. Luciano Sutera Sardo

Dr. Ennio Ciotta

Dr.ssa Paola Sidoti

Ing. Angelo Russi

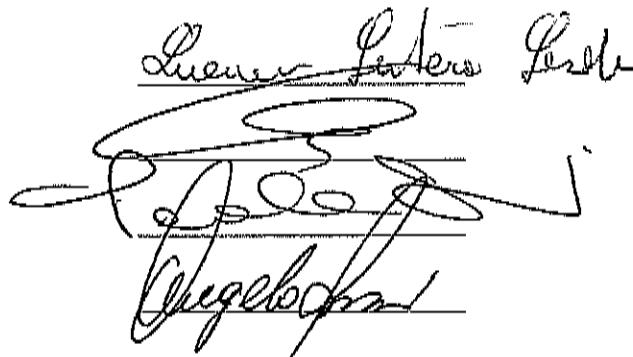  
Luciano Sutera Sardo  
Ennio Ciotta  
Paola Sidoti  
Angelo Russi

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**  
Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento  
codice fiscale e partita Iva 02570930848  
**RELAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA**

R.D.L. F

Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n. 2375068, per l'acquisto di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca

In data 27/02/2020, presso i locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato, è tornata a riunirsi la Commissione tecnica, nominata con nota n. 179430 del 28.10.2019, ed incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse rispetto alle specifiche di gara indicate nel documento "Condizioni particolari di contratto", allegato alla RDO/MEPA. n. 2375068, per la fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca, indetta con deliberazione n. 661 del 07.08.2019.

La Commissione è tornata a riunirsi, con il supporto dell'Ing. Angelo Russi, ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a., nell'ambito del contratto in essere con questa ASP, previa formale convocazione prot. 29183 del 14/02/2020, al fine di esaminare i chiarimenti prodotti in data 21/01/2020, dalla Ditta Cosmed, richiesti con messaggio Mepa del 20/01/2020.

La Commissione, nella seduta del 17/01/2020, ha confermato il giudizio di NON CONFORMITA' della documentazione tecnica prodotta dalla Società Carefusion 237 alle specifiche di gara, ed ha proceduto a riesaminare la documentazione tecnica prodotta dalle Società Halsa s.r.l. e Medical Graphics Italia Srl, con conferma per entrambe del giudizio di conformità espresso nella riunione del 06/12/2019, mentre dal riesame della documentazione tecnica prodotta dalla Società Cosmed s.r.l., la Commissione ha ritenuto di richiedere alla summenzionata Ditta chiarimenti, in quanto dalla documentazione tecnica prodotta non si evinceva l'entità dello spazio morto e il valore della risoluzione < 1 ml da 0 a 300 lt/min., richiesta effettuata a mezzo Mepa in data 20/01/2020;

Che, in data 21/01/2020, sono stati prodotti, a mezzo Mepa, i chiarimenti richiesti che vengono oggi esaminati.

La Commissione, vagliati i chiarimenti e le controdeduzioni tecniche prodotte dalla Società Cosmed s.r.l., rileva quanto segue:

In merito al requisito spazio morto, la Società Cosmed dichiara che "*tale spazio è decisamente inferiore ai 20ml richiesti*" e quindi conforme a quanto richiesto nelle specifiche tecniche

In merito al requisito risoluzione < di 1ml al secondo, richiesta nel capitolato tecnico, la suddetta Società, nonostante la precisazione che la risoluzione di un volume riferito ad un parametro di flusso debba essere espresso in ml/s, non fornisce elementi che permettono di verificare la sussistenza di tale requisito; la Commissione, pertanto, rivede il giudizio di conformità precedentemente espresso e ritiene non conforme l'offerta della Cosmed per non aver dichiarato il soddisfacimento del requisito sopra citato.

Agrigento, 27/02/2020

Dr. Luciano Sutera Sardo

Dr. Ennio Ciotta

Dr.ssa Paola Sidoti

Ing. Angelo Russi

RIEPILOGO			
DETALLO MESSAGGIO RICEVUTO			
Oggetto	R: R: Comunicazione di Esclusione - 2375066 - Procedura negoziata -banche RDQNEPA. -per l'affidamento della fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopulmonare per le UU.OO. Cardiologici, Alergico e Sciacca	Id iniziativa	2375066
BUSTE PRESENTATE	CONMISSIONE DI GARA	OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO	
		COMUNICAZIONI CONI FORNITORI	
		Comunicazioni ricevute	
		Comunicazioni inviate	
		Invia comunicazione	
		ESAME DELLE OFFERTE	
		SOSPENSA	
		REVOCA	
		COPIA GARA	
		DETALLO COM.	05-03-2010-CASE...
		DELIBERA doc...	W DELIBERA doc...
		DELIBERA gest...	W DELIBERA gest...
		INDENNITÀ	INDENNITÀ
		RISPOSTA	RISPOSTA
		SEZIONE GESTITA	SEZIONE GESTITA



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento  
codice fiscale e partita Iva 02570930848

**RELAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA**

Aut. H

Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n. 2375068, per l'acquisto di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca

In data 01/03/2021, presso i locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato, è tornata a riunirsi la Commissione tecnica, nominata con nota n. 179430 del 28.10.2019, ed incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse rispetto alle specifiche di gara indicate nel documento "Condizioni particolari di contratto", allegato alla RDO/ME.PA. n. 2375068, per la fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca, indetta con deliberazione n. 661 del 07.08.2019.

La Commissione è tornata a riunirsi, previa formale convocazione prot. 31745 del 18/02/2021, e successiva rettifica verbale per la data odierna a seguito dell'impossibilità a riunirsi per il giorno inizialmente fissato, per esaminare la comunicazione inviata dalla Cosmed, in data 24/03/2020, a seguito dell'esclusione di cui al precedente verbale datato 27/02/2020.

La Commissione, analizzata la sopra citata comunicazione della Cosmed, e riesaminati i verbali precedenti, nonché tutti gli atti riguardanti la procedura in oggetto, rilevato che, effettivamente, in sede di chiarimenti, la Stazione appaltante ha chiarito al punto D6 che "... saranno ammesse anche le offerte di sistemi integrati per valutazioni cardiopolmonari con sistemi di campionamento dei gas con metodo respiro per respiro, con pneumotacografo, anche a turbina", si esprime parere favorevole di conformità tecnica per l'offerta della Cosmed, come già espresso nella seduta precedente del 06.12.2019.

Agrigento, 01/03/2021

Dr. Luciano Sutera Sardo

Dr. Ennio Ciotta

Dr.ssa Paola Sidoti

Aggi

**Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute**

<b>Numero RDO:</b>	2375068
<b>Descrizione RDO:</b>	Procedura negoziata –tramite RDO/ME.PA. –per l'affidamento della fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
<b>Punto Ordinante</b>	ORESTE FALCO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
<b>Codice univoco Ufficio - IPA</b>	T1.DFDX
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	27/08/2019 15:59
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	15/10/2019 14:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	09/10/2019 18:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	15/04/2020 18:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi:</b>	45
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1. Procedura negoziata –tramite RDO/ME.PA. –per l'affidamento della fornitura di n. 03 Sistemi di Valutazione Test Cardiopolmonare per le UU.OO. Cardiologia/ Utic/ Emodinamica dei PP.OO. di Canicattì, Agrigento e Sciacca

<b>CIG</b>	8015373F08
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	Sistema di Valutazione Test Cardiopolmonare/3/
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	120000,0000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	COSMED S.R.L.	Singola	01284691001	11/10/2019 11:03
2	CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP.	Singola	08086280156	14/10/2019 16:17
3	HALSA SRL	Singola	03014960870	14/10/2019 12:56
4	MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL	Singola	12642600154	04/10/2019 15:46

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	17/03/2021 15:15:03	22/03/2021 14:34:05

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Cond. partic. di Contratto firmate per Accettazione		Comunicaz. Escl.Off. Anomale firmate per Accettazione/Presa Visione		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Dichiarazione di cui al P. 01 Condiz. Partic. di Contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
COSMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
HALSA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	22/03/2021 14:34:14	22/03/2021 16:17:01

Concorrente	Dichiaraz. p. 4 Cond. part. di contratto		Breve relaz. Tecnica di cui p. 3 Cond. Part. di Contratto		Eventuale relaz. Tecnica (P. 6 Cond. Part. di Contratto)		Certificazione Ce (p. 5 Cond. Part. di Contratto)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
COSMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP.		Con riferimento alla RDO in oggetto, si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'offerta della ditta in indirizzo non è ammessa alla fase successiva dell'apertura "Offerta economica" poiché la commissione tecnica, incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute, esaminata, col supporto dell' Ingegnere Clinico, la documentazione tecnica prodotta dalla ditta in indirizzo, ha espresso giudizio di non conformità delle specifiche tecniche del prodotto offerto rispetto alle specifiche di gara con la seguente motivazione : "Lo spazio morto è pari a 30 ml e non inferiore a 20 ml come richiesto nel Capitolato Tecnico"	NON Approvato	Con riferimento alla RDO in oggetto, si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'offerta della ditta in indirizzo non è ammessa alla fase successiva dell'apertura "Offerta economica" poiché la commissione tecnica, incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute, esaminata, col supporto dell' Ingegnere Clinico, la documentazione tecnica prodotta dalla ditta in indirizzo, ha espresso giudizio di non conformità delle specifiche tecniche del prodotto offerto rispetto alle specifiche di gara con la seguente motivazione : "Lo spazio morto è pari a 30 ml e non inferiore a 20 ml come richiesto nel Capitolato Tecnico"	NON Approvato	Con riferimento alla RDO in oggetto, si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'offerta della ditta in indirizzo non è ammessa alla fase successiva dell'apertura "Offerta economica" poiché la commissione tecnica, incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute, esaminata, col supporto dell' Ingegnere Clinico, la documentazione tecnica prodotta dalla ditta in indirizzo, ha espresso giudizio di non conformità delle specifiche tecniche del prodotto offerto rispetto alle specifiche di gara con la seguente motivazione : "Lo spazio morto è pari a 30 ml e non inferiore a 20 ml come richiesto nel Capitolato Tecnico"	NON Approvato	Con riferimento alla RDO in oggetto, si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'offerta della ditta in indirizzo non è ammessa alla fase successiva dell'apertura "Offerta economica" poiché la commissione tecnica, incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute, esaminata, col supporto dell' Ingegnere Clinico, la documentazione tecnica prodotta dalla ditta in indirizzo, ha espresso giudizio di non conformità delle specifiche tecniche del prodotto offerto rispetto alle specifiche di gara con la seguente motivazione : "Lo spazio morto è pari a 30 ml e non inferiore a 20 ml come richiesto nel Capitolato Tecnico"
HALSA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna


ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	22/03/2021 16:17:09	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
COSMED S.R.L.	NON Valutato	nessuna
CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP.	NON Valutato	nessuna
HALSA SRL	NON Valutato	nessuna
MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
COSMED S.R.L.	70719,15000000
MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL	108000,00000000
HALSA SRL	110400,00000000
CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP.	Concorrente escluso

<b>Note di gara</b>	La Commissione, vagliati i chiarimenti e le controdeduzioni tecniche prodotte dalla Società Cosmed s.r.l., rileva quanto segue: In merito al requisito spazio morto, la Società Cosmed dichiara che "tale spazio è decisamente inferiore ai 20ml richiesti" e quindi conforme a quanto richiesto nelle specifiche tecniche. In merito al requisito risoluzione < di 1ml al secondo, richiesta nel capitolato tecnico, fa suddetta Società, nonostante la precisazione che la risoluzione di un volume riferito ad un parametro di flusso dabbà essere espresso in ml/s, non fornisce elementi che permettono di verificare la sussistenza di tale requisito; la Commissione, pertanto, rivede il giudizio di conformità precedentemente espresso e ritiene non conforme l'offerta della Cosmed per non aver dichiarato il soddisfacimento del requisito sopracitato.
<b>Note specifiche lotto 1</b>	La Commissione Tecnica, con verbale del 01/03 u.s., riesaminati i verbali pregressi e tutti gli atti relativi alla presente procedura, rivede il precedente giudizio di non conformità ed esprime parere favorevole di conformità tecnica per l'offerta prodotta dall'O.E. Cosmed, per le motivazioni in detto verbale riportate.



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_.

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- \* Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - \* Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_.

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_.

Immediatamente esecutiva dal 09 APR. 2021

Agrigento, li 09 APR. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi