

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

STRUTTURA AMMINISTRATIVA U.O.C. PRESIDI OSPEDALIERI CANICATTI' e LICATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4303 DEL 03-10-2019

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa in favore della Ditta OMS-Ortomedisan (Ortopedici Medicali Sanitari) per la fornitura urgente di n. 10 pz. sfigmomanometri ad aneroide da tavolo e n.10 pz. Sfigmomanometri ad aneroide di asta e piede rotabile per il Servizio di Farmacia del P.O. " Barone Lombardo " di Canicattì CIG : ZB929F4894 .

STRUTTURA PROPONENTE: <i>Struttura Amministrativa Presidi Ospedalieri Canicattì-Licata</i>	
PROPOSTA N. <u>4575</u> DEL <u>02/10/2019</u>	Il Titolare di Posizione Organizzativa P.O. di Canicattì <i>Dr.ssa Maria Rita Safonte</i>
Il Responsabile del Procedimento <i>Dr. Giacomo Granata</i>	Il Direttore Struttura Amministrativa U.O.C. Presidi Ospedalieri Canicattì-Licata <i>Dr. Oreste Falco</i>
VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
() Autorizzazione n. _____ del _____	C.E. / C.P. <u>C 501010512</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>M.R. CALOGERA BAIO Collaboratore Amministrativo</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. <i>ASP AGRIGENTO Direttore U.O.C. Farmacia M. Antonino La Valle</i>
Da notificare a: U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi di Canicattì e Licata	

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 03-10-2019

STRUTTURA AMMINISTRATIVA U.O.C. PRESIDI OSPEDALIERI CANICATTI' e LICATA

L'anno duemiladiciannove il giorno TRE del mese di OCTOBRE nella sede della suindicata struttura

IL DIRIGENTE DELEGATO

Giusto atto di delega del Direttore Generale, Dott. Giorgio Giulio Santonocito, prot. n. 34 del 18.04.2019 Registro Deleghe

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n.667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n.1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n.816 del 09/06/17;

VISTO l'Atto di delega n.34 del 18.04.2019 Registro deleghe con il quale il Direttore Generale ASP AG conferisce l'esercizio funzioni al Direttore della Struttura Amministrativa dei Presidi di Canicattì e Licata tra cui l'adozione di determinate dirigenziali di acquisto per beni di importo pari o inferiori a € 10.000 oltre Iva ;

PREMESSO che con nota prot.nr. 87521 del 20.05.2019 il Servizio di Farmacia del P.O. di Canicattì richiedeva l'acquisto con carattere di urgenza, al fine di ottemperare alle necessità terapeutiche delle UU.OO. del P.O. di Canicattì, di n.20 sfigmomanometro ad aneroide da tavolo (bracciale) dotati di manometro non inserito nel bracciale (All.1) ;

CHE con nota prot. nr.95563 del 31.05.2019 il Direttore del Dipartimento U.O.C. Farmacia comunicava di aver provveduto ad inoltrare apposito capitolato di gara presso l'U.O.C. Provveditorato e nelle more autorizzava a chiedere all'U.O.C. Provveditorato ASP AG una procedura di acquisto dedicata tenendo conto dell'urgenza rappresentata (All.2) ;

CHE a seguito della superiore nota, non avendo avuto alcun riscontro, con nota prot. nr. 106922 del 18.06.2019 il Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di Canicattì dichiarando che " nel frattempo continuano a pervenire richieste da parte dei Reparti e stante che il Servizio di Farmacia del P.O. di Canicattì è ormai rimasto senza scorte " reiterava la richiesta di acquisto di n. 50 sfigmomanometri (All.3) ;

CHE questa U.O.C. Struttura Amministrativa dei Presidi di Canicattì e Licata, considerato l'importanza che il suddetto materiale riveste, provvedeva ad inoltrare nota di sollecito prot. nr.11175 del 26.05.2019 all'U.O.C. Provveditorato dell'ASP di Agrigento al fine di conoscere i tempi entro i quali avesse proceduto alla definizione della procedura di acquisto (All.4) ;

CHE alla suddetta richiesta non si dava alcun riscontro ;

CHE nelle more il Direttore F.F. dell'U.O.C. di Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza del P.O. di Canicattì con nota prot. nr. 150095 del 05.09.2019 avanzava richiesta di fornitura urgente di n.4 sfigmomanometri per il P.S. del P.O. di Canicattì (All.5) ;

CHE il Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di Canicattì con nota prot.nr.158993 del 19.09.2019, richiamate le precedenti note, reiterava richiesta di acquisto avente carattere di urgenza di n. 10 pz sfigmomanometri ad aneroide da tavolo e n.20 pz sfigmomanometri ad ancroide dotato di asta e piede rotabile per un fabbisogno di due mesi in attesa che venga definita la gara di acquisto da parte dell'U.O.C. Provveditorato ASP Agrigento (All.6) ;

CHE come ribadito ulteriormente dalla Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di Canicattì nella nota prot. nr. 158993 del 19.09.2019 " l'acquisto è diventato ormai urgentissimo per ottemperare alle necessità terapeutiche delle UU.OO. del P.O. di Canicattì stante che codesto servizio è ormai rimasto senza scorte "

RICHIAMATO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che per le stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

EVIDENZIATO che, per la tempestività richiesta, l'affidamento diretto rappresenta la procedura di scelta del contraente più efficiente, economica ed efficace;

CHE ai sensi della vigente normativa Legge di Bilancio 2019 il comma 130 ha disposto l'innalzamento della soglia da € 1.000,00 a € 5.000,00 il limite d'importo oltre i quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico della P.A. (ME.PA.) ;

CHE per soddisfare l'esigenza e per garantire il regolare proseguo dell'attività si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto degli sfigmomanometri nei quantitativi strettamente necessari per giungere alla definizione della gara da parte dell'U.O.C. Provveditorato ASP AG ;

CHE con nota prot. n.163581 del 27.09.2019 questa U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi di Canicattì e Licata ha individuato la Ditta locale OMS-Ortomedisan (Ortopedici Medicali Sanitari), che in passato aveva eseguito forniture similari adempiendo con regolarità, puntualità e professionalità, per acquisire un preventivo con l'indicazione dello sconto accordato e relativa scheda tecnica per la fornitura urgentissima di n. 10 pz sfigmomanometri da tavolo e n.10 pz sfigmomanometri ad aneroide dotati di asta e piede rotabile per il Servizio di Farmacia del P.O. " Barone Lombardo " di Canicattì (All.7);

PRESO ATTO che in risposta all'invito predetto la ditta OMS-Ortomedisan (Ortopedici Medicali Sanitari) con sede in Canicattì Via Regina Elena , 83 inviava in data 30.09.2019 a mezzo pcc offerta di € 2.159,00 (Iva esclusa) relativa alla fornitura in oggetto (All.8) ;

RILEVATO l'annotazione, posta sull'offerta economica dal Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. di Canicattì, la conformità dei dispositivi proposti dalla Ditta predetta (All.9) ;

CHE sono stati autodichiarati dall'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere generale previsti per la contrattazione con la P.A. (All.10) ;

CHE ai sensi dell'art.32, comma 14 del codice degli appalti, si provvederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore della Struttura Amministrativa U.O.C. dei Presidi di Canicattì e Licata proponente, che a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne attesta la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente trascritte :

1. APPROVARE il preventivo di spesa della Ditta OMS-Ortodmedisan (Ortopedici Medicali Sanitari) con sede in Canicattì Via Regina Elena, 83 relativo all'acquisizione dei dispositivi descritti in premessa per il Servizio di Farmacia del P.O. di Canicattì ;
2. CHE per la fornitura di che trattasi la spesa da sostenere assomma ad € 2.159,00 Iva esclusa, giusta preventivo di spesa assunto presso l'ufficio protocollo del P.O. di Canicattì a mezzo pec in data 30.09.2019;
3. DARE ATTO che l'onere derivante dal presente atto pari ad € 2.633,98 Iva inclusa nelle more della predisposizione del bilancio di previsione 2019 giusta nota prot.5155 del 09.01.2019 graverà sul conto economico : C 501010512 ;
4. AUTORIZZARE la struttura proponente ad eseguire ogni adempimento consequenziale all'adozione del presente atto che si dichiara immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di acquisire la fornitura in oggetto.

Attesta, altresì che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Per Delega del Direttore Generale
Il Direttore U.O.C. Struttura Amministrativa
Presidi di Canicattì e Licata
Dott. Oreste Falco

Allegati omessi
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.





Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#)»[Servizi](#)»[Servizi ad Accesso riservato](#)»[Smart CIG](#)»[Lista comunicazioni dati](#)»[Dettaglio CIG](#)

Utente: Oreste Falco

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
- U.O.C. SERVIZIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB929F4894
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.159,00
Oggetto	

	Fornitura di n. 10 sfigmomanometri ad aneroide da tavolo (bracciale) e di n.10 sfigmomanometri ad aneroide (bracciale) dotati di asta e piede rotabile
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936





**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

PRESIDIO OSPEDALIERO "B. LOMBARDO" – CANICATTI'

UNITÀ OPERATIVA FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile Dr.ssa Emanuela Ferrera

Telefono: 0922 733387 Fax: 0922 733221

100 G. CANIGATTI

89521-

Page 20 MAR 2019

Al Direttore Amministrativo P.O. Licata

AI Servizio Economale P.O.

E p.c. al Direttore Sanitario P.O.

Loro sede

OGGETTO: ACQUISTO URGENTE SFIGMOMANOMETRI.


Prot. n. del 20/05/2019

Con la presente si richiede con carattere d'urgenza l'acquisto di n 20 Sfigmomanometro ad aneroide da tavolo (bracciale) dotato di manometro non inserito nel bracciale; di alta qualità, affidabile e sicuro, nelle more che venga eseguita una gara, stante che codesto servizio ormai è rimasto senza ed anche le UU.OO.

Si chiede l'acquisto al fine di ottemperare alle necessità terapeutiche delle UUOO del P.O. di Caticattì.

Tanto si doveva

A.S.P. - AGRIGENTO
R.O. "B. e L. Lombardo" - Cencelli
RECONOSCIABILE SERVIZIO DI FARMACIA
Dra.ssa E. FERRERA

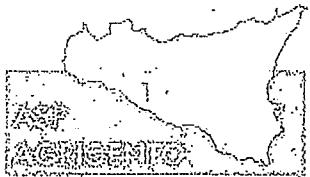

2

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 442057 * Fax 0922 442057
P.Iva e C.F. 02570930848
P.O. San Giovanni di Dio - U.O.C. Farmacia
Direttore: dr. Giuseppe Bellavia

prot. 95563 del 33-5-2019

Alla Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Canicattì
Dott.ssa Ferrera
Al Direttore Sanitario del P.O. Canicattì
Dr. Giuseppe Augello

OGGETTO: ACQUISTO SFIGMOMANOMETRI

Con riferimento alla nota n. 87423 del 20/05/2019 con oggetto: Richiesta Sfigmomanometri, si rappresenta che gli stessi non sono aggiudicati in alcuna gara. Questo Dipartimento ha già provveduto ad inoltrare apposito capitolato di gara presso la U.O.C. Provveditorato. Nelle more la S.V. potrà chiedere al Provveditorato una procedura d'acquisto dedicata tenendo conto dell'urgenza rappresentata.

Agrigento 29/05/2019

U.O.C. Farmacia
Il Direttore
Dr. Giuseppe Bellavia

DAL DIR. UFF. PROVVEDITORATO
E P.C. AL DIR. SAN PO.
SI PRESERVA NOTA PER DIR. DIP. FARMAZIO E
SI OTTIEDE CON URGENZA L'ACQUISTO
DI N° 20 SFIGMOMANOMETRI PER QUESTO
PO.

31/05/19 J.A.



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

PRESIDIO OSPEDALIERO "B. LOMBARDO" – CANICATTI'
UNITA' OPERATIVA FARMACIA OSPEDALIERA

A.S.P. AG P.O. CANICATTI
UFFICIO PROTOCOLLO
Responsabile Dr.ssa Emanuela Ferrera
Telefono: 0922 733387 Fax: 0922 733221

18 GIU 2019

Al Direttore Amministrativo P.O. -Dr. O. Falco

Al Dr G. Granata
Loro sede

ENTRATA
L'ADDETTO

OGGETTO: ACQUISTO SFIGMOMANOMETRI .

Prot. n. 10622 del 18/06/2019

Considerato che continuano a pervenire richieste da parte dei reparti di Sfigmomanometri e stante che codesto Servizio è ormai rimasto senza scorte.

Facendo seguito alla nota prot. n. 87521 del 20/05/2019 e vista la nota prot. n.95563 del 31/05/2019 (che si allegano), con la presente si richiede con carattere d'urgenza l'acquisto di materiale fuori gara di bacino Regionale stante che i lotti sono andati deserti, come da capitolato tecnico sottoindicato:

- 1 Sfigmomanometro ad aneroide da tavolo (bracciale) dotato di manometro non inserito nel bracciale; di alta qualità, affidabile e sicuro; di precisione certificata +/- 3 mmHg, con scala graduata di facile lettura, valvola progressiva di scarico aria per intervalli di pressione uniformi. Latex free. Garanzia almeno 2 anni.

Quantità 50 pz/anno

- 2 Sfigmomanometro ad aneroide (bracciale) deve essere dotato di manometro non inserito nel bracciale; deve essere di alta qualità, affidabile e sicuro; di precisione certificata +/- 3 mmHg, con scala graduata di facile lettura, valvola progressiva di scarico aria per intervalli di pressione uniformi. Latex free. dotato di asta e piede rotabile. Garanzia almeno 2 anni.

Quantità 50 pz/anno

Si chiede l'acquisto al fine di ottemperare alle necessità terapeutiche delle UU.OO. del P.O. di Canicattì.

Distinti saluti

A.S.P. - AGRIGENTO
P.O. "B.ne Lombardo" - Canicattì
RESPONSABILE SERVIZIO DI FARMACIA
(Clissa E. FERRERA)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229

Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848

4

Struttura Amministrativa U.O.C. Presidi Ospedalieri Canicattì - Licata Presidio Ospedaliero Canicattì

Il Resp.le del Procedimento

Coll. Amm.vo Dott. Giancarlo Granata

PROT N. 111755 Data 26 GIU. 2019

Al Direttore del Servizio Provveditorato
ASP Agrigento

Oggetto: sollecito .

E' pervenuta nota prot. n.106922 del 18.06.2019 da parte della Responsabile del Servizio di Farmacia del P.O. " Barone Lombardo " di Canicattì Dr.ssa E. Ferrera con la quale si richiede di provvedere all'acquisto con carattere di urgenza di n.50 (quantità pz/anno) sfingomanometro ad aneroide da tavolo (bracciale) dotato di manometro non inserito nel bracciale di precisione certificata +/-3 mmHg, con scala graduata di facile lettura, latex free, e di n. 50 (quantità pz/anno) sfingomanometro ad aneroide (bracciale) dotato di manometro non inserito nel bracciale di precisione certificata +/-3 mmHg con scala graduata di facile lettura, latex free, **dotato di asta e piede rotabile** al fine di ottemperare alle necessità terapeutiche delle UU.OO del P.O. " Barone Lombardo " di Canicattì .

L'urgenza dell'acquisto deriva dalla circostanza evidenziata dalla Dr.ssa Ferrera nella nota sopra richiamata ed allegata che trattasi di acquisto fuori gara del bacino regionale e che il Direttore del Dipartimento Farmacia del P.O." San Giovanni di Dio " ha comunicato con nota prot.nr. 95563 del 31.05.2019 di avere inoltrato apposito capitolato alla Vs. spett.le U.O.C.

Considerato l'importanza che il suddetto materiale riveste, come da intese si chiede di conoscere i tempi entro i quali il Vs. spett.le Servizio, provvederà con cortese sollecitudine alla definizione della procedura di acquisto .

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Funzionario Istruttore
P.O. Canicattì
(Dott. Giancarlo Granata)

Il Direttore Struttura Amministrativa U.O.C.
Presidi Ospedalieri Canicattì – Licata
(Dott. Oreste Falca)

Rapp invio fax

26-GIU-2019 12:57 MER

Numero fax : 0922733359
Nome : DIR-SAN-PO-CANICATTI

Nome/Numero : 7119
Pag. : 1
Ora iniz. : 26-GIU-2019 12:56 MER
Tempo trascorso : 00' 38"
Modalita' : STD G3
Risultati : [O.K.]



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA**
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede Legale: Contrada Consolida – 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale: 02310001201

1

Presidio Ospedaliero di Canicattì
Contrada Giarre 92024 Canicattì
tel 0922 733111
fax 0922 733359

Al Resp. Servizio Farmacia
Al Resp . Servizio Economato
e.p.c. Al Direttore Sanitario

A.S.P. AG P.O. CANICATTI
UFFICIO PROTOCOLLO
N. 150095 -

DE: 05 SET 2019

**ENTRATA
L'ADDETTO**

oggetto: richiesta sfigmomanometri

Si richiede con urgenza la fornitura di n° quattro sfigmomanometri per il Pronto Soccorso poiché dei tre in dotazione due sono guasti.

Canicatti li 05/09/2019

il Rosso
A.S.P.M. P.O. CANICATTI'
U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA
DI ACCETTAZIONE E URGENZA
DIRETTORE F.F.
DOTT. SSA TIZIANA ATTARDO
C.F. 300217049-LO.M. (AG) 342

Rapp invito fax
05-SET-2019 13:08 GIO
Nome : FARMACIA OSPEDALE
Numero fax : 0922 733221

Nome/Numer : 3359
Pag. : 1
Ora iniz. : 05-SET-2019 13:07 GIO
Tempo trascorso : 00,34"
Modalità : STD G3
Risultati : [O.K]



6

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

PRESIDIO OSPEDALIERO "B. LOMBARDO" – CANICATTI'
UNITA' OPERATIVA FARMACIA OSPEDALIERA

Responsabile Dr.ssa Emanuela Ferrera

A.S.P. AG P.O. CANICATTI'

UFFICIO PROTOCOLLO

N. 158993

DEL 19 SET 2019

ENTRATA
L'ADDETTO

Al Direttore Amministrativo P.O.
E alla c.a. Dr G. Granata
Loro sede

OGGETTO: ACQUISTO URGENTE SFIGMOMANOMETRI

Prot. n. del 19/09/2019

Vista la nota Prot. n. del 87521 del 20/05/2019.

Vista la nota prot. n. 106922 del 18/06/2019.

Vista la nota prot. n. 150095 del 05/09/2019

Di richiesta di acquisto di sfigmomanometri.

Con la presente si richiede l'acquisto di sfigmomanometri per un fabbisogno di due mesi in attesa che venga definita la gara.

- Sfigmomanometro ad aneroide da tavolo.
Quantità 10 pz

- Sfigmomanometro ad aneroide dotato di asta e piede rotabile.
Quantità 20 pz

Si ribadisce che l'acquisto è ormai diventato urgentissimo per ottemperare alle necessità terapeutiche delle UU.OO. del P.O. di Canicattì stante che codesto Servizio è ormai rimasto senza scorte.

Tanto si doveva

Si allega nota prot. n. 150095

A.S.P. - AGRIGENTO
P.O. "B.re Lombardo" - Canicattì
RESPONSABILE SERVIZIO DI FARMACIA
(Dr.ssa E. FERRERA)

Emanuela Ferrera



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P. Iva e C.F. 02570930848

PRESIDIO OSPEDALIERO "B. LOMBARDO" CANICATTI
DIREZIONE STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI DI CANICATTI' E LICATA

Il Responsabile del Procedimento
Coll. Amm.vo Dott. Giancarlo Granata

Spett.le Ditta
OMS-Ortopedici Medicali Sanitari
Via Regina Elena , 83 Canicattì (AG)

Pec: oms@casellapec.com

PROT n° 163581 ^{del} 27 SET. 2019

Oggetto: richiesta preventivo .

Questa U.O.C. Direzione Struttura Amministrativa dei Presidi di Canicattì e Licata ASP Ag deve procedere, urgentemente, all'acquisto di n. 10 sfigmomanometri ad aneroide da tavolo (bracciale) dotati di manometro non inserito nel bracciale di precisione certificata +/-3 mm Hg, con scala graduata di facile lettura, valvola progressiva di scarico aria intervalli di pressione uniformi, latex free (garanzia almeno due anni) e di n. 10 sfigmomanometri ad aneroide (bracciale) dotato di manometro non inserito nel bracciale di precisione certificata +/-3 mm Hg con scala graduata di facile lettura, con scala graduata di facile lettura, valvola progressiva di scarico aria intervalli di pressione uniformi, latex free, **dotati di asta e piede rotabile** (garanzia almeno due anni) al fine di ottemperare alle necessità terapeutiche delle UU.OO del P.O. " Barone Lombardo " di Canicattì .

Pertanto, codesta Ditta è invitata a presentare , se interessata, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 1 ottobre 2019 apposito preventivo di spesa con l'indicazione dello sconto accordato e relativa scheda tecnica al seguente indirizzo pec : pocanicattì@pec.aspag.it.

La presente non vincola in alcun modo questa Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto che dovrà avvenire in tempi rapidissimi .

Si ringrazia e si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Funzionario Istruttore

P.O. Canicattì

(Dott. Giancarlo Granata)

Il Direttore Amministrativo

P.O. Canicattì - Licata

(Dr. Oreste Falco)

Da "pocanicatti" <pocanicatti@pec.aspag.it>
A "oms@casellapec.com" <oms@casellapec.com>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 13:46

Richiesta Preventivo

Spett.le Ditta OMS - Ortopedici Medicali Sanitari si trasmette in allegato richiesta di preventivo. Distinti saluti.

Allegato(i)

Richiesta Preventivo Ditta OMS.pdf (465 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "pocanicatti@pec.aspag.it" <pocanicatti@pec.aspag.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 13:46

ACCETTAZIONE: Richiesta Preventivo

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/09/2019 alle ore 13:46:35 (+0200) il messaggio
"Richiesta Preventivo" proveniente da "pocanicatti@pec.aspag.it"
ed indirizzato a:
oms@casellapec.com ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20190927134635.16819.304.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (756 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "pocanicatti@pec.aspag.it" <pocanicatti@pec.aspag.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 13:46

CONSEGNA: Richiesta Preventivo

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/09/2019 alle ore 13:46:36 (+0200) il messaggio
"Richiesta Preventivo" proveniente da "pocanicatti@pec.aspag.it"
ed indirizzato a "oms@casellapec.com"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190927134635.16819.304.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (846 bytes)
postacert.eml (639 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "oms" <oms@casellapec.com>
A "pocanicatti@pec.aspag.it" <pocanicatti@pec.aspag.it>
Data lunedì 30 settembre 2019 - 10:07

g

Vs richiesta preventivo prot.163581 del 27.09.19

Salve

Si allega preventivo come da Vs richiesta prot.163581 del 27.09.19.

Canicattì 30.09.19

Cordiali Saluti

Allegato(i)

preventivo.asp po.pdf (282 Kb)
aneroide riester 32717 pagina prod.pdf (1654 Kb)
gima riester 32746 pagina cat.pdf (1576 Kb)
riester 32746.pdf (79 Kb)
big_ben_e_RevE.pdf (619 Kb)

A.S.P. AG P.O. CANICATTÌ
UFFICIO PROTOCOLLO

30 SET 2019

ENTRATA
PADDETTO

OMS s.r.l.s.

ORTOMEDISAN

ORTOPEDICI
MEDICALI
SANITARI

VIA REGINA ELENA, 83, 92024 CANICATTI' (AG)
 Cod. Fisc. 02764130841 - P.IVA 02764130841
 R.I. 02764130841 - C.C.I.A.A. AG
 Tel: 0922833637 - Fax: 0922833637
 NSIS
 IBAN: IT53E0200882882000103424719

Destinazione Diversa

Tipo Documento PREVENTIVO	Data 18.09.2019	Numero 84
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

Spettile	Codice 515
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PO VIALE DELLA VITTORIA, 321 92100 AGRIGENTO C.F. 02570930848	P.I. 02570930848
Pagamento: BONIFICO BANCARIO	

Codice	Descrizione Articolo	Natura del Prodotto	Um	Q.tà	Prezzo	% Sc	Totale	Iva
V2202	SFIGMO RIESTER BHS 32717 LATEX FREE			10	64,000	15,00	544,00	22
V2203	SFIGMO RIESTER BHS SU CARRELLO 32746			10	190,000	15,00	1.615,00	22

Totali:	Merce	Pezzi	% Sconto	Firma	Codice	Descrizione Iva	Aliq. %	Imponibile	Imposta
	2.159,00	20	0,00		0	ALIQUOTA 22%	22,00	2.159,00	474,98
Annotazioni:									
RIF VS. RICHIESTA PROT.163581 DEL 27.09.19									

Trasporto a cura dei:	Spese Trasporto	Spese Bolli	Spese Varie	Spese Incasso	TOT.	2.159,00
					Tot. Imposta	474,98

Causale Trasporto: VENDITA	Nº Colli: 0	TOT. FATTURA	2.633,98
----------------------------	-------------	---------------------	-----------------

Vettore:	Aspetto Beni:	Data Inizio Trasporto:	Ora Inizio Trasporto:
----------	---------------	------------------------	-----------------------

Trattiamo i Vs. dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy e a richiesta rimettiamo Informativa completa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03. Contributo Co. Na. I assolto ove dovuto il cliente/vettore che ritira la merce dichiara con la propria firma che i/i colli/i consegnati/i sono integri, senza nessun segnale di manomissione e/o altro che pregiudichi il trasporto e/o l'integrità della merce.

SFIGMO ANEROIDI RIESTER - PRODUZIONE TEDESCA

Corpo in alluminio leggero e solido resistente alla corrosione

Superficie liscia facile da disinsettare

BHS VALIDATION

Quadrante ampio Ø 63 mm

Manico a cucchiaio in acciaio inossidabile

CE 0124

Riester

32686 SFIGMO SANAPHON con stetoscopio integrato
Sfigmomanometro classico senza lattice per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato.
Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco.
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- in custodia con cerniera
Produzione tedesca.

32687 SFIGMO E-MEGA
Bracciale con polmone integrato disinsettabile e senza lattice.
- insufflazione rapida del bracciale grazie al design innovativo a cucchiaio.
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alle pressioni fino a 600 mmHg
- confortevole, con valvola di sfiato di precisione

32716 SFIGMO RIESTER R1
Sfigmo di precisione e lunga durata. Prodotto in Germania, 5 anni di garanzia sulla calibrazione.
- antishock fino ad un'altezza di 120 cm
- Scala: Ø 52 mm nera con pistone rosso fluorescente
- valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo
- raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- fornito di borsa con zip
- senza lattice

Riester



CE 0124

Scala facilmente leggibile Ø 64, da 0 a 300 mmHg, ± 3 mmHg

32715

Pulsante per sfiatamento rapido

Adatto agli utenti destri o mancini

32715 SFIGMO RI-SAN®

Sfigmomanometro ad alta qualità dal design ergonomico, con valvola a rilascio d'aria tramite pulsante, facilissimo da usare.
- bracciale calibrato in nylon con velcro
- pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
- tubo di collegamento del manometro per una manutenzione senza intralci
- un microfiltro protegge la valvola rilascio aria e il sistema di misurazione
- diaframma in berillio-rame temprato resistente nel tempo
- il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
- il diaframma può essere pressurizzato fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione.

Riester



CE 0124

Scala lineare graduata Ø 65 mm in alluminio, da 0 a 300 mmHg

32717

Valvola di sfiato di precisione

32717 SFIGMO PRECISA® N

Prodotto dalla tipica qualità Riester: con corpo in alluminio è ideale come apparecchio portatile per ambulatori ed ospedali. Bracciale calibrato in nylon con velcro.
- base della valvola in metallo e pera senza lattice
- manico ergonomico a cucchiaio in acciaio inox
- semplice collegamento a innesto del tubo
- microfiltro per la protezione della valvola di sfiato
- membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione praticamente inalterabile nel tempo
- membrana resistente a pressioni elevate fino a 600 mmHg.
- scala da 0 a 300 mmHg, ± 3 mmHg
Fornito in borsa in similpelle.

Riester



CE 0124

Erwachsene
Adults
Adultes
Adultos
Adulti

Arme
Arm Circumference
Circonference de bras
Perimetro del brazo
Circunferencia de brazo

32711

Riester



CE 0124

32711 SFIGMO MINIMUS® II

bracciale nero

Sfigmomanometro durevole, elegante ed affidabile con manometro cromato su pera senza lattice, bracciale in nylon nero con chiusura velcro, polmone ad un tubo.
Membrana in rame berillio - anti-usura.
Fornito in borsetta portasfigmo in similpelle.

ERKA VARIO DA TAVOLO, PARETE E MOBILE - PRODUZIONE TEDESCA



- 32671 VARIO - tavolo - 285.20.481
- 32672 VARIO - da parete - 288.20.481+295.00.003
- 32673 VARIO - su carrello Ø 50 cm - bracciale adulto + 288.20.481+995.00.003

Sfigmo di qualità superiore, prodotto in Germania per uso in ambulatorio o in ospedale. Dotato di un manometro di precisione in struttura di ABS con vite integrata di chiusura per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei bracciali in lamina d'acciaio bianca polverizzato, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfialto cromata di qualità per le regolazioni di precisione. La scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di vetro anti-riflesso.

- 32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 2 TUBI - 20,5-28 cm (circonf. braccio)
- 32899 BRACCIALE ADULTI "SUPERB" 2 TUBI - 27-35 cm (circonf. braccio) - ricambio
- 32900 BRACCIALE LARGE "SUPERB" 2 TUBI - 34-43 cm (circonf. braccio)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza con cestino: 260 mm (32672-3)
Larghezza con cestino: 180 mm (32672-3)
Profondità con cestino: 120 mm (32672-3)
Campo di misurazione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
Peso con il cestino: 1,350 g
Altezza della base: 830-1360 mm (regolabili)
Ø Tubo: 18-25 mm
Angolo di orientamento: fino a 60°

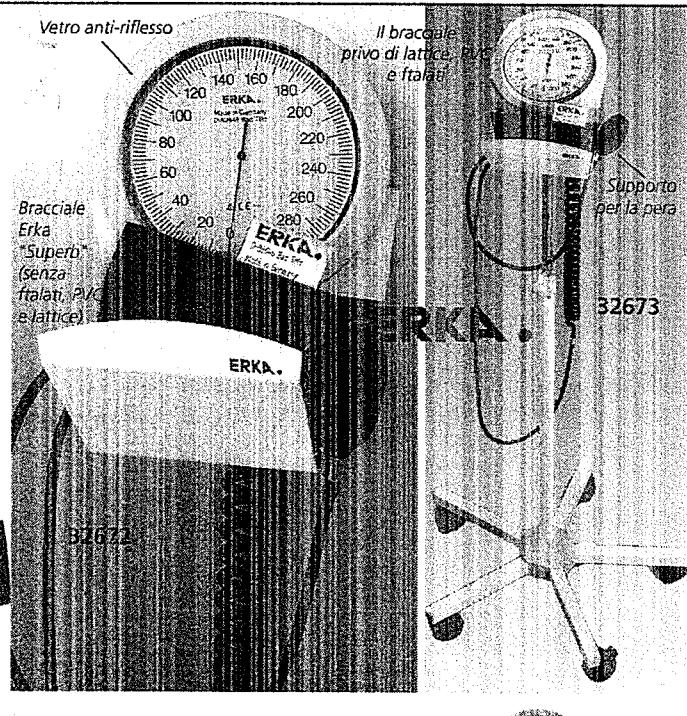


BIG BEN® RIESTER - PRODUZIONE TEDESCA

- 32742 BIG BEN® Riester - da rotaia (morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)
- 32743 BIG BEN® Riester - da parete
Rotazione 130°, 65° destra, 65° sinistra
- 32746 BIG BEN® Riester - su carrello Ø 54 cm
Sfigmomanometro aneroide con quadrante di 147 mm di diametro e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 mmHg a 300 mmHg.
Bracciale velcro nero a 2 tubi, tubo a spirale molto lungo, pratico cestello porta bracciale.
Latex free.
Di qualità elevata: produzione tedesca.
- 32766 MORSETTO ROTAIA per cod. 32742
Morsetto universale per ogni rotaia ospedaliera.

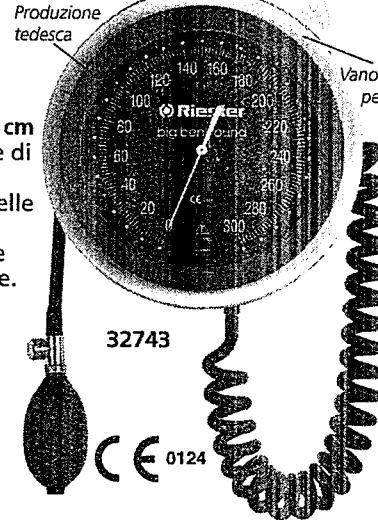

Riester

Vano in plastica
per accessori
sul retro

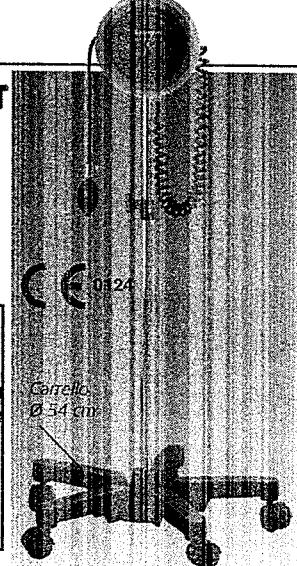

SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONALE OMRON

- 32936 MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE AUTOMATICO OMRON HEM-907

Misuratore di pressione professionale progettato per uso clinico in ambienti professionali

- precisione 'Gold Standard'
- convalidato secondo protocolli internazionali:
 - 1. Associazione per la promozione della Strumentazione Medica (AAMI)
 - 2. Società Europea di Ipertensione
 - Protocollo Internazionale (ESH - IP)
 - tecnologia Intellisense
 - indicatore polso irregolare
- 3. modalità di funzionamento: modalità singola misurazione,





modalità valore medio, modalità manuale (auscultazione)

Fornito con batteria, bracciale adulti (22-32 cm), alimentatore. Produzione giapponese.

- 32937 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-42 cm
- 32939 CARRELLO PER OMRON HEM-907

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo: oscillometrico
Campo di misurazione: pressione: 0-299 mmhg ± 3 mmHg o 2%
Frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto
± 5 % del rilevamento
Gonfiaggio: Gonfiaggio automatico a pompa
Sgonfiaggio: Sgonfiaggio automatico con valvola di controllo elettromagnetica
Rilascio dell'aria: Rilascio dell'aria veloce automatico con valvola di controllo elettromagnetica con capacità elettrostatica
Rilevazione della pressione: sensore di pressione semiconduttore
Alimentazione: Adattatore di c.a. 230 VAC, 50 Hz, 20 VA
Sistema di protezione contro scosse elettriche: Classe II tipo B
Dimensioni: 139x203x131 mm
Peso: circa 910 g
Conforme a: EN 1060, EN 60601-1-1 2007





GIMA

SFIGMO BIG BEN - carrello

Codice: 32746

Categoria: Sfigmomanometri aneroidi Riester
(carrello, parete..)

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I M

NSIS: 1151937


CND: C9006

EAN13: 8023279327465



Descrizione: Sfigmomanometro aneroide con quadrante di 147 mm di diametro e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 mmHg a 300 mmHg. Bracciale velcro nero, tubo a spirale molto lungo, pratico cestello porta bracciale. Latex free. Di qualità elevata: produzione tedesca.

SPHYGMOMANOMETERS

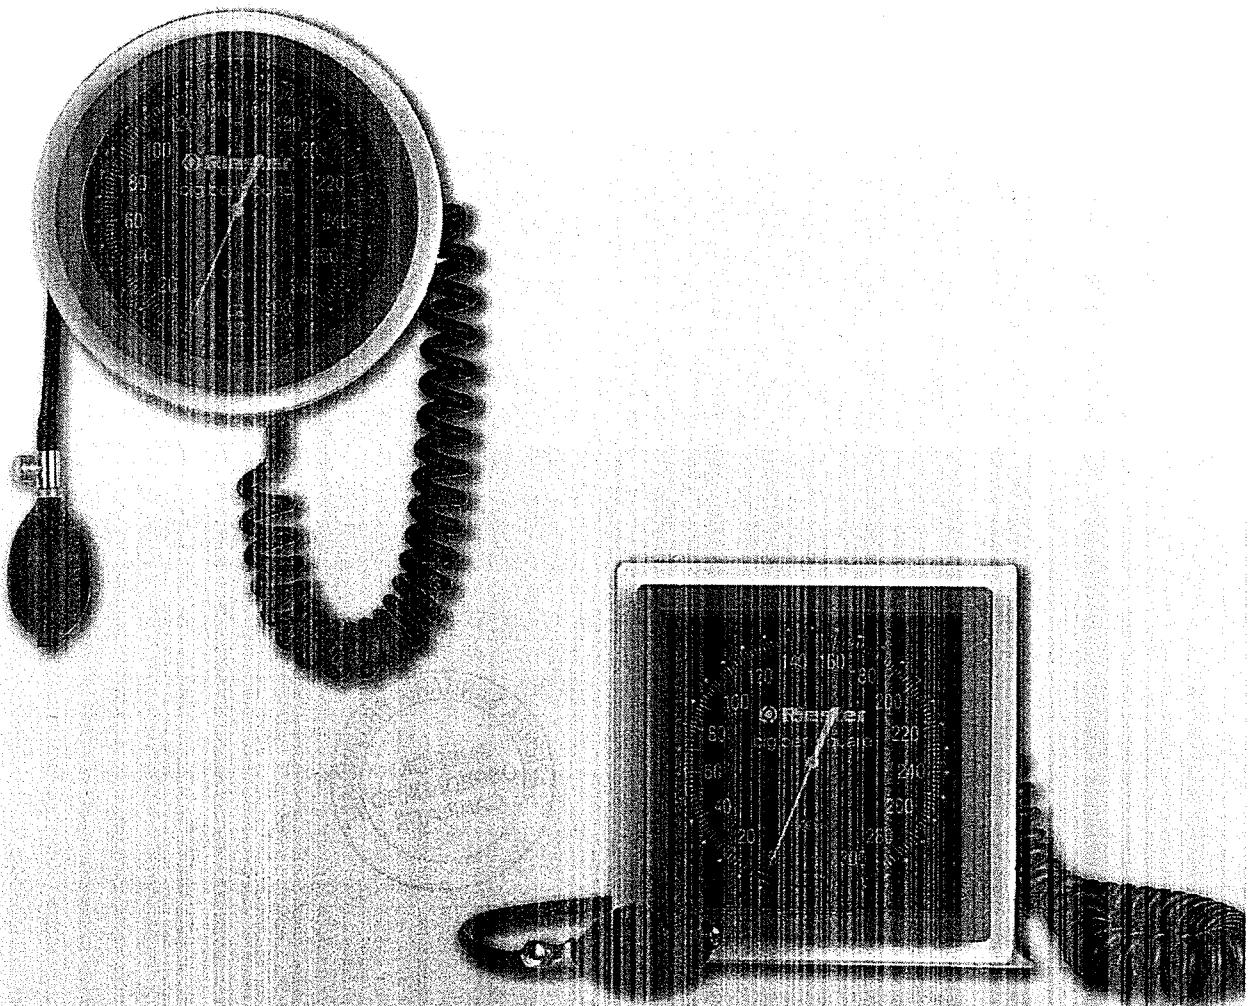


big ben®

Exact precision that lasts a lifetime.



BHS
VALIDATION

 **Riester**



big ben® LIFETIME MEASURING TECHNOLOGY



Lifetime measuring technology (pressure loading capacity up to 600 mmHg)


That is genuine Riester quality with lifetime calibration for everyday routine. Available as desk, wall, floor and rail design with complete range of cuffs (bladder cuffs or disinfectable one piece cuffs).

- Lifetime measuring technology withstands pressures of up to 600 mmHg
- Specially hardened copper-beryllium membrane, which is resistant to aging.
- Generously dimensioned scale (\varnothing 147.2 mm or \square 145.5 mm) and high-contrast scale layout for optimum readability; scale up to 300 mm Hg
- Spacious basket on the reverse side for tubes and cuffs
- Latex bulb to inflate the cuff
- Non-wearing air-release valve with fine adjustment
- Micro-filter to protect the release valve and measuring system
- Specially hardened copper-beryllium membrane, which is resistant to aging.
- No zero-point fixation required
- Maximum error tolerance: ± 3 mmHg

big ben® DESK DESIGN



Chromium-plated tube screw connection to allow quick changing of cuffs.



Spiral tube can be extended up to 3 m.

Bulb with precision release valve.


Order numbers

Bandage cuff, adult	round	No. 1451	square	No. 1454
Hook cuff, adult	round	No. 1452	square	No. 1455
Velcro cuff, adult	round	No. 1453	square	No. 1456
Velcro cuff, large adult	round	No. 1453-123	square	No. 1456-123
Velcro cuff, children	round	No. 1453-130	square	No. 1456-130
Manometer only, with desk base, without access.	round	No. 1453-100	square	No. 1456-100

A wide range of cuffs (bladder cuffs and disinfectable one piece cuffs) and appliances are available (quote LF for latex free).



big ben®
DESK DESIGN

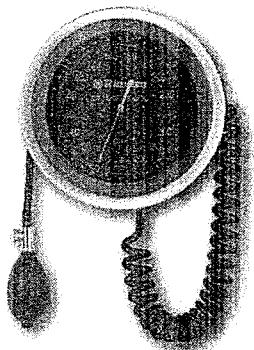

big ben® WALL DESIGN



Order numbers

Bandage cuff, adult	round	No. 1457	square	No. 1463
Hook cuff, adult	round	No. 1458	square	No. 1464
Velcro cuff, adult	round	No. 1459	square	No. 1465
Velcro cuff, large adult	round	No. 1459-123	square	No. 1465-123
Velcro cuff, children	round	No. 1459-130	square	No. 1465-130
Manometer only, with wall mount, without access.	round	No. 1459-100	square	No. 1465-100

For conversion to rail design:

Universal clamp for rail fastening

No. 10384



Device to swivel
sideways.
Spacious basket on
the reverse side for
tubes and cuffs



big ben® RAIL DESIGN

Order numbers

Bandage cuff, adult	round	No. 1486	square	No. 1493
Hock cuff, adult	round	No. 1487	square	No. 1494
Velcro cuff, adult	round	No. 1488	square	No. 1498
Velcro cuff, large adult	round	No. 1488-123	square	No. 1498-123
Velcro cuff, children	round	No. 1488-130	square	No. 1498-130
Manometer only, with rail support mount, without access.	round	No. 1488-100	square	No. 1498-100

Universal clamp for rail attachment


No. 10384

For conversion to wall design:

Wall mounting 3-holed, incl. 3 screws

No. 54663

A wide range of cuffs (bladder cuffs and disinfectable one piece cuffs) and appliances
are available (quote LF for latex free)



Fast attachment to a
conventional rails using
the universal clamp

big ben®

WALL-/RAIL DESIGN


big ben®

FLOOR DESIGN



big ben® floor design with mobile stand

- Height adjustable from 75 cm to 120 cm
- Diameter 53 cm
- Sturdy mobile base made of fibreglass and chrome plated pole
- Easy to move due to low friction castors
- Spacious basket on the reverse side (included) and optional basket attached to pole
small: L250 x B90 x H200 mm large: L230 x B230 x H250 mm

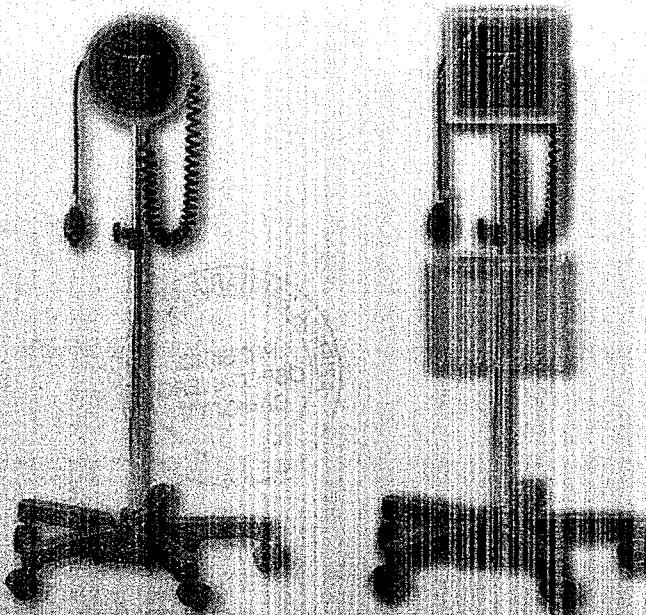

Order numbers

Bandage cuff, adult	round	No. 1466	square	No. 1476
Hock cuff, adult	round	No. 1467	square	No. 1477
Velcro-cuff, adult	round	No. 1468	square	No. 1478
Velcro-cuff, large adult	round	No. 1468-123	square	No. 1478-123
Velcro-cuff, children	round	No. 1468-130	square	No. 1478-130
Manometer only, without mobile stand, velcro cuff, adult	round	No. 1468-500	square	No. 1478-500
Basket	large	No. 10393	small	No. 10392

A wide range of cuffs (bladder cuffs and disinfectable one piece cuffs) and appliances are available (quote LF for latex free).

OMS S.r.l.s.

ORTOMEDISAN

ORTOPEDICI
MEDICALI
SANITARI

VIA REGINA ELENA, 83, 92024 CANICATTI' (AG)
 Cod. Fisc. 02764130841 - P.IVA 02764130841
 R.I. 02764130841 - C.C.I.A.A. AG
 Tel: 0922833637 - Fax: 0922833637
 NSIS

IBAN: IT53E0200882882000103424719

Destinazione Diversa

Tipo Documento PREVENTIVO	Data 18.09.2019	Numero 84
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

Spettile

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PO
 VIALE DELLA VITTORIA, 321
 92100 AGRIGENTO
 C.F. 02570930848

Codice 515

P.I. 02570930848

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Codice	Descrizione Articolo	Natura del Prodotto	Um	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Totale	Iva
V2202	SFIGMO RIESTER BHS 32717 LATEX FREE			10	64,000	15,00	544,00	22
V2203	SFIGMO RIESTER BHS SU CARRELLO 32746			10	190,000	15,00	1.615,00	22

Mi sonoole le schede Tesseriche Allegate di cui al preventivo in oggetto, si ottiene le conferme
 Tali tesseriche dei dispositivi richiesti!

01/10/2019

Luca Ferrera
 D.A.S.P. BOLLETTINO
 P.O. "B.na Lombardo" Canicattì
 RESPONSABILE SERVIZIO DI FARMACIA
 (Dr.ssa E. FERRERA)


Totali:	Merce	Pezzi	% Sconto	Firma
	2.159,00	20	0,00	
Annotazioni:				
RIF VS. RICHIESTA PROT.163581 DEL 27.09.19				

Codice	Descrizione Iva	Aliq. %	Imponibile	Imposta
0	ALIQUOTA 22%	22,00	2.159,00	474,98
0		0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00

Trasporto a cura del:	Spese Trasporto	Spese Bolli	Spese Varie	Spese Incasso	TOT.	2.159,00
Causale Trasporto: VENDITA				N° Colli: 0	Tot. Imposta	474,98
Vettore:	Aspetto Beni:				TOT. FATTURA	2.633,98
		Data Inizio Trasporto:	Ora Inizio Trasporto:			

Trattiamo i Vs. dati per fini amministrativi e contabili. Li tuttiamo rispettando la Privacy e a richiesta riamettiamo informativa completa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03. Contributo Co. Na, l'assalto ove dovuto il cliente-vettore che ritira la merce dichiarà con la propria firma che i/ii colli consegnati sono intatti, senza nessun segnale di manomissione e/o altro che pregiudichi il trasporto e/o l'integrità della merce.

SFIGMO ANEROIDI RIESTER - PRODUZIONE TEDESCA

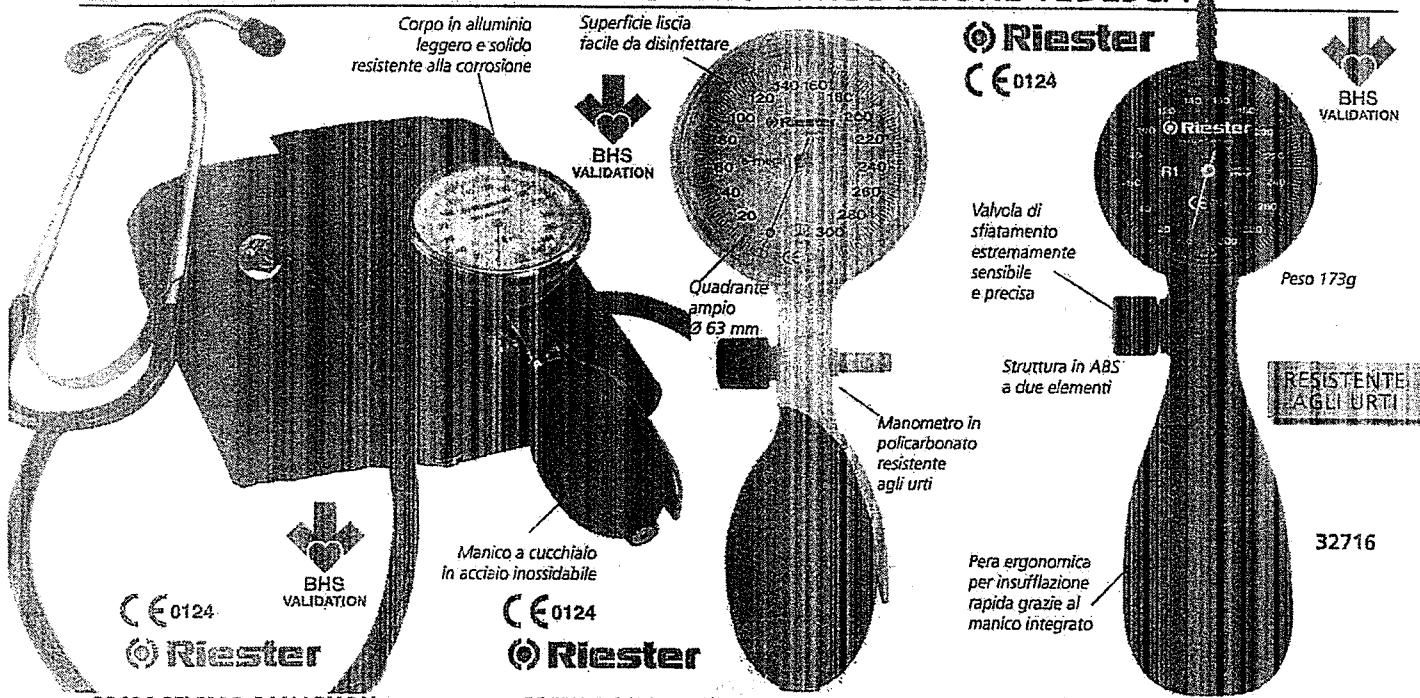

• 32686 SFIGMO SANAPHON con stetoscopio integrato
Sfigmomanometro classico senza lattice per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato.
Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco.
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- in custodia con cerniera
Produzione tedesca.

- 32687 SFIGMO E-MEGA
Bracciale con polmone integrato disinfebbilabile e senza lattice.
- insufflazione rapida del bracciale grazie al design innovativo a cucchiaio;
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alle pressioni fino a 600 mmHg
- confortevole, con valvola di sfiato di precisione

- 32716 SFIGMO RIESTER R1
Sfigmo di precisione e lunga durata.
Prodotto in Germania, 5 anni di garanzia sulla calibrazione.
- antishock fino ad un'altezza di 120 cm
- Scala: Ø 52 mm nera con pistone rosso fluorescente
- valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo
- raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore
- tolleranza massima di errore ± 3 mmHg
- fornito di borsa con zip
- senza lattice



• 32715 SFIGMO RI-SAN®
Sfigmomanometro ad alta qualità dal design ergonomico, con valvola a rilascio d'aria tramite pulsante, facilissimo da usare.
- bracciale calibrato in nylon con velcro
- pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
- tubo di collegamento del manometro per una manutenzione senza intralci
- un microfiltro protegge la valvola rilascio aria e il sistema di misurazione
- diaframma in berillio-rame temprato resistente nel tempo
- il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
- il diaframma può essere pressurizzato fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione.



• 32717 SFIGMO PRECISA® N
Prodotto dalla tipica qualità Riester: con corpo in alluminio è ideale come apparecchio portatile per ambulatori ed ospedali.
Bracciale calibrato in nylon con velcro.
- base della valvola in metallo e pera senza lattice
- manico ergonomico a cucchiaio in acciaio inox
- semplice collegamento a innesto del tubo
- microfiltro per la protezione della valvola di sfiato
- membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione praticamente inalterabile nel tempo
- membrana resistente a pressioni elevate fino a 600 mmHg.
- scala da 0 a 300 mmHg, ± 3 mmHg
Fornito in borsa in similpelle.






• 32711 SFIGMO MINIMUS® II
bracciale nero
Sfigmomanometro durevole, elegante ed affidabile con manometro cromato su pera senza lattice, bracciale in nylon nero con chiusura velcro, polmone ad un tubo.
Membrana in rame berillio - anti-usura.
Fornito in borsetta portasfigmo in similpelle.

ERKA VARIO DA TAVOLO, PARETE E MOBILE - PRODUZIONE TEDESCA

- 32671 VARIO - tavolo - 285.20.481
 - 32672 VARIO - da parete - 288.20.481+295.00.003
 - 32673 VARIO - su carrello Ø 50 cm - bracciale adulto + 288.20.481+995.00.003
- Sfigmo di qualità superiore, prodotto in Germania per uso in ambulatorio o in ospedale. Dotato di un manometro di precisione in struttura di ABS con vite integrata di chiusura per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei braccioli in lamina d'acciaio bianca polverizzata, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfato cromata di qualità per le regolazioni di precisione. La scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di vetro anti-riflesso.
- 32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 2 TUBI - 20,5-28 cm (circonf. braccio)
 - 32899 BRACCIALE ADULTI "SUPERB" 2 TUBI - 27-35 cm (circonf. braccio) - ricambio
 - 32900 BRACCIALE LARGE "SUPERB" 2 TUBI - 34-43 cm (circonf. braccio)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza con cestino: 260 mm (32672-3)
 Larghezza con cestino: 180 mm (32672-3)
 Profondità con cestino: 120 mm (32672-3)
 Campo di misurazione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
 Peso con il cestino: 1,350 g
 Altezza della base: 830-1360 mm (regolabili)
 Ø Tubo: 18-25 mm
 Angolo di orientamento: fino a 60°.

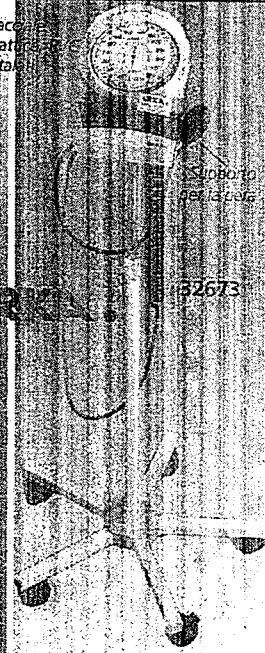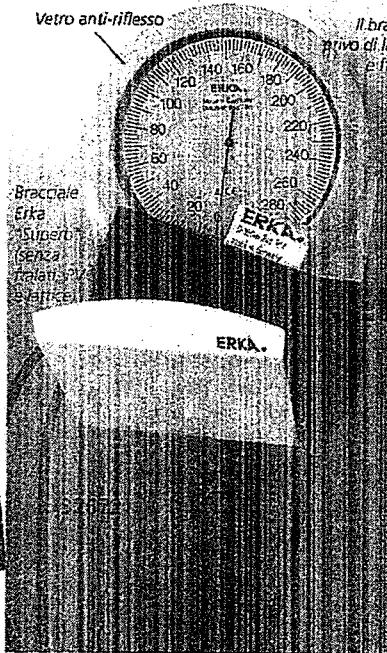



BIG BEN® RIESTER - PRODUZIONE TEDESCA

- 32742 BIG BEN® Riester - da rotaia (morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)
 - 32743 BIG BEN® Riester - da parete: Rotazione 130°, 65° destra, 65° sinistra
 - 32746 BIG BEN® Riester - su carrello Ø 54 cm Sfigmomanometro aneroide con quadrante di 147 mm di diametro e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 mmHg a 300 mmHg. Bracciale velcro nero a 2 tubi, tubo a spirale molto lungo, pratico cestello porta bracciale. Latex free.
- Di qualità elevata: produzione tedesca.
- 32766 MORSETTO ROTAIA per cod. 32742 Morsetto universale per ogni rotaia ospedaliera.

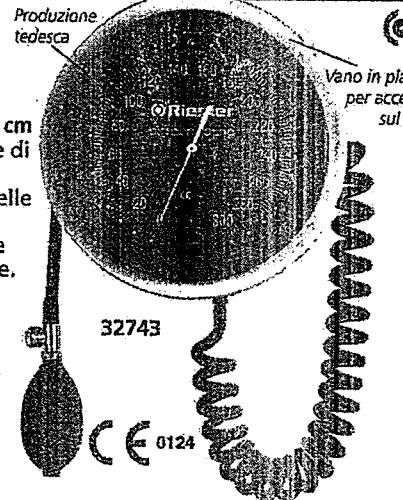

Riester

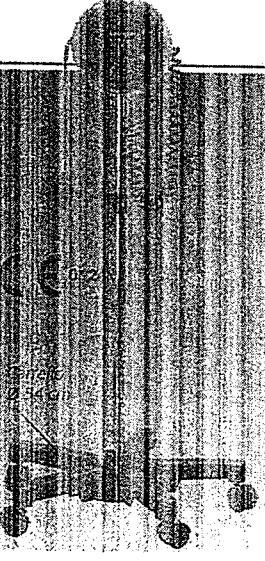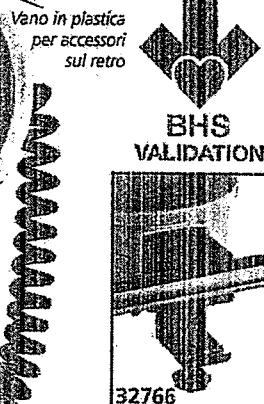

SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONALE OMRON

- 32936 MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE AUTOMATICO OMRON HEM-907 Misuratore di pressione professionale progettato per uso clinico in ambienti professionali - precisione 'Gold Standard' - convalidato secondo protocolli internazionali: 1. Associazione per la promozione della Strumentazione Medica (AAMI) 2. Società Europea di ipertensione - Protocollo Internazionale (ESH - IP) - tecnologia Intellisense - indicatore polso irregolare 3 modalità di funzionamento: modalità singola misurazione,



modalità valore medio, modalità manuale (auscultazione)

Fornito con batteria, bracciale adulti (22-32 cm), alimentatore. Produzione giapponese.

- 32937 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-42 cm
- 32939 CARRELLO PER OMRON HEM-907

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo: oscillografico
 Campo di misurazione: pressione: 0-299 mmHg ± 3 mmHg o 2%
 Frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto ± 5 % del rilevamento
 Gonfiaggio: Gonfiaggio automatico a pompa
 Sgonfiaggio: Sgonfiaggio automatico con valvola di controllo elettromagnetica
 Rilascio dell'aria: Rilascio dell'aria veloce automatico con valvola di controllo elettromagnetica
 Rilevazione della pressione: sensore di pressione semiconduttore con capacità elettrostatica
 Alimentazione: Adattatore di c.a. 230 VAC, 50 Hz. 20 VA
 Sistema di protezione contro scosse elettriche: Classe II tipo B
 Dimensioni: 139x203x131 mm
 Peso: circa 910 g
 Conforme ai: EN 1060, EN 50601-1-1 2007





SFIGMO BIG BEN - carrello

Codice: 32746

Categoria: Sfigmomanometri aneroidi Riester
(carrello, parete..)

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I M

NSIS: 1151937

CND: C9006

EAN13: 8023279327465


Descrizione: Sfigmomanometro aneroide con quadrante di 147 mm di diametro e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 mmHg a 300 mmHg. Bracciale velcro nero, tubo a spirale molto lungo, pratico cestello porta bracciale. Latex free. Di qualità elevata: produzione tedesca.




SPHYGMOMANOMETERS



© Riester



big ben® LIFETIME MEASURING TECHNOLOGY




Lifetime measuring
technology
(pressure loading
capacity up to 600
mmHg)

That is genuine Riester quality with lifetime calibration for everyday routine. Available as desk, wall, floor and rail design with complete range of cuffs (bladder cuffs or disinfectable one piece cuffs).


- Lifetime measuring technology withstands pressures of up to 600 mmHg
- Specially hardened copper-beryllium membrane, which is resistant to aging.
- Generously dimensioned scale (\varnothing 147.2 mm or \square 145,5 mm) and high-contrast scale layout for optimum readability; scale up to 300 mm Hg
- Spacious basket on the reverse side for tubes and cuffs
- Latex bulb to inflate the cuff
- Non-wearing air-release valve with fine adjustment
- Micro-filter to protect the release valve and measuring system
- Specially hardened copper-beryllium membrane, which is resistant to aging.
- No zero-point fixation required
- Maximum error tolerance: ± 3 mmHg



Chromium-plated tube
screw connection to
allow quick changing
of cuffs.



Spiral tube can be
extended up to 3 m.



Bulb with a quick
release valve.

big ben® DESK DESIGN




Order numbers:

Bandage cuff, adult	round	No. 1451	square	No. 1454
Hook cuff, adult	round	No. 1452	square	No. 1455
Velcro cuff, adult	round	No. 1453	square	No. 1456
Velcro cuff, large adult	round	No. 1457-123	square	No. 1458-123
Velcro cuff, children	round	No. 1458-130	square	No. 1459-130
Manometer only, with desk base, without access	round	No. 1459-100	square	No. 1460-100

A widerange of cuffs (bladder cuffs and disinfectable one piece cuffs) are available (subject to fast delivery).

big ben®


DESK DESIGN

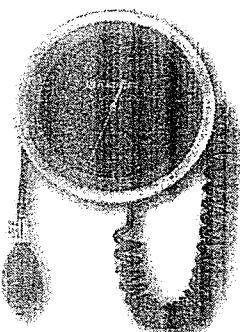

big ben® WALL DESIGN

Order numbers

Bandage cuff, adult	round	No. 1457	square	No. 1463
Hook cuff, adult	round	No. 1458	square	No. 1464
Velcro cuff, adult	round	No. 1459	square	No. 1465
Velcro cuff, large adult	round	No. 1459-123	square	No. 1465-123
Velcro cuff, children	round	No. 1459-130	square	No. 1465-130
Manometer only, with wall mount, without access.	round	No. 1459-100	square	No. 1465-100

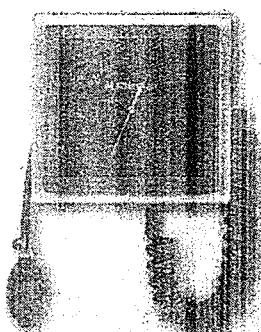


For conversion to rail design:
Universal clamp for rail fastening

No. 10384



Device to swivel,
sideways.
Spacious basket on
the reverse side for
tubes and cuffs.

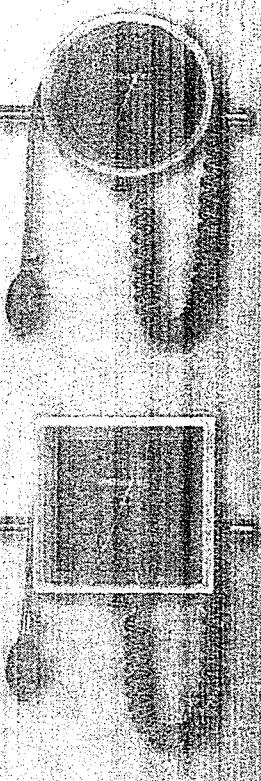

big ben® RAIL DESIGN

Order numbers

Bandage cuff, adult	round	No. 1486	square	No. 1493
Hook cuff, adult	round	No. 1487	square	No. 1494
Velcro cuff, adult	round	No. 1488	square	No. 1498
Velcro cuff, large adult	round	No. 1488-123	square	No. 1498-123
Velcro cuff, children	round	No. 1488-130	square	No. 1498-130
Manometer only, with wall support mount, without access	round	No. 1488-100	square	No. 1498-100
Universal clamp for wall attachment				No. 10384



For conversion to wall design:
Wall mounting kit, includes screws

No. 54663

A white coated steel plate (140 mm x 100 mm) is required for wall mounting. Wall plates and accessories are available in various quantities.



big ben®


WALL-/RAIL DESIGN

big ben® **FLOOR DESIGN**



big ben® floor design with mobile stand

- Height adjustable from 75 cm to 120 cm
- Diameter 53 cm
- Sturdy mobile base made of fibreglass and chrome plated pole
- Easy to move due to low friction castors
- Spacious basket on the reverse side (included) and optional basket attached to pole
small: L250 x B90 x H200 mm large: L230 x B230 x H250 mm

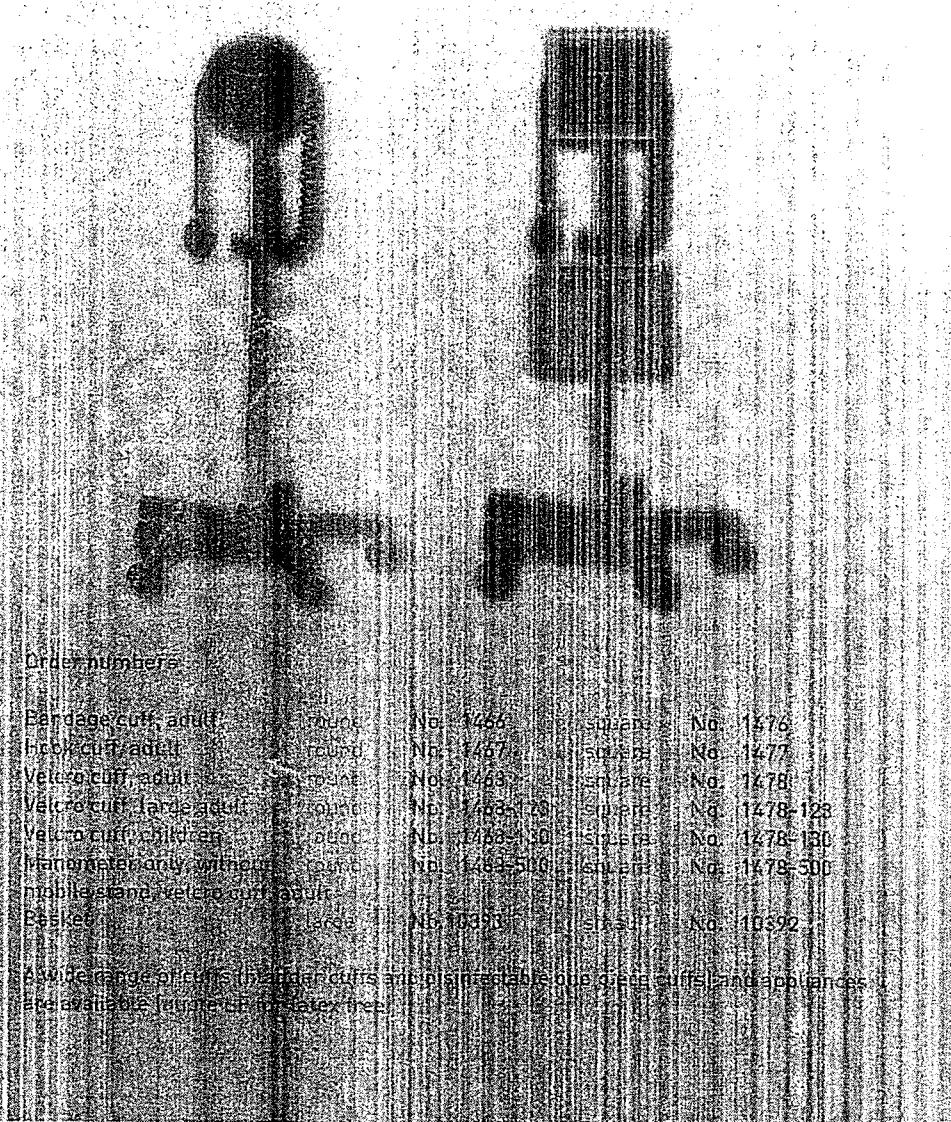

Order numbers:

Bedside-cuff, adult	No. 1466	square	No. 1476
Hock-cuff, adult	No. 1467	square	No. 1477
Velcro-cuff, adult	No. 1468	square	No. 1478
Velcro-cuff, large adult	No. 1469	square	No. 1479-128
Velcro-cuff, children	No. 1480	10.15x14 mm	No. 1479-130
Hammer-tether, only without cuff	No. 1481	10.15x14 mm	No. 1479-500
Hammer-tether, with cuff	No. 1482	10.15x14 mm	
Basket	No. 10390	various sizes	No. 10392

As a alternative or in addition to the cuffs and plates adjustable to the patient's current condition and appliances are available (number in parentheses):

Da "oms" <oms@casellapec.com>
A "pocanicatti@pec.aspag.it" <pocanicatti@pec.aspag.it>
Data mercoledì 2 ottobre 2019 - 12:01

10

Autocertificazione

Salve

In allegato si invia come richiesto autocertificazione e documenti identità
Cordiali saluti

Allegato(i)

autocertificazione_2.pdf (986 Kb)
carta identità cacciatore salvatore_1.pdf (6076 Kb)

A.S.P. AG R.C. CANICATTI
UFFICIO PROTOCOLLO

02 OTT 2019

E NTRATA
ADDETTO



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina dirigenziale, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n._____

ESECUTIVITA' DETERMINA

Immediatamente esecutiva dal 03-10-2018

Agrigento, li 03-10-2018

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li _____

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco