



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 396 DEL 10 MAR. 2020

OGGETTO: RDO ME.PA. aperta n. 2492825 tramite piattaforma ME.PA./Consip per la fornitura di n. 4 Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza Magnetica, n. 1 strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio, n. 1 Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia. **Approvazione operazioni di gara telematica e aggiudicazione fornitura.**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 480 DEL 09.03.2020

L'Istruttore
L'Assistente Amm.vo
Sig. Alfonso De Leo

IL RUP
Il Collaboratore Amministrativo
Dr. Giuseppe Sanfilippo

IL DIRETTORE UOC
SERVIZIO PROV.V.TO
Dr. Loredana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

101020907

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO

Dr. ANTONINO LA VALLE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 10 MAR. 2020

L'anno duemilaventi il giorno DIECI del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA FEDESco adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17;

PREMESSO che

- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 103 dell'11.12.2019 è stato autorizzato l'esperimento – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b -, di apposita procedura negoziata, tramite RDO ME.PA. aperta, per l'affidamento della fornitura, in tre lotti autonomi e indivisibili, di attrezzature sanitarie per l'U.O.C. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento;
- con la suddetta Deliberazione è stato approvato il documento denominato "Condizioni particolari di contratto", che disciplinava le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., dando atto che il criterio di aggiudicazione previsto era quello del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara, ex art. 36, comma 9/bis del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore all'importo alla soglia comunitaria;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto è il Dr. Giuseppe Sanfilippo – Collaboratore Amministrativo Esperto TPO della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore Consip/MEPA – e che il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il Dott. Salvatore Piraneo, Direttore dell'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, coadiuvati dal gruppo di lavoro prot. n.203698/2019;
- la suddetta gara è suddivisa in tre lotti autonomi ed indivisibili, per come segue:
 - **LOTTO 1: n. 4 Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza Magnetica,**
Importo complessivo del lotto € 18.800,00= + IVA;
 - **LOTTO 2: n. 1 Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio;**
Importo complessivo del lotto € 12.000,00= + IVA;
 - **LOTTO 3: n. 1 Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia;**
Importo complessivo base € 24.400,00= + IVA.
- in esecuzione della sopra citata delibera a contrarre si è proceduto in data 17.01.2020 alla pubblicazione della Richiesta di Offerta (RDO) n. 2492825 sulla piattaforma ME.PA./Consip, gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato Elettronico (previa abilitazione al Bando/Categoria della richiesta di offerta);

CONSIDERATO che entro il termine utile per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10:30 del 04.02.2020, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici riportati nella tabella sottostante:

Denominazione concorrente	Lotto di partecipazione	Data presentazione offerta
S.I.T. s.r.l.	1, 2 e 3	21/01/2020 14:25:26
TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	3	31/01/2020 12:47:23
FARMAC SRL	1	03/02/2020 10:54:49

PRESO ATTO che:

- con i verbali del 12.02.2020 il Responsabile dell'U.O. di Fisica Sanitaria ha espresso il seguente parere di conformità per le motivazioni meglio riportate nei predetti verbali che si allegna alla presente delibera:

S.L.T. s.r.l.	1	SI
FARMAC S.r.l.	1	SI
S.L.T. s.r.l.	2	SI
S.L.T. s.r.l.	3	SI
TECNOLOGIE AVANZATE TA S.r.l.	3	NON CONFORME

ATTESO che si è proceduto in data 18.02.2020 all'apertura delle buste economiche degli operatori economici ammessi a gara, giudicati conformi dal Direttore dell'U.O. di Fisica Sanitaria, rilevando quella con minor prezzo come risulta dalla graduatoria di cui agli allegati documenti "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute" di ciascun lotto, generati dalla piattaforma ME.PA./Consip, di seguito riportata:

Offrente	Lotto
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
S.L.T. s.r.l.	18.700,00
FARMAC S.r.l.	16.396,00
Offrente	Lotto 2
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
S.L.T. s.r.l.	11.500,00
Offrente	Lotto 3
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
S.L.T. s.r.l.	20.383,00
TECNOLOGIE AVANZATE TA S.r.l.	Offerta esclusa

DATO ATTO che l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., sarà garantito anche mediante nota pcc, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

PRESO ATTO che risulta possibile proporre l'affidamento della procedura negoziata - tramite RDO/MEPA n. 2492825 - per la fornitura, in tre lotti unici e indivisibili, agli operatori economici di cui sopra riportati in grassetto, alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta dei medesimi operatori economici, valutate conforme, come risulta dagli allegati documenti "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generati dalla medesima piattaforma;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 39927 del 04.03.2020, il Direttore dell'U.O.C. SEF ha restituito, in osservanza alle determinazioni assunte dalla Direzione Aziendale e comunicate all'Assessorato Regionale alla Salute, la proposta di delibera n. 336 del 20.02.2020 di affidamento della RDO/MEPA n. 2492825 per la fornitura in parola;
- la U.O.C. Servizio Provveditorato con nota prot. n. 41583 del 05.03.2020, ha comunicato al Responsabile della U.O. di Fisica Sanitaria di questa ASP, che saranno autorizzate le spese relative al conto esercizio del bilancio 2020 solo se motivate da carattere dell'urgenza e indifferibilità;
- il Responsabile dell'U.O. richiedente ha motivato, con nota prot. n. 42802 del 09.03.2020, le ragioni di inderogabilità e urgenza, nota che si allega al presente atto;
- l'intervento di acquisto in argomento è inserito nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel piano biennale degli acquisti 2020-2021, giusto atto deliberativo del Direttore Generale f.f. n. 103 dell' 11.12.2019;

- l'onere derivante dal presente atto, ammontante ad € 60.007,38=IVA e competenze interne incluse, ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura	€ 48.279,00
IVA aliquota 22%	€ 10.621,38
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 1.104,00
TOTALE	€ 60.007,38

deve essere imputato, sul conto patrimoniale n. A101020907 per € 60.007,38, giusta nota SEFP prot. 323 del 02/01/2020;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2492825, come risultano dagli allegati documenti "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" di ciascun lotto, generati dalla medesima piattaforma per ciascun lotto, e riportate in premessa;
- AGGIUDICARE** la procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta RDO/aperta n. 2492825 tramite piattaforma ME.PA./Consip fornitura, in 3 lotti, di attrezzature per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, ai seguenti operatori economici, alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta dei medesimi operatori economici:

Offerta	Lotto 1
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
FARMAC S.r.l.	16.396,00

Offerta	Lotto 2
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
S.L.T. s.r.l.	11.500,00

Offerta	Lotto 3
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
S.L.T. s.r.l.	20.383,00

- AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con i suddetti operatori economici, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto, ammontante ad € 60.007,38=IVA e competenze interne incluse, ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura, in somm. annuale, di radiofarmaci	€ 48.279,00
IVA aliquota 10%	€ 10.621,38
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 1.104,00
TOTALE	€ 60.007,38

deve essere imputato, sul conto patrimoniale n. A101020907 per € 60.007,38, giusta nota SEFP prot. 323 del 02/01/2020;

- DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse;

6. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'immediata attivazione della fornitura di cui al presente provvedimento.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere _____

Data _____

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dr.ssa Loredana Di Salvo della U.O.C. Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr.ssa Loredana Di Salvo della U.O.C. Servizio Provveditorato.

IL DIRETTORE SANITARIO


Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara

Il Segretario verbalizzante

UFFICIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DECRETI E ANNULLI
Dott.ssa Patrizia Tedesco

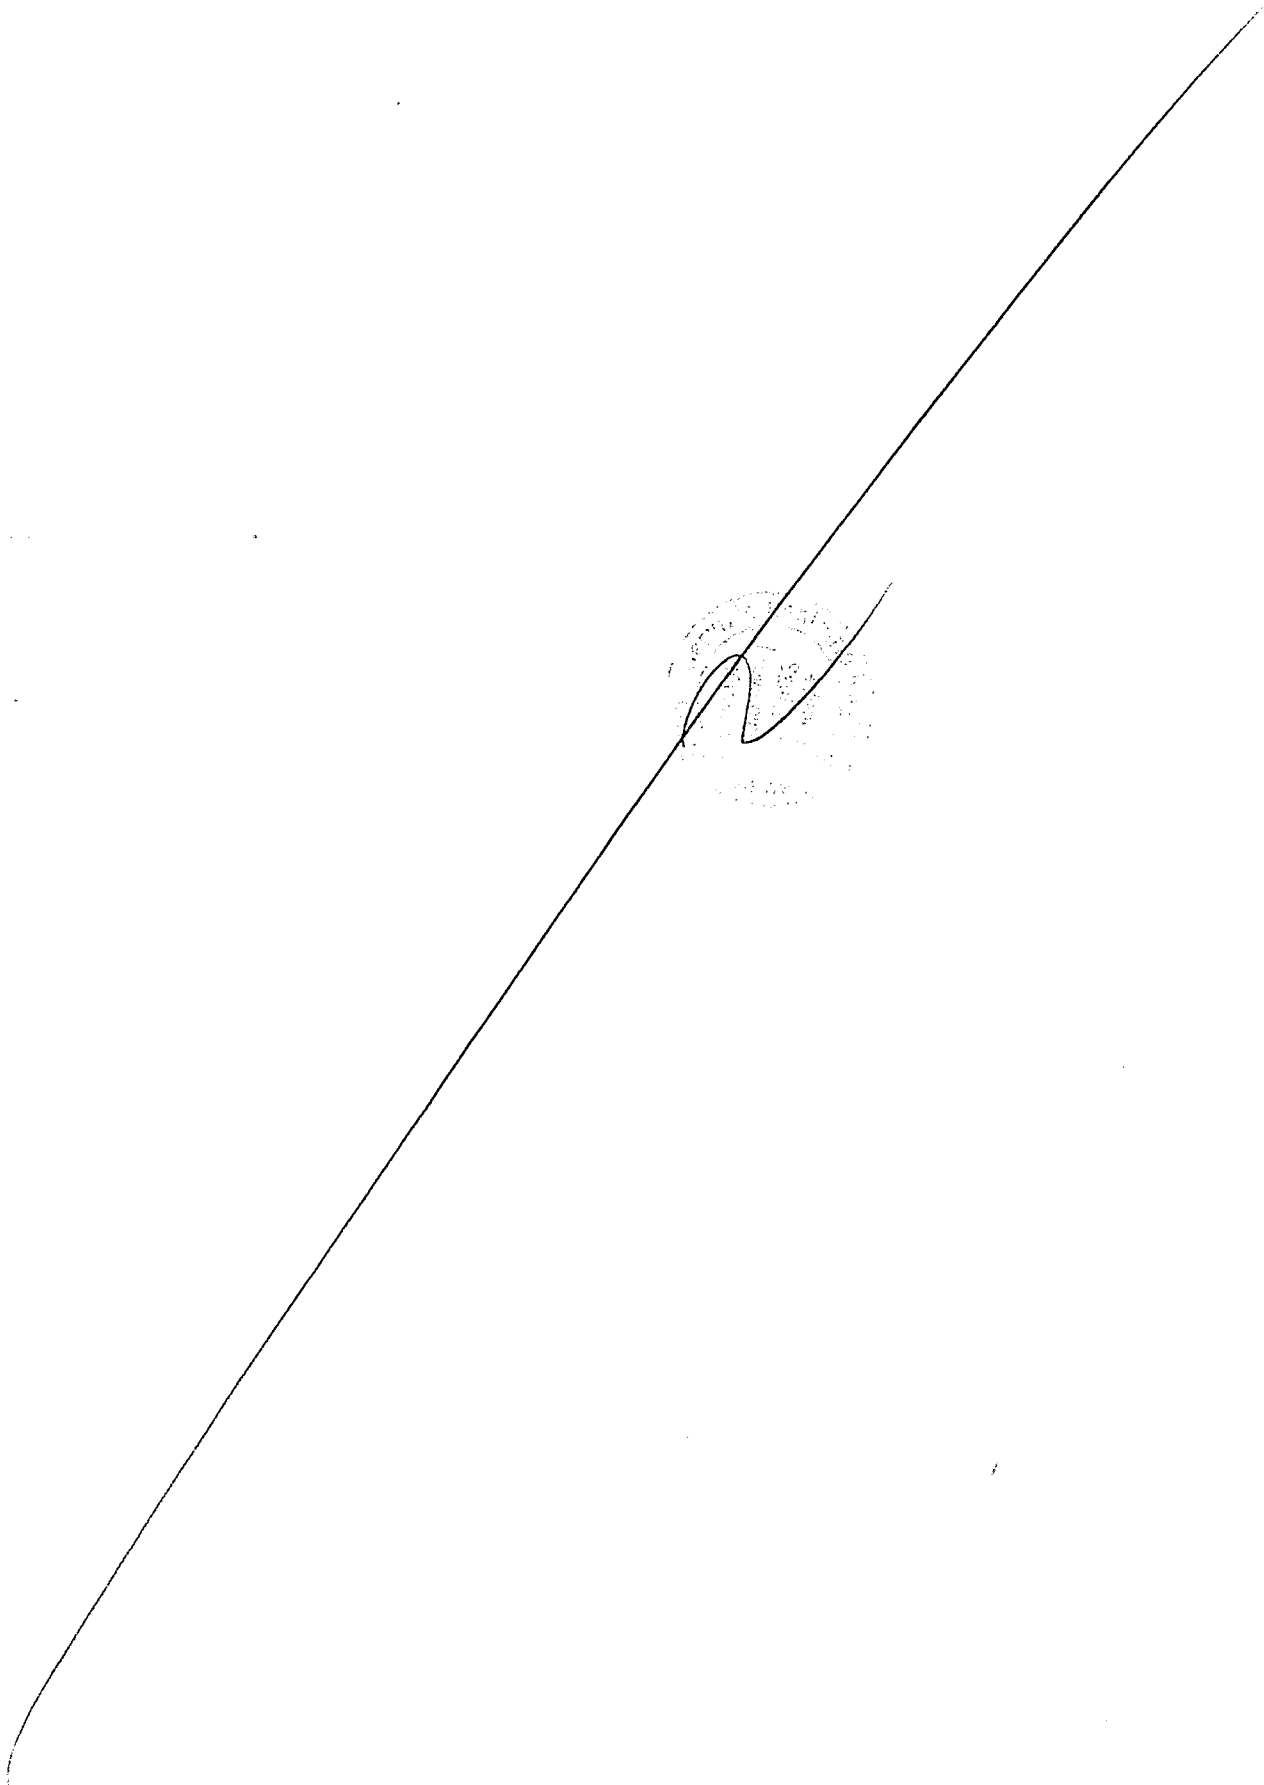



Agrigento, 09/03/2020
Prot. 0042802

Al Direttore UOC Provveditorato
e.p.c. Al Capo Dipartimento
di Scienza Radiologiche

OGGETTO: Riscontro nota 41583 del 05/03/2020 con oggetto: RDO/ME.PA. aperta n. 2492825 per la fornitura di n. 4 Rivelatori di materiale ferromagnetico, n. 1 Strumentazione per controlli di qualità e n. 1 Multimetro digitale per controlli di qualità in Radiologia. Proposta di delibera n. 336 del 20.02.2020

In riferimento alla richiesta di attestazione di urgenza ed indifferibilità nell'acquisto del materiale in oggetto, si precisa quanto segue. Dopo una lunga corrispondenza iniziata nel 2019 con il Servizio Provveditorato si prova a sintetizzare inderogabilità e l'urgenza di tali dispositivi:

A. LOTTO 1: n. 4 Rivelatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza Magnetica

L'obbligo di dotare i siti di Risonanza Magnetica di rilevatori atti a individuare metalli ferromagnetici è obbligo di Legge (Decreto del Ministero della Salute 10/08/2018).

Serve a rilevare la presenza di materiale ferromagnetico che possa arrecare danni gravissimi ai pazienti che si sottopongono ad esame RM. Questo presidio, che è obbligatorio dal 2019, ad oggi manca nelle nostre quattro Risonanze Magnetiche. Un eventuale danno al paziente non troverebbe giustificazione. Gli attuali Metal Detector sono vietati. L'INAIL di Roma sta ispezionando a tappeto tutti i siti.

Il decreto è stato bloccato per alcuni mesi e dal 2019 è in vigore.

Abbiamo due possibilità:

CHIUDERE LE RISONANZE MAGNETICHE O

ADEGUARCI. Ovviamente ogni decisione ultima è dell'esercente - Direttore Generale.


Tali rilevatori verranno consegnati ai radiologi e ai TSRM dei quattro siti, che li utilizzeranno prima di ogni esame. Quindi saranno ubicati al PO di Agrigento, al PO di Canicattì, al PO di Licata e al PO di Sciacca

Si conferma pertanto, l'urgenza e la nderogabilità dei suddetti dispositivi rispetto ai quali siamo già in ritardo rispetto al Decreto del Ministero della Salute 10/08/2018

B. LOTTO 2: n. 1 Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio.

Nello screening mammografico è prevista oltre alla mammografia e La RM, anche il controllo ecografico (Ultrasuoni). Come indicato nel Decreto del Ministero della Salute 10/08/2018, sono necessari i controlli di qualità su RM, sul mammografo e sull'ecografo, ai sensi della Circolare LR 154 al Ministero della salute e le norme CEI 62-131 e le norme CEI 62-124 impongono tali controlli. Per problemi di personale e di ritardo sugli acquisti, tali controlli non sono stati fatti e quindi, anche in questo settore, ad oggi, non abbiamo NULLA

Per quanto sopra si conferma l'urgenza, la nderogabilità dei suddetti dispositivi per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni

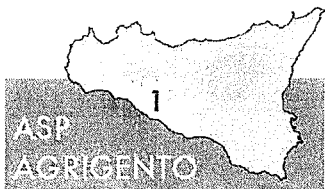

C. LOTTO 3: n. 1 Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale, TC, Mammografia e Fluoroscopia.

All'Art. 8 D, Lgs. 187/00 si impone di effettuare prove di accettazione e collaudo, oltre che Controlli di Qualità, sulle apparecchiature radiologiche. In proposito, anche la Direttiva Eutatom 59/2013, in fase di recepimento ma già ha valore di Legge, lo conferma con maggiori vincoli e più stretti controlli.

Per effettuare tali controlli è necessario il suddetto multimetro, tenuto conto che quello di cui disponiamo è tecnologicamente superato, ha più di 10 anni e non riesce a controllare le apparecchiature. **Al Poliambulatorio di Palma di Montechiaro, in fase di collaudo, ci siamo fatti prestare il multimetro della Ditta fornitrice del mammografo, poichè il nostro si è rivelato inadeguato.**

Le apparecchiature mammografiche per esempio fanno combinazioni tali di pista filtro, che noi non riusciamo ad impostare, perché non presenti nel multimetro in uso oggi.

Nel 2016, a seguito di indagine di mercato, per una riparazione ci hanno sconsigliato di ripararlo perché obsoleto. Riparazione effettuata con geometra Biancucci dell'Ufficio Tecnico. I prossimi collaudi di angiografi ed altre apparecchiature ci mettono in difficoltà.

Non siamo in grado con tale strumento Multimetro Digitale della Fluke Biomedical.

Per quanto sopra si conferma l'urgenza, la inderogabilità dei suddetti dispositivi Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale, TC, Mammografia e Fluoroscopia.

La tecnologia si evolve e quindi la strumentazione di controllo deve precedere tali passi tecnologici. I dispositivi di cui sopra richiesti con urgenza già dal 2019, con note specifiche che chiariscono anche esse l'urgenza e la inderogabilità

Dott. Salvatore Piraneo
Esperto Qualificato di III grado n°559
Esperto Responsabile sulla Sicurezza RM



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Prot. 30130
Agrigento, 17/02/2020

All'U.O.C. Servizio Provveditorato

OGGETTO: Trasmissione verbali di gara, RDO Me./PA 2492825 Gara 7641659, LOTTO 1-2-3.

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, ed in risposta a Vs comunicazione mail del 11-02-2020 relativa ai lotti di assegnazione rispettivamente di n° 4 rivelatori di metalli ferromagnetici (LOTTO 1), di n° 1 strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio (LOTTO 2) e di n° 1 multimetro digitale per controlli di qualità in radiologia tradizionale, CT, Mammografia e Fluoroscopia (LOTTO 3), si inviano i verbali di gara con i pareri di conformità relativi alle singole offerte pervenute a questa U.O. di Fisica Sanitaria, e valutate secondo le schede tecniche allegate alla procedura ufficiale di gara.

Il Responsabile della U.O. di Fisica Sanitaria
Dott. Salvatore PIRANEO



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata RDO/Me.PA. per l'affidamento della fornitura di rivelatori di materiali ferromagnetici in ambienti di Risonanza Magnetica.

RDO Me./PA. 2492825 – Gara 7641659 – Codice CIG 8153236730 – (LOTTO 1).

In data 11/02/2020 alle ore 16:30, la scrivente U.O. di Fisica Sanitaria, ricevuta da parte del Servizio Provveditorato comunicazione riguardante la fornitura di rivelatori di materiali ferromagnetici in ambienti di Risonanza Magnetica da affidare con RDO/Me.PA **2492825**, Gara **7641659** e codice **CIG 8153236730**, procede alla analisi documentale degli allegati.

Dopo la verifica delle procedure di affidamento negoziato, cui è allegata la scheda dei requisiti tecnici richiesti dalla fornitura, si riscontra quanto di seguito riportato.


Per il LOTTO 1, relativo alla fornitura di n° 4 rivelatori di materiali ferromagnetici in ambienti di Risonanza Magnetica, presentano l'offerta tecnica due ditte, la S.L.T. S.r.l. e la FARMAC S.r.l.

Dalla analisi documentale allegata alle comunicazioni del Servizio Provveditorato risulta che entrambe le strumentazioni offerte in gara rispondono pienamente alle caratteristiche richieste, come da schede riepilogative allegate dalle ditte medesime, in conformità a quanto richiesto espressamente da procedure di gara al punto 3 dell'elenco degli allegati da presentare a corredo dell'offerta economica.

Pertanto, la ditta:

- FARMAC S.r.l. presenta un'offerta **CONFORME**;
- SLT S.r.l. presenta un'offerta **CONFORME**.

Il Responsabile della U.O. di Fisica Sanitaria
Dott. Salvatore PIRANEO

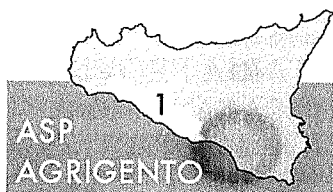

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata RDO/Me.PA. per l'affidamento della fornitura di strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio.
RDO Me./PA. 2492825 – Gara 7641659 – Codice CIG 81532567B1 – (LOTTO 2).

In data 12/02/2020 alle ore 9:30, la scrivente U.O. di Fisica Sanitaria, dopo aver ricevuto da parte del Servizio Provveditorato comunicazione riguardante la fornitura di strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio da affidare con RDO/Me.PA. **2492825**, gara **7641659** e codice **CIG 81532567B1**, procede alla analisi documentale degli allegati.

Dopo la verifica delle procedure di affidamento negoziato, cui è allegata la scheda dei requisiti tecnici richiesti dalla fornitura, si riscontra quanto di seguito riportato.


Per il LOTTO 2, relativo alla fornitura di n° 1 strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio, presenta l'offerta tecnica la sola ditta S.L.T. S.r.l..

Dalla analisi documentale allegata alle comunicazioni del Servizio Provveditorato risulta che la strumentazione offerta in gara risponde pienamente alle caratteristiche richieste, come da scheda riepilogativa allegata dalla ditta, in conformità a quanto richiesto espressamente da procedure di gara al punto 3 dell'elenco degli allegati da presentare a corredo dell'offerta economica.

Pertanto, la ditta:

- SLT S.r.l. presenta un'offerta **CONFORME**.

Il Responsabile della U.O. di Fisica Sanitaria
Dott. Salvatore PIRANEO

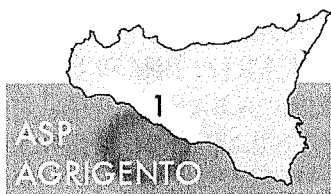

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata RDO/Me.PA. per l'affidamento della fornitura di multimetro digitale per controlli di qualità in radiologia tradizionale, CT, Mammografia e Fluoroscopia.
RDO Me./PA. 2492825 – Gara 7641659 – Codice CIG 81532724E6 – (LOTTO 3).

In data 12/02/2020 alle ore 10:30, la scrivente U.O. di Fisica Sanitaria, dopo aver ricevuto da parte del Servizio Provveditorato comunicazione riguardante la fornitura di multimetro digitale per controlli di qualità in radiologia tradizionale, CT, Mammografia e Fluoroscopia da affidare con RDO/Me.PA. **2492825**, gara **7641659** e codice **CIG 81532724E6**, procede alla analisi documentale degli allegati.

Dopo la verifica delle procedure di affidamento negoziato, cui è allegata la scheda dei requisiti tecnici richiesti dalla fornitura, si riscontra quanto di seguito riportato.


Per il LOTTO 3, relativo alla fornitura di n° 1 multimetro digitale per controlli di qualità in Radiologia Tradizionale, CT, Mammografia e Fluoroscopia, presentano l'offerta tecnica le ditte, S.L.T. S.r.l. e Tecnologie Avanzate TA S.r.l..

Dalla analisi documentale allegata alle comunicazioni del Servizio Provveditorato risulta che la strumentazione offerta in gara dalla ditta SLT S.r.l. risponde alle caratteristiche richieste, come da scheda riepilogativa allegata dalla ditta, in conformità a quanto richiesto espressamente da procedure di gara al punto 3 dell'elenco degli allegati da presentare a corredo dell'offerta economica.

Dall'analisi documentale degli allegati forniti dalla ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.l. si riscontra che le seguenti caratteristiche disattendono le richieste di gara:

Sensore per Radiologia tradizionale, Fluoroscopia e Radiologia Dentale

1. Range di dose del sensore per radiologia tradizionale fino a 1000 Gy.
 - a. La ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.l. offre un sensore con range di dose massimo pari a 100 Gy.
2. Range di "dose rate" del sensore per radiologia tradizionale fino a 500 mGy/s.
 - a. La ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.l. offre un sensore con range di dose rate massimo pari a 200 mGy/s.

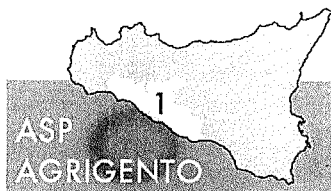

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Sensore specifico per mammografia

1. Range di HVL misurabile, del sensore specifico per mammografia, da 0.2–3.6 mm Al.
 - a. La ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.l. offre un sensore mammografico capace di garantire una misura di HVL da 0.2 mm a 2 mm di Al.
2. Accuratezza della sonda per mammografia, nella misura dell'HVL, nel range clinico, del 5 %.
 - a. La ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.l. offre un sensore mammografico capace di garantire una accuratezza, nel range clinico, pari al 10 %.

Sensore per il controllo di qualità dei monitors di refertazione

1. Sonda per controllo di lux ambientali fino a 100.000 lux.
 - a. La ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.l. offre un sensore per controlli di qualità su monitors che garantiscono un valore massimo di illuminamento ambientale di 50.000 lux.

Sensore per misure di radioprotezione

1. Sonda con possibilità di misurare direttamente la dose equivalente.
 - a. La ditta Tecnologie Avanzate TA S.r.l. offre un sensore che **non** misura la dose equivalente, e non presenta a corredo dell'offerta alcun prodotto che possa considerarsi equivalente e migliorativo.

Per quanto sopra analizzato e trascritto si conclude che:

- SLT S.r.l. presenta un'offerta **CONFORME**.
- Tecnologie Avanzate TA S.r.l. presenta un'offerta **NON CONFORME**.

Il Responsabile della U.O. di Fisica Sanitaria
Dott. Salvatore PIRANEO

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2492825
Descrizione RDO:	Fornitura di apparecchiature varie per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	LOREDANA DI SALVO
Soggetto stipulante	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	17/01/2020 14:28
Termine ultimo presentazione offerte:	04/02/2020 10:30
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	27/01/2020 00:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	04/08/2020 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	45
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali

	di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 N. 4 Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza magnetica.

CIG	8153236730
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	N. 4 Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza magnetica./4/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	18800,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	S.L.T.	Singola	00881170153	21/01/2020 14:25
2	FARMAC SRL	Singola	02459120875	03/02/2020 10:54

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	07/02/2020 13:52:16	11/02/2020 15:11:45

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Condizioni Particolari di Contratto		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
S.L.T.		nessuna		nessuna		nessuna
FARMAC SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione di cui al punto 1 del Documento "Condizioni Particolari di Contratto"	
	Valutazione	Note
S.L.T.	Approvato	nessuna
FARMAC SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	11/02/2020 15:11:52	18/02/2020 09:47:04

Concorrente	Certificato CE del bene offerto in corso di validità rilasciato dal produttore.		Dichiarazione resa dal produttore di cui al punto 4) del documento "Condizioni particolari di contratto".		Relazione tecnica del bene offerto corredata da depliant illustrativi in lingua italiana (vedi punto 3 del documento "Condizioni Particolari di Contratto"		eventuale relazione tecnica (vedi punto 6 del documento "Condizioni particolari di contratto"	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
S.L.T.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna
FARMAC SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	18/02/2020 09:51:19	19/02/2020 09:21:28

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note

S.L.T.	Approvato	nessuna
FARMAC SRL	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
FARMAC SRL	16396,00000000
S.L.T.	18700,00000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2492825
Descrizione RDO:	Fornitura di apparecchiature varie per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	LOREDANA DI SALVO
Soggetto stipulante	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	17/01/2020 14:28
Termine ultimo presentazione offerte:	04/02/2020 10:30
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	27/01/2020 00:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	04/08/2020 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	45
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali

	di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 2 Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio.

CIG	81532567B1
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni fantoccio/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	12000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	S.L.T.	Singola	00881170153	21/01/2020 14:25

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	07/02/2020 13:52:16	11/02/2020 15:11:45

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Condizioni Particolari di Contratto		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
S.L.T.		nessuna		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione di cui al punto 1 del Documento "Condizioni Particolari di Contratto"	
	Valutazione	Note
S.L.T.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	11/02/2020 15:11:58	18/02/2020 09:54:47

Concorrente	Relazione tecnica del bene offerto corredata da depliant illustrativi in lingua italiana (vedi punto 3 del documento "Condizioni Particolari di Contratto"		eventuale relazione tecnica (vedi punto 6 del documento "Condizioni particolari di contratto"		Dichiarazione di cui al punto 4) del documento "Condizioni particolari di contratto" resa dal produttore.		Certificato CE del bene offerto in corso di validità rilasciato dal produttore.	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
S.L.T.	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	18/02/2020 09:54:55	19/02/2020 09:21:35

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
S.L.T.	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
S.L.T.	11500,00000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 2	nessuna

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2492825
Descrizione RDO:	Fornitura di apparecchiature varie per l'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	LOREDANA DI SALVO
Soggetto stipulante	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	17/01/2020 14:28
Termine ultimo presentazione offerte:	04/02/2020 10:30
Termine ultimo richieste di	27/01/2020 00:00

chiarimenti:	
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	04/08/2020 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	45
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 3 Multimetro Digitale per controlli di qualità in
Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia.

CIG	81532724E6
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia./1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	24400,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	S.L.T.	Singola	00881170153	21/01/2020 14:25
2	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	Singola	02008340016	31/01/2020 12:47

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	07/02/2020 13:52:16	11/02/2020

	15:11:45
--	----------

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Condizioni Particolari di Contratto		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
S.L.T.		nessuna		nessuna		nessuna
TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	11/02/2020 15:12:03	18/02/2020 09:51:11


Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
S.L.T.	Approvato	nessuna
TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	NON Approvato	L'offerta dell'operatore economico Tecnologie Avanzate TA S.r.l. non è conforme per

		le motivazioni analiticamente trascritte nel verbale di gara redatto dal Direttore dell'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento.
--	--	---

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
S.L.T.	20383,000000000
TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 3	L'offerta dell'operatore economico Tecnologie Avanzate TA S.r.l. non è conforme per le motivazioni analiticamente trascritte nel verbale di gara redatto dal Direttore dell'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento.

A handwritten signature, possibly reading "R. J.", is written over a circular, faint stamp. The signature is written in a cursive style. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **10 MAR 2020**

Agrigento, li **10 MAR 2020**

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco