

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 702 DEL 28 APR 2022

OGGETTO: Procedura negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta, per l'affidamento della fornitura, in nove lotti, di "Attrezzature sanitarie chirurgiche/ambulatoriali per le UU.OO. di ORL dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca". Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 784 DEL 20 - 06 - 2022

Il Funzionario Istruttore e RUP

(Dr. Giuseppe Palumbo)

Il Dirigente Amministrativo

(Dr.ssa Maria Tirro)

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato

(Dr. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 47543 /22 In centri:

() Autorizzazione non ceduta dell'informazione, C.E. C.P. A101020501

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvatore

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

21 APR 2022

L'anno duemilaventidue il giorno VENTOTTO del mese di APRILE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Maria Anna Crescenzio
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, Dott. Oreste Falco

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

PREMESSO

- **CHE**, da ultimo, con note prot. n. 119173 del 03.07.2021 e prot. 120188 del 06.07.2021, allegate alla presente (All. A, B), il Responsabile f.f. UOSD ORL del PO di Sciacca sollecitava l'acquisto di strumentazione sanitaria, per le motivazioni in dette note riportate, allegando altresì specifiche tecniche e quantitativi occorrenti;
- **CHE**, nel Piano degli Investimenti per il triennio 2021/2023, approvato con Deliberazione 1171 del 30.06.2021, è stata prevista la somma di € 185.000,00 iva compresa per l'acquisto di Attrezzature Sanitarie per le UU.OO. ORL di Agrigento e Sciacca.
- **CHE** con nota prot. n. 181431 del 15.10.2021, è stata avviata apposita indagine di mercato, pubblicata sulla pagina web del sito istituzionale di questa Asp per consentire ad altre ditte di partecipare, in aggiunta a quelle interpellate, e finalizzata all'esperimento di apposita procedura di scelta del contraente, in base alla vigente normativa, per la fornitura della strumentazione di che trattasi;
- **CHE** tra le attrezzature richieste, veniva sollecitato anche l'acquisto di un microscopio ambulatoriale, richiesta avanzata altresì dal Direttore UOC ORL del PO di Agrigento;
- **CHE** tale ultima richiesta, pur non prevista nel Piano di Investimenti per il triennio 2021/2023, ha ricevuto parere favorevole all'acquisto dalla Direzione Sanitaria Aziendale e, per l'effetto, con Deliberazione n. 129 del 26.01.2022, è stata approvata l'indizione di apposita procedura negoziata per l'acquisto delle suddette attrezzature, per un importo a base d'asta di € 122.000,00 iva compresa di cui € 61.000,00 iva compresa fuori Piano degli Investimenti;
- **CHE**, per quanto sopra, la predetta attrezzatura viene stralciata dalla presente autorizzanda procedura;
- **CHE** in relazione ai lotti nn. 05, 06 e 07 si è appurato il titolo legittimante il possesso dello strumentario con cui le predette attrezzature, integralmente ammortizzate, vengono utilizzate, acquistate giusta Delibera approvazione atti di gara n. 638/2015;
- **CHE**, in relazione ai suddetti lotti nn. 05, 06 e 07, si è acquisito il parere favorevole all'aggiornamento tecnologico da parte dell'ing. Clinico di questa Asp (All. C);
- **CHE**, per similare attrezzatura (Impedenzometro Clinico ad alta frequenza) tra quelle qui autorizzande, veniva avanzata, con nota prot. 36858 del 22.02.2022 qui allegata (All. D), richiesta di acquisto anche dal Direttore UOC ORL del PO di Agrigento, per le motivazioni in detta nota riportate;
- **CHE** al fine di attivare unica procedura di acquisto per il soddisfacimento delle su citate richieste, con nota prot. 66789 del 08.04 u.s. (All. E), questo Servizio trasmetteva al summenzionato Direttore capitolato tecnico della suddetta attrezzatura, già oggetto di indagine di mercato, per la sua condivisione, “*qualora confacente alle sue esigenze*”;

- CHE con mail del 13.04 u.s. (All. F), il suddetto Direttore esprimeva conformità del suddetto capitolato alla richiesta dell’UOC di ORL del PO di Agrigento;

ATTESO

- CHE, sulla base delle offerte pervenute a seguito della predetta indagine di mercato ed al fine di soddisfare le suddette richieste, risulta possibile attivare una procedura di scelta del contraente a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), ed in nove lotti, per un importo unitario presunto, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi pervenuti a seguito della precipitata indagine di mercato, ridotti del 5%, per come in dettaglio di seguito indicato:

- Lotto 01 n. 01 “Sistema video-endoscopico ambulatoriale completo di NBI” – importo a b.a. € 110.385,77 oltre iva di legge;
- Lotto 02 n. 01 “Strumentario chirurgico” – importo a b.a. € 25.644,30 oltre iva di legge;
- Lotto 03 n. 01 “Sistema al plasma per chirurgia ORL (acquisto di manipoli con fornitura, in “Service full risk” di consolle per il loro utilizzo)” - importo a b.a. € 14.449,50 oltre iva di legge;
- Lotto 04 n. 01 “Aggiunta di Software per Prodotti di Distorsione nel sistema ABR Neuro Audio cod 10853 con sistema gestione e archiviazione e stampa dati” - importo a b.a. € 2.375,00 oltre iva di legge;
- Lotto 05 n. 01 “Aggiunta di Software per potenziali ASSR e mASSR nel sistema ABR Neuro Audio” - importo a b.a. € 2.365,50 oltre iva di legge;
- Lotto 06 n. 01 “Aggiunta di Software vocale in Italiano ai due Audiometri Piano Plus cod 11680” - importo a b.a. € 380,00 oltre iva di legge;
- Lotto 07 n. 01 “Timpanometro portatile” - importo a b.a. € 3.114,10 oltre iva di legge;
- Lotto 08 n. 02 “Impedenziometro clinico ad Alta Frequenza” - importo a b.a. € 11.742,00 oltre iva di legge;
- Lotto 09 n. 01 Sistema Potenziali Evocati (Abr)” - importo a b.a. € 15.737,94 oltre iva di legge;

per un importo complessivo presunto di € 227.156,81, iva compresa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- CHE la predetta somma risulta inserita nel precitato Piano degli Investimenti triennio 2021/2023 per € 124.000,00 iva compresa e che la rimanente somma, pari ad € 103.156,81 iva compresa si sottopone, col presente atto deliberativo, a codesta Direzione Strategica per l’approvazione;

RILEVATO

- CHE, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all’individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il trami-

te della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

- **CHE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che il bene richiesto rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, importo così elevato dall'art. 51, c. 1, lett. a) p. 2.2) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n. 108, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 - n. 4 *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per l'affidamento della fornitura, in nove lotti, delle predette attrezzature sanitarie, per un importo complessivo presunto di € 227.156,81 iva compresa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. G), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., con le allegate specifiche tecniche;
- di procedere all'esecuzione della fornitura in urgenza, per come indicato dall'art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, con espressa riserva di revocare la presente deliberazione, nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicatario diano esito infausto per lo stesso o che non pervengano i documenti che verranno richiesti unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Palumbo, dando atto che, con disposizione prot. n. 56726 del 24.03.2022 è stato costituito il gruppo di lavoro e che, con successivo provvedimento, si procederà alla li-

quidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16, nei termini e modalità previsti dal Regolamento Aziendale approvato con Delibera 1283 del 03.08.2020;

- che, con il successivo provvedimento di aggiudicazione della presente procedura verrà nominato, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

DATO ATTO

- CHE l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 229.243,75 iva compresa, come da seguente quadro economico:

Fornitura di "Attrezzature sanitarie chirurgiche/ambulatoriali per le UU.OO. di ORL dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca"	€ 186.194,11
IVA 22%	€ 40.962,70
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 1.861,94
Contrib. Anac	€ 225,00
TOTALE	€ 229.243,75

deve essere imputato:

- per € 227.381,81 sullo Stato Patrimoniale conto n. A101020501 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) del corrente Bilancio d'Esercizio, a gravare altresì sul Piano degli Investimenti triennio 2021/2021, a rettifica di quello adottato con Delibera 1171/2021;
- per € 1.861,94 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del corrente Bilancio d'Esercizio, giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), per l'affidamento della fornitura, in nove lotti, di "Attrezzature sanitarie chirurgiche/ambulatoriali per le UU.OO. di ORL dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca", per un importo complessivo base presunto, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi pervenuti a seguito di indagine di mercato, ridotti del 5%, di € 227.156,81 iva compresa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- **DARE ATTO** che la predetta somma risulta inserita nel Piano degli Investimenti triennio 2021-2023, approvato con Deliberazione n.1171/2021, per € 124.000,00 e che la rimanente somma, pari ad € 103.156,81 iva compresa viene autorizzata col presente atto deliberativo da codesta Direzione Strategica;
- **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. G), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e re-

peribili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., con le allegate specifiche tecniche;

- **AUTORIZZARE** l'esecuzione in urgenza della fornitura, giusto art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, con espressa riserva di procedere all'eventuale revoca della presente deliberazione, nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicatario diano esito infausto per lo stesso o che non pervengano i documenti che verranno richiesti unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- **PRENDERE ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dr. Giuseppe Palumbo, dando atto che, con disposizione prot. n. 56726 del 24.03.2022 è stato costituito il gruppo di lavoro e che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16, nei termini e modalità previsti dal Regolamento Aziendale approvato con Delibera 1283 del 03.08.2020;
- **CHE**, con il successivo provvedimento di aggiudicazione della presente procedura verrà nominato, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- **DARE ATTO** che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, pari presuntivamente ad € 229.243,75 iva compresa, come da seguente quadro economico:

Fornitura di "Attrezzature sanitarie chirurgiche/ambulatoriali per le UU.OO. di ORL dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca"	€ 186.194,11
IVA 22%	€ 40.962,70
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 1.861,94
Contrib. Anac	€ 225,00
TOTALE	€ 229.243,75

deve essere imputato:

- per € 227.381,81 sullo Stato Patrimoniale conto n. A101020501 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) del corrente Bilancio d'Esercizio, a gravare altresì sul Piano degli Investimenti triennio 2021/2021, a rettifica di quello adottato con Delibera 1171/2021;
- per € 1.861,94 sul conto n. C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016) e sul conto n. P202050601 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016) del corrente Bilancio d'Esercizio, giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020;

con riserva di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e di relativo avviso sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Provveditorato;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante il lasso di tempo intercorso dalla richiesta.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere _____
Data 21/04/2022

Parere _____
Data 22/04/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott. Oreste Falco, Direttore UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr. Oreste Falco, responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia


Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Presente

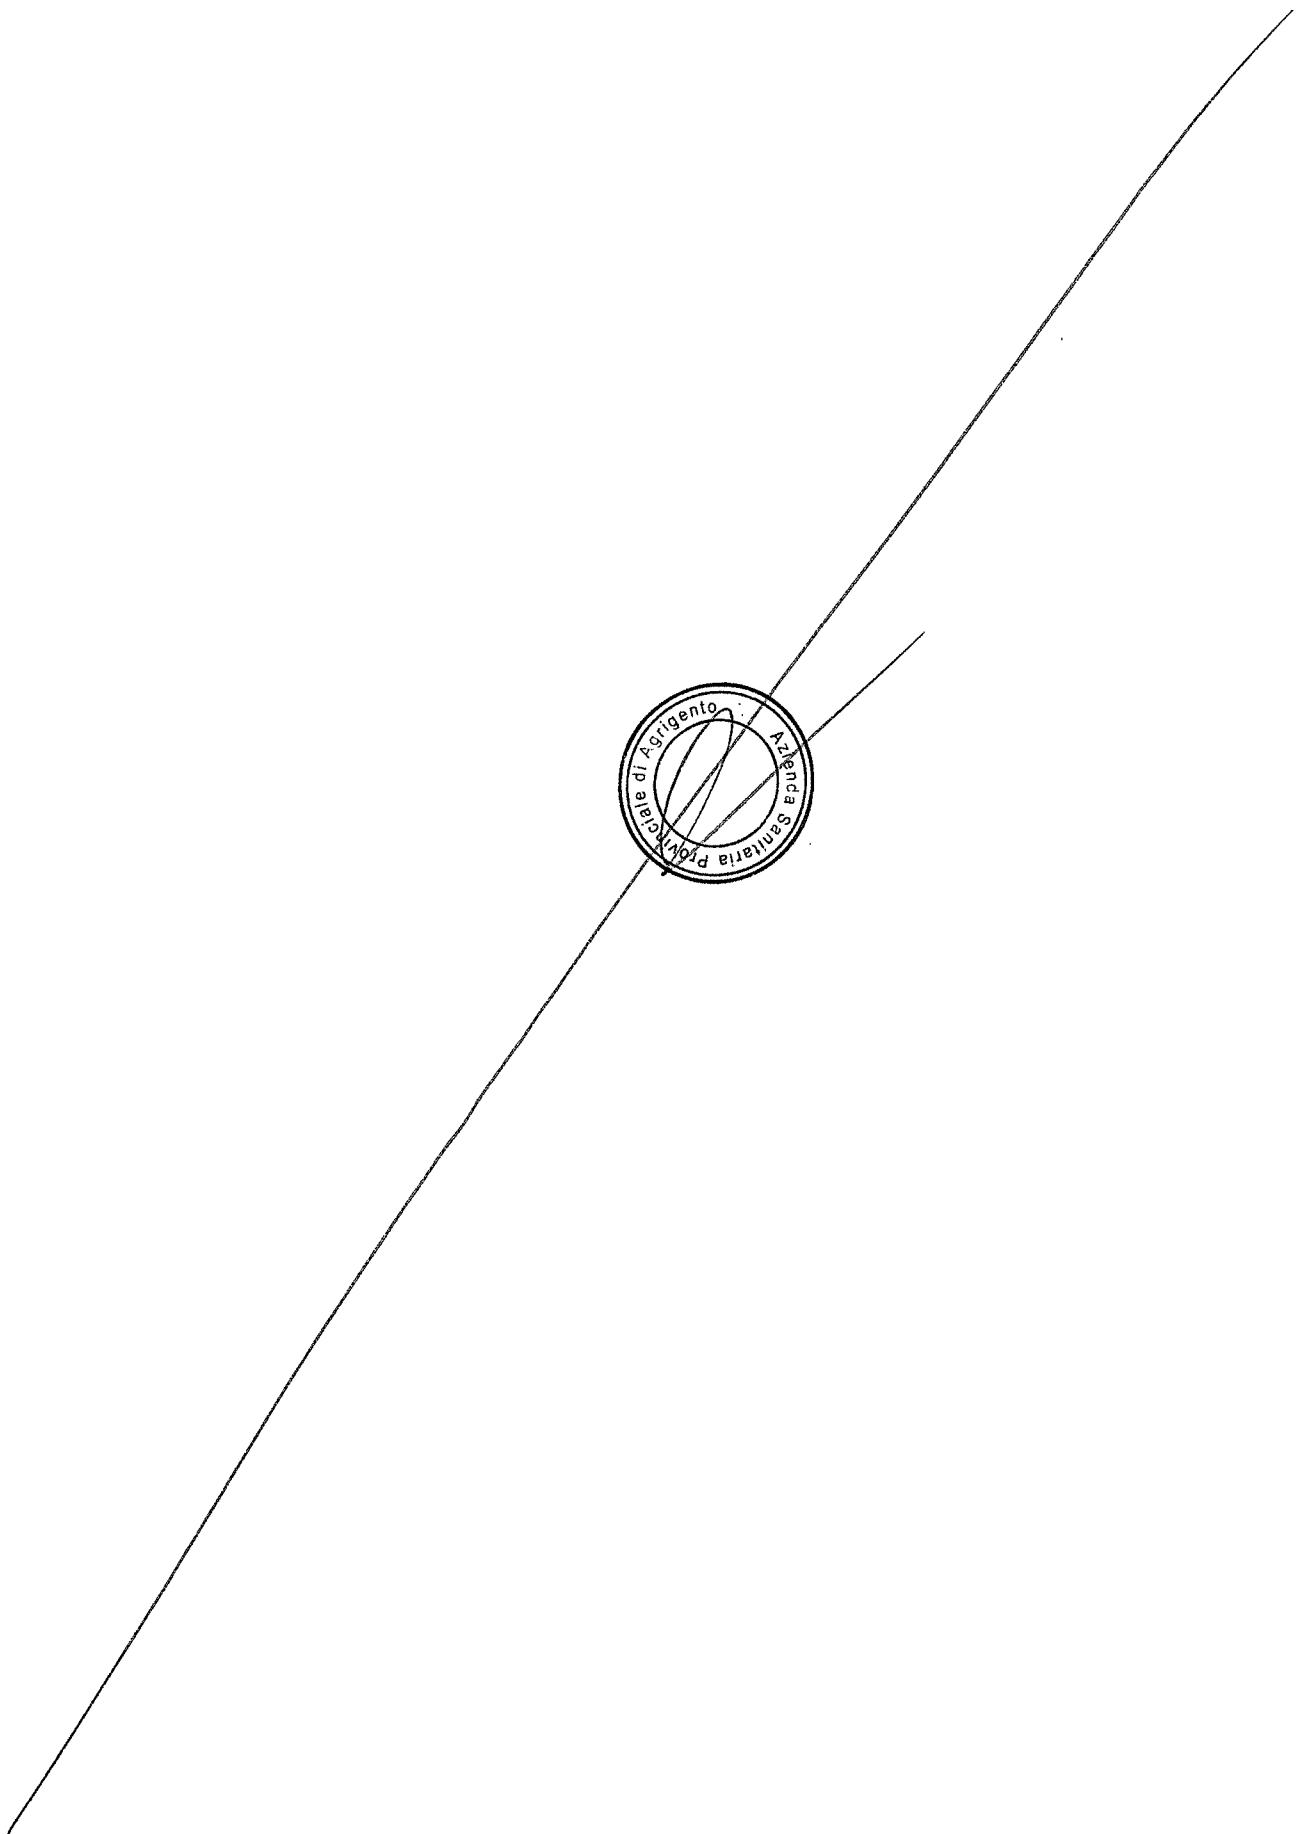

05/07/2021

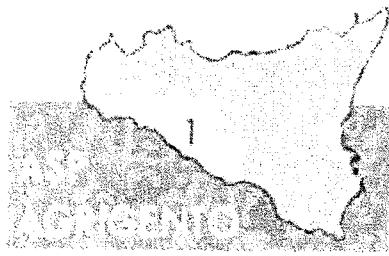

Servizio Sanitario Nazionale



REGIONE SICILIANA

ALLA

U.O.S.D. OTORINOLARINGOLOGIA

Resp. F.F.: Dott. Mario Chilura

OSPEDALI RIUNITI
SCIACCA E RIBERAP.O. "GIOVANNI PAOLO II"
SCIACCAProt. N. 0118173
Del 03 luglio 2021

All'UOC Provveditorato
 Si sollecita la fornitura alle U.O.S.D. O.R.L.
 del P.O. Agreco delle attrezature
 sanitarie richieste,
 rappresentante ormai ~~cooptato~~ ^{Spedite} dell'UOC PROVVEDITORATO
 c.a. Dott. Oreste Falco
 c.a. Dott. Giuseppe Palumbo

05/07/2021

Il Direttore Sanitario Aziendale
 (Dott. Gaetano Maricuso) e p.c. DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
 CAPO DIPARTIMENTO CHIRURGICO AG/2

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriore Sollecito acquisto strumentazioni sanitarie indispensabili. Rischio sospensione attività UOSD.

Con riferimento alla nota 69441 del 16 aprile u.s. si ribadisce l'assoluta necessità di dotare Codesta UOSD di alcune strumentazioni ed attrezzature sanitarie, la cui mancanza potrebbe determinare l'interruzione delle prestazioni (anche basilari ed ambulatoriali) della stessa.

Nella nota sopracitata si specificavano già le criticità presenti. Ad oggi non è stata avviata alcuna procedura per l'acquisto delle suddette strumentazioni.

Segue nota indirizzata all'UOC Provveditorato con l'elenco delle stesse in ordine di urgenza di acquisto.

Certo della soluzione della problematica e fiducioso in un celere disbrigo delle procedure necessarie, pongo Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE F.F. dell'U.O.S.D. ORL DEL P.O. DI SCIACCA

Dott. Mario Chilura
 A.S.P. 1 AG DIST. 1 SPAGNA
 U.O. ORL
 DR. M. CHIURA
 Ccd. ENR/AM 0507/6014W
 Iscr. O. M. 2867 AG

U.O.S.D. ORL P.O. "Giovanni Paolo II" - Sciacca

4° Piano - Scala "C" - Segret. Tel. 0925 962 341

U.O.S.D. ORL SCIACCA

NUOVO PIANO ACQUISTI Attrezzature e Arredi – Biennio 2021 /2022

Delibera n° 1171 del 30 GIUGNO 2021 (fondi assegnati all'UOSD ORL di Sciacca: 185.000 euro)

Protocollo 120188 del 06 luglio 2021

TIPOLOGIA del BENE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO CLINICO	CARATTERISTICHE TECNICHE	PRIORITA' D'ACQUISTO	COSTO PRESUNTO (escluso IVA)
Attrezzatura Sanitaria Ambulatoriale	COLONNA ENDOSCOPICA DIAGNOSTICA con fonte luce NBI corredato di rinofaringoscopi flessibili adulti e pediatrici	Diagnostica di base ORL strumentario molto utilizzato con fonte di luce NBI (per la diagnosi precoce di lesioni tumorali)	ALLEGATO 1	URGENTISSIMO	€ 65.000
Attrezzatura Sanitaria Chirurgica	FERRI CHIRURGICI	Integrazione e sostituzione di ferri mancanti e/o guasti	ALLEGATO 2	URGENTISSIMO	€ 30.000
Attrezzatura Sanitaria Chirurgica	SISTEMA AL PLASMA PER CHIRURGIA ORL	Incrementare le tipologie d'interventi. Miglioramento della qualità di altri	ALLEGATO 3	URGENTE	€ 10.000
Attrezzatura Sanitaria Audioologica	Audiometro Clinico comprensivo di Test MATRIX adulti e bambini	Valutazione Pre e Post protesica dell'adulto e del bambino	ALLEGATO 4	URGENTE	€ 13.000
Attrezzatura Sanitaria Audioologica	Aggiunta di Software per Prodotti di Distorsione nel sistema ABR Neuro Audio cod 1085-3 con sistema gestione e archiviazione e stampa dati	Implementazione diagnostica II° Step screening audiologico e Audiologia Infantile	ALLEGATO 5	URGENTE	€ 3.500
Attrezzatura Sanitaria Audioologica	Aggiunta di Software per potenziali ASR e mASSR nel sistema ABR Neuro Audio cod 10353	Implementazione diagnostica in Audiologia Infantile	ALLEGATO 6	URGENTE	
Attrezzatura Sanitaria Ambulatoriale	MICROSCOPIO AMBULATORIALE	Miglioramento prestazioni ambulatoriali	ALLEGATO 7	DIFERIBILE	€ 20.000

Attrezzatura Sanitaria Audiologica	Aggiunta di software Vocale ai due Audiometri Piano Plus cod 11680	Implementazione attività clinica per adulti e bambini	ALLEGATO 8	DIFERIBILE	€ 1.200
Attrezzatura Sanitaria Audiologica	Timpanometro portatile	Implementazione diagnostica in Audiologia Infantile	ALLEGATO 9	DIFERIBILE	€ 3.500
Attrezzatura Sanitaria Audiologica	Impedenziometro clinico ad Alta Frequenza	Implementazione attività clinica per adulti	ALLEGATO 10	DIFERIBILE	€ 6.500
Attrezzatura Sanitaria Audiologica	Sistema ABR interfacciato a PC per esecuzione VEMPS e Potenziali Evocati Uditivi a breve, media e lunga latenza	Implementazione attività clinica neuroaudiologica per adulti	ALLEGATO 11	DIFERIBILE	€ 11.000

Il Responsabile f.f. UOSD ORL

Dott. Mario Chittura
 P.zza S. Ag. 1 AG - DIRETTO CSE AG2
 0965/300450 - 0965/230000
 CARICO CHITURA
 Ospedale S. Agata - 95120 Catania
 O. M. 23667 AG



Il Direttore Sanitario di Presidio

Dott. Gaetano Migliazzo

Il Commissario Starordinario

Dott. Mario Zappia

R: Indicenda procedura di acquisto Attrezzature ORL - Richiesta parere su opportunità aggiornamento attrezzi.

Eduardo Tarallo <eduardo.tarallo@aspag.it>

mer 23/03/2022 08:58

per c.

A: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Buongiorno

A mio parere le attrezzature ABR Neuro Audio e Audiometro Piano Plus sono in buono stato e non è necessario procedere alla sostituzione. Va bene invece aggiungere i software dei lotti 5-6-8.

Saluti

Ing. Eduardo Tarallo

Coll. Tecnico Professionale Ingegnere Clinico
U.O.C. Servizio Tecnico
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
(0922407311 - eduardo.tarallo@aspag.it)

Da: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Inviato: martedì 22 marzo 2022 18:02

A: Eduardo Tarallo <eduardo.tarallo@aspag.it>


Oggetto: Indicenda procedura di acquisto Attrezzature ORL - Richiesta parere su opportunità aggiornamento attrezzi.

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di procedere all'indizione di non più procrastinabile procedura di acquisto, si invita ad esprimere parere circa l'opportunità di procedere ad aggiornamento tecnologico dei dispositivi ABR Neuro Audio e Audiometri Piano Plus, entrambi acquistati nel 2015 e totalmente ammortizzati, rispetto alle allegate offerte prodotte in sede di indagine di mercato.

Si allegano: Verbali di collaudo delle su citate attrezzature, ove evincere tipologia dei dispositivi acquistati; Capitolati tecnici lotti 05,06,08; Offerte da ind. di mercato relative ai suddetti lotti.

In attesa di urgente riscontro, distinti saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento

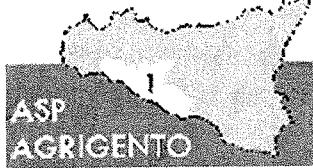

Alb.

Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"

C.da Consolida – Agrigento -

U.O.C. di Otorinolaringoiatria

Direttore: Dr. Ettore Bennici

V° P 36858

def 22.09.2022

→ Al Direttore del Provveditorato ASP AG
e p.c. Al Direttore Amministrativo Aziendale
e p.c. Al Direttore Sanitario Aziendale
Sedi

Bie. 8th Oct. 22

Oggetto: Richiesta acquisto impedenzometro clinico.

Con la presente si richiede l'acquisto di **impedenzometro clinico con alta frequenza con printer**:

Nello specifico, si riportano qui sotto le caratteristiche tecniche dettagliate dello strumento:

Strumento di ultima generazione

Funzionamento STAND ALONE autonomo senza necessità di Pc esterno ma dotato di software di archiviazione dati che permetta la visualizzazione dei test durante l'esecuzione degli esami in tempo reale sul display del computer;

Schermo incorporato a colori preferibilmente con controllo touch screen Dimensioni 7", 800 x 480 pixel

Stampante Termica integrata rapida e di ampie dimensioni (superiore a 110mm)

Dotato di archetto e capsula TDH39 o DD 45 e optionalmente, di trasduttore ad inserto

TONO SONDA

Frequenze: 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz

Intensità: 85 dB SPL (@ 226 Hz)

La sonda di misura dovrà essere realizzata in metallo , piccola e leggera, perche' consentire l'utilizzo facilitato in pazienti pediatrici in età pre-scolare;

Lo strumento deve avere una piccola unità di Controllo vicina alla sonda , che permette di selezionare il lato dell'orecchio in analisi , avviare o fermare l'esame e indicatore lo stato dell'esame (PRONTO-IN CORSO-SONDA CHIUSA-SONDA APERTA).

18-12-1968
Mr. S. V. Venkateswaran
Secretary
Dr. Shroff's
Dept. English
Sect. English

SISTEMA PRESSORIO

Pompa di tipo rotativo con flusso infinito

Dovrà essere di tipo rotativo a flusso continuo estremamente veloce, che consenta di effettuare la timpanometria ad una velocità di 600 daPa / sec, senza alcun compromesso sulla precisione dei risultati.

Il sistema pneumatico utilizzato dallo strumento dovrà sfruttare una tecnologia innovativa, basata su una pompa a flusso continuo d'aria che non richieda manutenzioni periodiche, che renda agevole l'esecuzione degli esami anche quando la tenuta non è ottimale.

TEST DISPONIBILI

Timpanometria (automatica e manuale)

Test dei riflessi acustici (automatico e manuale)

Decay del riflesso acustico e NON acustico

Test latenza del riflesso acustico

con frequenze IPSI 500 – 1000 – 2000- 3000 – 4000 – 6000 e CONTRA 250 - 500 – 1000 – 2000- 3000 – 4000 – 6000 - 8000

Test funzionalità tubarica (ETF) per timpani intatti e perforati

TIMPANOMETRIA

Modalità di visualizzazione: assoluta oppure compensata

Componenti misurate: Ammettenza [Y], Conduttanza [G], Suscettanza [B] anche con Tono 226 Hz

Scansione singola oppure multipla (fino a 3)

Direzione di scansione selezionabile

Intervallo di pressione configurabile dall'operatore

Intervallo massimo: da -600 a +400 daPa

Limits di sicurezza: -800 daPa e +600 daPa

Velocità di variazione disponibili: 15, 50, 100, 200, 300, 400, **600/sec**

daPa/sec and AUTO (200-600 daPa/sec)

Regolazione manuale della pressione

Avvio automatico del test

RIFLESSI ACUSTICI

Stimolazione ipsilaterale e controlaterale

Stimolazione Non-acustica

ON-Time: selezionabile da 0.5s a 2.5s

OFF-Time: selezionabile da 0.5s a 2.5s

Quattro modalità di esecuzione:

Ricerca automatica della soglia

Intensità fissa

Intensità crescente

Manuale

DECAY DEL RIFLESSO

Stimolazione ipsilaterale e controlaterale

Stimolazione Non-acustica

Durata dell'esame: 10 sec oppure 20 sec (configurabile)



Le potenzialità della diagnosi precoce consentono di aumentare le opportunità di mantenere la salute in condizioni ottimali o di migliorare la prognosi nel caso in cui sia svelata un deficit o una malattia.


Si fa presente che l'U.O.C. di O.R.L. da me diretta è sede anche di screening uditivo neonatale di II livello (Ooggettivo Strategico Regionale ed Aziendale).

Si allega copia del Verbale di proposta dismissione dell'impedenzometro ubicato presso l'U.O.C. di O.R.L. P.O.AG data 07/01/2016 e mai ricomprato con grave nocumento per i pazienti


Sperando in un positivo accoglimento della richiesta, porgo doverosi ossequi

Agrigento, 22/02/2022

Il Direttore U.O.C. di O.R.L.
Dott. Ettore Bennici



Prot. F.U. 01/16

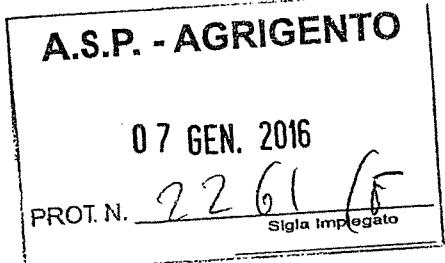

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. S. Lo Presti

p.c. Al DEC
Geom. Scozzari

p.c. Al Responsabile Amministrativo Distretto AG1
Dott. S. Iacolino

p.c. Al Direttore Sanitario Presidio di Agrigento
Dott. Seminerio

p.c. Al Responsabile dell'U.O. Otorinolaringoiatria P.O. San Giovanni di Dio
Dr. E. Bennici

Agrigento, 04/01/16

Oggetto: Proposta di dismissione per Impedemziometro Amplaid mod. A770 s/n SEA7709845001 ubicato presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento.

Facendo seguito alla richiesta verbale di intervento tecnico da parte degli utilizzatori, pervenuta al Ns. Servizio il 29/10/2015, che richiedeva la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, il Ns. personale tecnico ha riscontrato la mancanza delle parti di ricambio necessari al corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Pertanto preso atto che:

1. è impossibile procedere al ripristino del corretto funzionamento in quanto l'impedenziometro è da diversi anni fuori produzione e quindi non più riparabile per la conseguente indisponibilità delle necessarie parti di ricambio (all.1);

con la presente siamo a dichiararne l'irreparabilità e a proporne la dismissione (all.2).

Vi chiediamo di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso e successivo smaltimento dell'apparecchiatura in oggetto che è ubicata presso il reparto.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento nel merito e porgiamo ns. distinti saluti.

Il Responsabile di Commissa
(Ing. Angelo Russi)

00144 Roma - via Laurentina n. 456/458 - P.IVA e iscr. R.I. 06915071002
Telefoni: 39.06544081 - Fax 39.0654408214 - R.E.A. n° 998707 - Cap.Soc. € 6.000.000,00 i.v.



Spett.le Tecnologie Sanitarie SPA
c/o Ospedale San Giovanni di Dio
Contrada Consolida
92100 AGRIGENTO
ALLA C.A. del SIC

Vs. rif. AG2150125 del 03/11/2015

Ns. rif. dichiarazione non riparabilità

Montegrotto Terme (PD), li 04/11/2015

Oggetto: dichiarazione non riparabilità apparecchiature elettromedicali.

Con la presente si dichiara che le seguente apparecchiatura audiologica:

- IMPEDENZOMETRO AMPLAID A770 S.N. SEA7709845001


non risulta più in produzione ed è tecnicamente obsoleta in quanto il regime temporale di assistibilità tecnica correttiva è terminato perché non sono più reperibili parti di ricambio sul mercato.

NOSTRO CONTATTO IN AREA: sig. MASSIMILIANO CORRAO

Cordiali saluti,

Ing. Sterchele Denis

Service Manager



GN HEARING S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA NINO BIXIO, 1/B
35036 MONTEGROTTO TERMÉ (PD)
Tel. 0039 049/8911.511 - Fax. 0039 049/8911.450
Posta elettronica: info@mercurydiagnostics.it

Posta certificata: gn@pec.it
Societa' unipersonale
REA 181094, Reg.Imprese di Padova
C.F./P.IVA. IT 01781130289
Capitale versato Euro. 181.190,00

UFFICIO COMMERCIALE:
VIALE COLLEONI, 25 (Palazzo Pegaso Ingr. 3)
20041 AGRATE BRIANZA (MB)
Tel. 0039 039/650211 - Fax. 0039 039/653522



**Servizio di Ingegneria Clinica
TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A.
Apparecchiature Elettromedicali**

PROPOSTA DI DISMISSIONE

Identificazione Apparecchiatura

Nr. Inventario	
Tipologia	IMPEDENZIOMETRO
Cod. Costruttore	
Modello	A770
S/N	SEA7709845001
Codice ASL	
Cod. Presidio	
Reparto	U.O. OTORINOLARINGOIATRIA
Locale	
CDC	U.O. OTORINOLARINGOIATRIA


Data proposta di dismissione: 04/01/2016

Note: A seguito richiesta del reparto

Causali della Dismissione:
Irreparabilità
Ricambio non fornibile

Data: 04/01/2016

Firma Responsabile Commessa

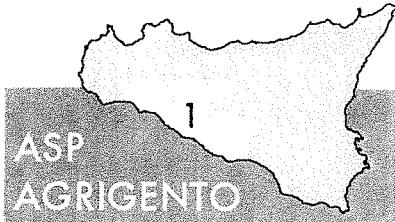

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Telefono : 0922 407279
FAX 0922 407119
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 16789 del 08/04/2022

all'E

AI Direttore UOC Otorinolaringoiatria PO
di Agrigento

Oggetto: Indicenda procedura di acquisto strumentario ORL – Rif. Vs. nota prot. 36858/2022 -.
Richiesta di acquisto "Impedenzometro Clinico"

In relazione a quanto in oggetto, si rappresenta che è in avanzata fase di predisposizione Delibera autorizzativa all'acquisto di attrezzature varie per la O.R.L. del P.O. di Sciacca, tra cui il dispositivo di cui alla nota in oggetto.

Premesso quanto sopra, si trasmette capitolato tecnico a suo tempo redatto dal Direttore UO ORL del PO di Sciacca ed utilizzato per già effettuata indagine di mercato, nonché schede tecniche di dispositivi proposti a seguito di tale indagine.

Voglia, con cortese urgenza, condividerne il contenuto, qualora confacente alle Sue esigenze, ed attestare la conformità delle predette schede tecniche, all'ovvio fine di inserire la sua richiesta nella indicenda procedura negoziata:

In attesa cortese ma celere riscontro si porgono distinti saluti

Il Collaboratore Amministrativo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Greste Falco

Indicenda proc. di acquisto attrezzature ORL - Nota prot. 66789/2022

Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

ven 08/04/2022 14:18

A: Ettore Bennici <ettore.bennici@aspag.it>

In allegato si trasmette nota in oggetto indicata.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento

Lotto n. 10

A.U.F

Impedenzometro clinico ad Alta Frequenza

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA:

- Tono sonda a 226Hz, 678Hz, 800 Hz, 1000Hz
- Sonda adulti e pediatrica
- Deve eseguire
 - Timpanometria automatica e manuale
 - Test di funzionalità tubarica per timpani intatti o perforati
 - Riflessi acustici automatica e manuale in IPSI (500,1000,2000,4000,6000) e CONTRA (250,500,1000,2000,4000,6000,8000) con test di latenza del riflesso
 - Decay del riflesso acustico e non acustico
 - Quick Test
 - Modalità screening
- Completo di stampante

Conforme alle richieste dell'U.O.C. di A.R.L.
P.D. A.R.L. le richieste sono in corso (presunte) -

AZ. San Giovanni - Agrigento
Preparatore: Giovanni Di Dio
Dottore U.O.C. ORL
Dottore Renzulli
C.F. RENZULLI 0963-3000065910

caratteristiche tecniche impedenzometria

otorinoag@libero.it <otorinoag@libero.it>


mer 13/04/2022 13:32

A: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

 1 allegati (80 KB)

impedenza.pdf;

Buona giornata

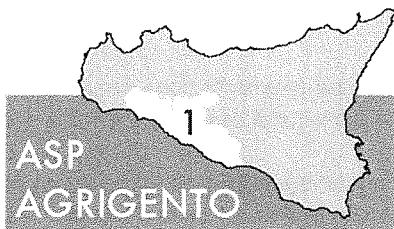

pol. a

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta, per l'affidamento della fornitura, in nove lotti, di "Attrezzature sanitarie chirurgiche/ambulatoriali per le UU.OO. di ORL dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca".

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanita".

Questa Azienda, giusta Delibera a contrarre n. _____ del ____/____/2022, esecutiva, indice, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) per come derogato dall'art. 51, c. 1, lett. a) p. 2.2) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in L. 29 luglio 2021, n. 108, e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, Procedura Negoziate tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta sulla piattaforma ME.PA., per la fornitura, in 09 lotti, della seguente attrezzatura sanitaria, da destinare alle UU.OO. di ORL dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, per un importo unitario presunto, determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi pervenuti a seguito di indagine di mercato, ridotti del 5%, per come in dettaglio di seguito indicato e le cui specifiche tecniche vengono indicate alla presente:

- Lotto 01 – n. 01 "Sistema video-endoscopico ambulatoriale completo di NBI" (Cig: _____) – importo a b.a. € 110.385,77 oltre iva di legge;
- Lotto 02 – "Strumentario chirurgico" (Cig: _____) – importo a b.a. € 25.644,30 oltre iva di legge;
- Lotto 03 – n. 01 "Sistema al plasma per chirurgia ORL (acquisto di manipoli con fornitura, in "Service full risk" di consolle per il loro utilizzo)" (Cig: _____) - importo a b.a. € 14.449,50 oltre iva di legge;
- Lotto 04 – n. 01 "Aggiunta di Software per Prodotti di Distorsione nel sistema ABR Neuro Audio cod 10853 con sistema gestione e archiviazione e stampa dati" (Cig: _____) - importo a b.a. € 2.375,00 oltre iva di legge;
- Lotto 05 – n. 01 "Aggiunta di Software per potenziali ASSR e mASSR nel sistema ABR Neuro Audio" (Cig: _____) - importo a b.a. € 2.365,50 oltre iva di legge;
- Lotto 06 – n. 01 "Aggiunta di Software vocale in Italiano ai due Audiometri Piano Plus cod 11680" (Cig: _____) - importo a b.a. € 380,00 oltre iva di legge;
- Lotto 07 – n. 01 "Timpanometro portatile" (Cig: _____) - importo a b.a. € 3.114,10 oltre iva di legge;
- Lotto 08 – n. 02 "Impedenzometro clinico ad Alta Frequenza" (Cig: _____) - importo a b.a. € 11.742,00 oltre iva di legge;
- Lotto 09 – "Sistema Potenziali Evocati (Abr)" (Cig: _____) - importo a b.a. € 15.737,94 oltre iva di legge;

per un importo complessivo presunto di € 186.194,11, oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Oggetto della presente procedura è l'acquisto delle attrezzature sanitarie sopra descritte, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegnna installazione e collaudo presso le strutture sanitarie richiedenti; saranno a carico del fornitore tutte le opere di installazione e di eventuale cablaggio, nessuna esclusa, e dovrà essere fornito tutto quanto necessario per l'installazione.
- In relazione alle attrezzature "in service": fornitura, in service Full Risk, di n. 01 "Sistema al Plasma", le cui caratteristiche sono indicate nell'allegata scheda tecnica, da installare presso la struttura sanitaria richiedente; durante il periodo del service (un anno da collaudo positivo), manutenzione ordinaria preventiva (come da indicazioni del produttore) e manutenzione straordinaria Full Risk su chiamata in numero illimitato; tempo di intervento tecnico: 08 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento

- dell'apparecchio. In mancanza, la Società fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto), al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore
- In relazione alle attrezzature oggetto di acquisto: garanzia full risk non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo, senza oneri a carico dell'azienda; il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:
 - o Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature.
 - o Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
 - o Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
 - o Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata. Apparecchiatura sostitutiva nel caso in caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.
 - o Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale durante il periodo di garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore nonché la sostituzione di materiale di usura;
 - Formazione: In fase di installazione, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente: modalità di utilizzo del sistema; modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema; attività di manutenzione a carico dell'operatore. Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle "Condizioni di Fornitura" redatte dall'Ing. Clinico di questa Asp, in calce al presente documento.

In relazione al Lotto n. 03, la fornitura è da intendersi in regime di somministrazione e, quindi, le quantità sopra indicate sono riferite al fabbisogno stimato per circa 12 mesi e sono da ritenersi indicative e non impegnative per questa ASP; si conviene, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, l'entità della somministrazione non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno di questa Azienda nel periodo di vigenza contrattuale; l'ASP si riserva, pertanto, di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale sanitario di che trattasi. Le quantità, pertanto, potranno subire variazioni in diminuzione, senza alcun limite, in relazione al fabbisogno reale ed effettivo delle Strutture interessate, correlato all'andamento delle relative patologie, non esattamente prevedibile o predeterminabile, per cui l'Appaltatore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta;

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. In considerazione della straordinaria situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19, la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni normative emanate in materia virus Covid-19, e a fare riferimento ai documenti ASP "Valutazione Rischio Biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus")" scaricabili dal sito www.aspag.it.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), in possesso delle specifiche tecniche richieste, devono essere conformi alle normative di sicurezza CEE e

dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato. Inoltre, qualora i beni da fornire prevedessero una scadenza, questa non deve essere inferiore a diciotto mesi, decorrenti dalla data di consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche indicate, comprendente anche la necessaria compatibilità tecnica con l'apparecchiatura in dotazione alla suddetta UOSD ORL.

Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, che non presenta carattere transfrontaliero, atteso l'importo della fornitura medesima, in conformità all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, si procederà al calcolo per l'offerta anormalmente bassa di cui al sopra citato art. 97, comma 2, 2 bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis. Comunque l'esclusione automatica opera se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge 120/2020.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di cui alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara per impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, la ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente sottoscritta con firma digitale. Si precisa che, non essendo richiesti particolari requisiti di partecipazione, gli Operatori Economici interessati possono tralasciare la compilazione della Parte IV, punti B), C) e D) del citato DGUE;
2. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec, indicando il relativo indirizzo;
3. Dichiarazione integrativa, resa ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione delle generalità complete dei soggetti, in carica e/o cessati dalla carica, dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice
4. Dichiarazione integrativa, resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
5. Copia della presente, comprensiva dei Capitolati Tecnici per i quali si propone offerta, debitamente firmata digitalmente per accettazione;
6. Schema di Offerta tecnica, per i lotti di interesse, obbligatoriamente priva di prezzi offerti, completa di tutti i dati ivi richiesti, ove esistenti, per consentire l'immediata individuazione del prodotto offerto, sottoscritta digitalmente;
7. Manuale d'uso completo in lingua italiana delle apparecchiature offerte;
8. Breve relazione tecnica del dispositivo offerto corredata di deplianti illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio di-

positivi medici del bene offerto; qualora nel depliant fossero presenti più prodotti, l'Operatore Economico dovrà dare evidenza dell'articolo offerto, così da rendere inequivocabile l'articolo offerto.

9. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
10. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
11. Dettaglio Prezzi Offerti, completa di tutti i dati ivi richiesti; dovrà contenere tutti i prezzi unitari di ogni singola voce eventualmente compresa in ogni singola lotto, fermo restando che la sommatoria dei prezzi unitari dovrà coincidere con il prezzo complessivo offerto, nonché il confezionamento proposto.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di validità del contratto (12 mesi per le attrezzature in service, 24 mesi per le attrezzature oggetto di acquisto) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dal soggetto appositamente incaricato dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo di fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base di gara e sopra indicato; nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato d'oneri; nel prezzo di fornitura è compresa la consegna ed installazione per come indicato nell'ordine di fornitura, nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessarie per tutta la durata della garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra l'eventuale aggiornamento software;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite NSO; il materiale di consumo sarà ordinato dal Servizio di Farmacia ospedaliera; in caso di particolare urgenza la ditta dovrà consegnare il materiale di consumo entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) Manutenzione ed assistenza tecnica del tipo full risk; la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, per tutta la durata del contratto. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi full risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. e il timbro dell'Azienda; il

rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi in caso di guasti o malfunzionamenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 08 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio; in mancanza la ditta fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto) al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nell'attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.

- 5) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accettare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accettare che l'apparecchiatura e le attrezature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.
- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura dovrà essere emessa in relazione all'ordinativo di fornitura; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni

- per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviiati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
 - 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407279 – fax 0922/407119).

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco

Condizioni di fornitura

INSTALLAZIONE E FORMAZIONE

Saranno a carico del fornitore tutte le opere di installazione e di cablaggio, nessuna esclusa, e dovrà essere fornito tutto quanto necessario per l'installazione.

In fase di installazione, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- modalità di utilizzo del sistema
- modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema
- attività di manutenzione a carico dell'operatore

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

DOCUMENTAZIONE

- Manuale d'uso completo in lingua italiana delle apparecchiature offerte
- Relazione tecnica punto per punto completa per ogni apparecchiatura offerta
- Depliant illustrativi
- Certificato di corrispondenza alle direttive CE
- Copia dell'offerta economica senza prezzi con il dettaglio dei prodotti offerti

GARANZIA

Le apparecchiature s'intendono coperte da garanzia full risk per la durata di 24 mesi dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell'Azienda.

Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

- Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature.
- Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
- Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
- Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata
- Apparecchiatura sostitutiva nel caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.
- Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale

Ing. Eduardo Tarallo

Lotto n. 01

Oggetto: richiesta di acquisto di sistema video-endoscopico ambulatoriale completo di NBI

Tale sistema deve essere composto come di seguito:

- *N. 1 processore FullHD con fonte di luce LED dotato di sistema di enfatizzazione dei vasi sanguigni superficiali con filtri ottico e digitale NBI (Narrow Band Imaging);*
- *N. 1 testa di telecamera completa di adattatore HD autoclavabile completa di filtro moirè;*
- *N. 1 Monitor di almeno 26' HD-LCD ;*
- *N. 1 Carrello elettrificato, 3 ripiani, con braccio per monitor e cassetto;*
- *N. 1 fibroscopio adulti, diametro distale 3,4 mm, lunghezza di lavoro 300 mm, angolazione 130°, completo di accessori;*
- *N. 1 fibroscopio pediatrico, diametro distale 1,8 mm, lunghezza di lavoro 300 mm, angolazione 130°, completo di accessori;*
- *N. 1 fibroscopio con canale operativo, diametro distale 4,8 mm, canale da 2,2 mm, lunghezza di lavoro 365 mm, angolazione 130°, completo di accessori completo di due pinze da presa semiflessibili;*
- *N°1 Videoendoscopio diagnostico con chip in punta, formato video FullHD (1980x1080), compatibile con sistema di enfatizzazione dei vasi tramite filtro ottico e digitale. Diametro massimo 3.9 mm., lunghezza operativa 300mm, angolo di visione 90°, inclinazione punta 130°su/giù;*
- *N.3 cavi luce per i fibroscopi;*
- *N.1 Sistema di registrazione, con Hard Disk interno da 500 Giga, deve poter registrare su supporti USB, con database integrato per gestione anagrafica pazienti e operatori.*

Lotto n. 02

Strumentario chirurgico

- N.1 pz. Apribocca sec Davis-Meyer mod. standard;
- N.1 pz. Apribocca sec Seemann-SEIFFERT c.13;
- N.2 pz. Serranodi per tonsille tipo Brunings cm.28;
- N.1 pz. Pinza per tonsilla Blohmke cm.21;
- N.2 pz. Pinza per tonsilla Schnidt cm.19;
- N.2 pz. Pinza di Birkett cm. 20 curva;
- N.1 pz. Cannula di aspirazione secondo Yankauer cm.27;
- N.2 pz. Forbici per tonsille a doppia curva cm.17;
- N.2 pz. Pinza per uncinectomia a morso retrogrado, ruotante a 360 gradi, morso da 1,5 mm, lunghezza operativa 10 cm;
- N.2 pz. Aspiratore di Frazier 10 ch;
- N.2 pz. Aspiratore di Frazier 12 ch;
- N.2 pz. Speculo nasale di Killian 40 mm;
- N.2 pz. Forbici di Schere cm.11,5 , punte rette, smusse e sottili;
- N.2 pz. Forbici di Metzenbaum cm.14 , punte curve, smusse e sottili;
- N.3 pz. Forbici di Fomon a tagli orizzontale;
- N.2 pz. Forbici di Heymann per turbinotomia;
- N.2 pz. Abbassalingua angolato di Hartmann cm.15;
- N.2 pz. Retrattore a uncini;
- N.2 pz. Retrattore di Volkmann4 denti;
- N.4 pz. Divaricatori di Farabeuf;
- N.1 pz. Speculo nasale di Killian valva da 55 mm;
- N.1 pz. Speculo nasale di Killian valva da 75 mm;
- N.1 pz. Speculo nasale di Killian valva da 90 mm;
- N.10 pz. Speculo auricolare secondo Hartmann diametro esterno 3 mm;
- N.10 pz. Speculo auricolare secondo Hartmann diametro esterno 4 mm;
- N.10 pz. Speculo auricolare secondo Hartmann diametro esterno 5 mm;
- N.5 pz. Cannula di aspirazione secondo Baron mis. 1 mm;
- N.5 pz. Cannula di aspirazione secondo Baron mis. 1,7 mm;
- N.5 pz. Cannula di aspirazione secondo Baron mis. 2,3 mm;
- N.2 pz. Forbici di Bellucci auricolari, lame curve sottili da 8 mm., lunghezza 8 cm;
- N.5 pz. Pinze di Hartmann lunghezza cm 8 , morso 8x1,8 mm;
- N.1 pz. Pinza di Laborde per dilatazione tracheale ;
- N.1 pz. Portagli cm18 con morso in carburo di tungsteno;
- N.2 pz. Antrum punch, cm.10, con morso a destra;
- N.2 pz. Antrum punch, cm.10, con morso a sinistra;
- N.2 pz. Pinza per polipi curva verso il basso cm.10 con ganascia fissa a 90 gradi e quella mobile a 120 gradi;
- N.2 pz. Laringoscopio operativo lunghezza circa 17 cm, diametro 27x15 mm. con lume interno di almeno 15 mm.;
- N.2 pz. Laringoscopio operativo lunghezza circa 18 cm con diametro operativo mm.18x 13, per commissura anteriore;

- N.2 pz. Aspiratore nasale di Frazier, lunghezza operatica cm.10, diametro 10 ch.;
- N.2 pz. Aspiratore scollatore di Guillen cm.20;
- N.1 pz. Forbice di Metzenbaum, dente curve sottili, lunghezza cm.15 circa;
- N.2 pz. Aspiratore di Frazier con regolazione dell'aspirazione 8 ch;
- N.2 pz. Aspiratore di Frazier con regolazione dell'aspirazione 10 ch;
- N.2 pz. pinze di Durante;
- N.5 pz. pinze klemmer curve varie misure;
- N.1 pz. pinza passafili
- N.2 pz. pinze da presa piccole
- N.1 pz. forbice da collo cm.20;
- N.2 pz. retrattori di Langenbeck cm.21 lama da 35x15;
- N.2 pz. pinze per arterie di Adson cm.18

Lotto n. 03

Sistema al plasma per chirurgia ORL.

La tecnologia richiesta è **RADIOFREQUENZA A 100 KHz AL PLASMA MONOPOLARE CON ATTIVAZIONE IN SOLUZIONE SALINA** con due modalità di ablazione e con la presenza di un display per la visualizzazione del tempo di applicazione e dell'impedenza.

La chiesta tecnologia deve mantenere basse temperature ma deve essere gestibile dal chirurgo (quindi non dotata di funzioni autostop tipiche di apparecchi che tendono a raggiungere temperature maggiori).

Range di profondità di emostasi tra i 50 ed i 100 micron.

Tale strumentazione deve essere fornita **"IN SERVICE"**, in funzione della dotazione dei manipoli monouso.

MANIPOLI MONOUSO:

Il manipolo per il trattamento dell'ipertrofia dei turbinati deve essere lungo 11 cm, avere un diametro di 1,7 mm ed una punta massimo di 0,5 mm. con angolo di curvatura a 18°.

Il manipolo per tonsille, sterile monouso, deve avere una lunghezza massima di 15,6 cm ed un diametro di massimo 5,15 mm. La lunghezza operativa distale massimo 10cm ed angolata a 37°.

Il manipolo per palato, sterile monouso, deve avere una lunghezza massima di 17,4 cm ed un diametro di massimo 4,4 mm. La lunghezza operativa distale massimo 140mm ed angolata a 20°.

Si indica, di seguito, il fabbisogno presunto annuo :

- ***N.15 pz. Manipoli per faringoplastica;***
- ***N.15 pz. Manipoli per tonsillectomia;***
- ***N.20 pz. Manipoli per turbinati.***

Lotto n. 04

Aggiunta di Software per Prodotti di Distorsione nel sistema ABR Neuro Audio cod 10853 con sistema gestione e archiviazione e stampa dati

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA :

- 1)** Software per opzione “Prodotti di Distorsione ” (inclusi test TEOAE – DPOAE – SOAE) da aggiungere al sistema ABR Neuro Audio cod 10853 già in possesso al P.O. di Sciacca
- 2)** Gestione dati anagrafici utenti
- 3)** Stampa risultati
- 4)** Archiviazione risultati
- 5)** Sonda OAE, n° 3 puntali per sonda, n° 3 set tappi auricolari OAE, n° 1 cavità di prova, n° 1 kit pulizia sonda, n° 1 estrattori di puntali per sonda
- 6)** Controllo fit sonda
- 7)** Possibilità di selezionare le frequenze

Lotto n. 05

Aggiunta di Software per potenziali ASSR e mASSR nel sistema ABR Neuro Audio cod 10853 da aggiungere al sistema ABR Neuro Audio cod 10853 già in possesso al P.O. di Sciacca

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA:

- 1) Software per opzione “Opzione Auditory steady –state response” (ASSR) con possibilità di stimolazione contemporanea a 4 frequenze (mASSR) da aggiungere al sistema ABR Neuro Audio cod 10853 già in possesso al P.O. di Sciacca**
- 2) Gestione dati anagrafici utenti**
- 3) Stampa risultati**
- 4) Archiviazione risultati**

Lotto n. 06

Aggiunta di Software vocale in Italiano ai due Audiometri Piano Plus cod 11680 da aggiungere agli Audiometri già in possesso al P.O. di Sciacca

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA:

- Modulo software vocale SD in italiano con liste materiale standard e aggiuntivo
- Modulo software vocale per Maestro in italiano con liste materiale standard e aggiuntivo
- File con liste di frasi e parole per esame vocale semplice e sotto competizione per adulti e bambini

Lotto n. 07

Timpanometro portatile

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA:

- Tono 226 Hz
- Intervallo di pressione configurabile dall'operatore (da - 600 a + 400) daPa) con limiti di sicurezza a - 800 e +600daPa
- Regolazione manuale della pressione
- Avvio automatico del test
- Stampa dell'esame

Lotto n. 08

Impedenzometro clinico ad Alta Frequenza

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA:


- Tono sonda a 226Hz, 678Hz, 800 Hz, 1000Hz
- Sonda adulti e pediatrica
- Deve eseguire
 - Timpanometria automatica e manuale
 - Test di funzionalità tubarica per timpani intatti o perforati
 - Riflessi acustici automatica e manuale in IPSI (500,1000,2000,4000,6000) e CONTRA (250,500,1000,2000,4000,6000,8000) con test di latenza del riflesso
 - Decay del riflesso acustico e non acustico
 - Quick Test
 - Modalità screening
- Completo di stampante

Lotto n. 09

Sistema Potenziali Evocati (Abr)

CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZATURA:

- Sistema a 2 canali
- Controllo dell'impedenza degli elettrodi anche durante l'esecuzione dell'esame
- Possibilità di variare i filtri passa basso e passa alto
- Rilevazione automatica degli artefatti
- Che possa eseguire i seguenti potenziali
 - Auditory braistem response (ABR) con ricerca di soglia
 - Braistem evoked response audiometry (BERA)
 - Auditory steady-state respponse (ASSR) con possibilità di stimolazione contemporanea a 4 frequenze per entrambe le orecchie (multi ASSR)
 - Potenziali evocati acustici a media e lunga latenza (MLR, LLR/CAEP)
 - Potenziali evocati miogenici vestibolari oculari e cervicali (o-VEMPs , c-VEMPs)
 - Potenziali cognitivi (MMS, P300)
- Tono Click, Tono Burst e stimoli verbali
- Tutti gli accessori per l'esecuzione dei potenziali sopra elencati (cuffie, inserti, vibratore , ecc)
- Software gestionale dati e archivio pazienti
- Completo di stampante a colori

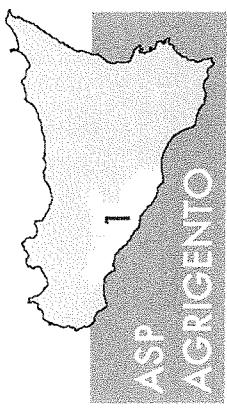


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC-SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore: Dr. Giuseppe Patruno (Collab.: A.
Telefonio: 0922/407279
FAX 0922/407119

DETtaglio Prezzi

LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)

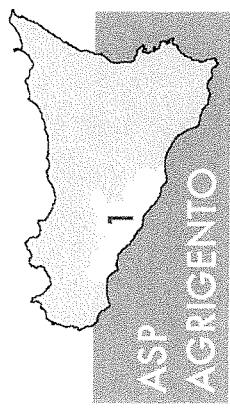

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVE EDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo, (Coltab)
Telefono: 0922-407119
FAX: 0922-407119

SCHEMIA OFFERTA TECNICA SENZA PREZZI

LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

**Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

Immediatamente esecutiva dal 28 APR 2022

Agrigento, li 28 APR 2022

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le Sig. DOMENICO ALAIMO
Sig.ra Sabrina Terrasi **Coadiutore Amministrativo**

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi