



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Assistente Amministrativo Biagio De Martino
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407511
E-mail: forniture@aspag.it
E-mail: biagio.demartino@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 39358 del 28/02/2022

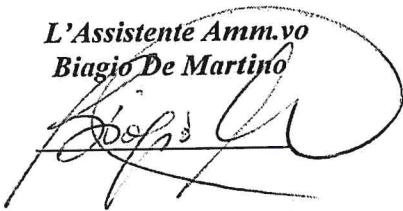
A tutte le ditte interessate

Oggetto : Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di “N. 2 Autoclavi per Laboratorio”.

Si invita a comunicare se il prodotto indicato in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate in allegato alla presente, rientra tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante, e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita a specificare eventuali criticità che impediscono la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 7 all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it. Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*L'Assistente Amm.vo
Biagio De Martino*


*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*


SCHEDA TECNICA

N. 2 Autoclavi a vapore, verticali idonee alla sterilizzazione a vapore ad alta pressione di terreni per colture microbiologiche, vetreria e strumentazione varia di laboratorio, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Autoclavi da pavimento a caricamento verticale con camera di sterilizzazione cilindrica;
 - Volume interno effettivo della camera di sterilizzazione: 19 – 24 litri;
 - Pressione massima di esercizio: 2 – 2.2 bar;
 - Temperatura massima di esercizio: 134 – 140 °C;
 - Tempo di sterilizzazione programmabile: da 1 a 99 min;
 - Ciclo di sterilizzazione programmata con almeno un programma personalizzabile;
 - Cicli di sterilizzazione programmati gestiti da microprocessore;
 - Volume di acqua distillata o deionizzata richiesta: 2.5 - 3.0 litri/ciclo di sterilizzazione;
 - Segnalazione visiva e/o acustica per mancanza di acqua distillata e/o deionizzata;
 - Sistema di sicurezza elettronico mediante microprocessore per prevenire eccesso di temperatura;
 - Valvola di sicurezza eccesso di pressione;
 - Camera di sterilizzazione in acciaio inox 18-10 AISI 304 o AISI 316L;
 - Uno o più cestelli in dotazione;
 - Misure autoclave: largh. 50 – 72 cm; prof. 45 – 58 cm; alt. 94-121 cm;
 - Peso: 45 – 60 Kg;
 - Con blocco apertura;
 - Stampante incorporata;
-
- Dichiarazione di conformità alla Direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione per categoria I;
 - Conformità alle norme e direttive europee.