

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO. N. 285 DEL 15 FEB. 2023

**OGGETTO:** Trattativa diretta, ai sensi dell'art. 63 comma 2 Lettera b) del D. Leg.vo 50/2016, per la fornitura di un Pacemaker IRIS VDD MR con elettrocatetere prodotto dalla Medico s.r.l. per l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento. **Approvazione trattativa diretta e aggiudicazione fornitura alla società Medico s.r.l..**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 318 DEL 06.02.2023

L'Assistente Amministrativo  
Sig. Alfonso De Leo

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott. Oreste Falco

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

CS 4040541

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.E.P.  
Sig. Saverio Maria  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE DIRETTORE SEF e P.

SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Beatrice Salvado

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

14 FEB 2023

L'anno duemilaventitre il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SSA TENESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, Dr. Oreste Falco

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO CHE:**

- il Direttore dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento, con nota email del 30 gennaio 2023, ha trasmesso la richiesta d'acquisto di un Pacemaker IRIS VDD MR con elettrocatetere con relativa dichiarazione di infungibilità che si riporta: *“...paziente di anni 61 già sottoposto ad estrazione di sistema di elettrone stimolazione bicamerale per endocardite, per la risoluzione del rischio infettivo è necessario un sistema VDD monocatetere con compatibilità MRI...si specifica che il sistema richiesto è l'unico MRI compatibile VDD disponibile sul mercato...”*, indicando nella medesima richiesta che il produttore e distributore del dispositivo è la società Medico S.r.l.;
- che la sopra citata richiesta è stata redatta secondo l'allegato “C” – *“...Acquisto di dispositivi medici, presidi medici chirurgici...”*, approvato con deliberazione CS n. 496 del 23.3.2022 di *“Approvazione del Regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni in regime di infungibilità ed esclusività di cui all'art. 63 del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016)”*;
- il Direttore dell'U.O.C. di Farmacia del P.O. di Agrigento ha posto in calce alla predetta richiesta di cui all'allegato “C” approvato con delibera CS n. 496/2022 quanto segue: *“...trattandosi di pace maker, quindi di dispositivo specialistico, questa farmacia non può esprimersi in merito essendo solo lo specialista cardiologo, in questo caso il direttore della U.O.C. di Cardiologia Dr. G. Caramanno a poter esprimere, a potere definire infungibile la necessità del dispositivo indicato. Pertanto si rinvia a quanto dichiarato dal Dr. G. Caramanno...”*;
- il pace-maker IRIS VDD MR prodotto dalla Medico S.r.l. risulta incluso nel Lotto n. 1 – Voce A *“Pacemaker bicamerale monocatetere VDD, comprensivo di elettrocatetere”* della procedura di gara esperita dalla Centrale Unica di Committenza – CU.C. di cui al D.A.S. 1332 del 14.06.2019, ma cui i quantitativi di questa ASP si sono esauriti (deliberazione di presa atto DG f.f. n. 145 del 30.01.2020);
- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi;
- la U.O.C. Servizio Provveditorato con nota prot. n. 17323 del 30/01/2023, ha avviato *“Avviso di volontaria trasparenza per la fornitura di che trattasi, pubblicata sul sito di questa Stazione Appaltante nella sezione bandi di gara e contratti;*

- conseguentemente attesa l'urgenza, con pec del 30 gennaio 2023, è stata trasmessa alla Medico s.r.l. la lettera d'invito/capitolato speciale da riscontrare entro le ore 13:00 del 31 gennaio 2023;

**VISTI**

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, di acquistare beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 senza far ricorso al ME.PA.;

**CONSIDERATO** che entro il termine utile per la presentazione dell'offerta, fissato per le ore 13:00 del 31.01.2023, la società Medico s.r.l. ha presentato l'offerta economica, offerta tecnica e dichiarazione così come richiesto dalla U.O.C. Provveditorato, offrendo il prezzo del pacemaker IRIS VDDS MR completo di elettrocatetere ad € 1.900,00=+ I.V.A. (€ 1.670,00=+ I.V.A. importo pacemaker + € 230,00=+ I.V.A. importo relativo dell'elettrocatetere), offerta ritenuta conforme da parte del Direttore richiedente (giusta email del 01/02/2023);

**RITENUTO:**

- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, DEC il Dr. Giuseppe Caramanno Direttore dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento;
- opportuno, con il presente atto aggiudicare alla Medico s.r.l. l'affidamento della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 63 comma 2 Lettera b) del D. Leg.vo 50/2016, per la fornitura di un Pacemaker IRIS VDD MR con elettrocatetere per l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento, alle condizioni indicate nel documento "Lettera d'invito/capitolato speciale" e nell'offerta del predetto operatore economico e per un prezzo complessivo della fornitura pari ad € 1.900,00=+ I.V.A. (importo di aggiudicazione uguale a quello praticato alla CUC n. 1 – Voce A "Pacemaker bicamerale monocatetere VDD, comprensivo di elettrocatetere" – D.A.S. 1332 del 14.06.2019);

**DATO ATTO** che:

- si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- l'onere derivante dal presente atto, ammontante ad € 1.976,00=+ IVA 4% è da iscrivere sul conto C501010511 del bilancio aziendale, come da seguente quadro economico:

Fornitura	€	1.900,00
IVA aliquota 4%	€	76,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>1.976,00</b>

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DARE ATTO** che il Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento ha trasmesso la richiesta d’acquisto -ALL n.1- di un Pacemaker IRIS VDD MR con elettrocatatere con relativa dichiarazione di infungibilità che si riporta: “...*paziente di anni 61 già sottoposto ad estrazione di sistema di elettrico stimolazione bicamerale per endocardite, per la risoluzione del rischio infettivo è necessario un sistema VDD monocatetere con compatibilità MRI... si specifica che il sistema richiesto è l’unico MRI compatibile VDD disponibile sul mercato...*”, indicando nella medesima richiesta che il produttore e distributore del dispositivo è la società Medico S.r.l.;
2. **APPROVARE** il documento denominato “Lettera invito/capitolato speciale” -ALL. N. 2-, l’avviso di Volontaria trasparenza prot. n. 17323 del 30.01.2023 - ALL. n. 3-;
3. **AGGIUDICARE** alla Medico s.r.l. l’affidamento della trattativa diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 Lettera b) del D. Leg.vo 50/2016, per la fornitura di un Pacemaker IRIS VDD MR con elettrocatatere per l’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento, alle condizioni indicate nel documento “Lettera d’invito/capitolato speciale” e nell’offerta del predetto operatore economico e per un prezzo complessivo della fornitura pari ad € 1.900,00= + I.V.A. (importo di aggiudicazione uguale a quello praticato alla CUC n. 1 – Voce A “Pacemaker bicamerale monocatetere VDD, comprensivo di elettrocatatere” – D.A.S. 1332 del 14.06.2019);
4. **Dare atto** che l’esecuzione del presente provvedimento verrà curata dalla Farmacia del P.O. di Agrigento, trattandosi di dispositivi medico impiantabile.
5. **NOMINARE** ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all’intervento oggetto del presente provvedimento, DEC il Dr. Giuseppe Caramanno Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento;
6. **DARE ATTO** che l’onere derivante dal presente atto, ammontante ad € 1.976,00=+ IVA 4% è da iscrivere sul conto C501010511 del bilancio aziendale, come da seguente quadro economico:

Fornitura	€	1.900,00
IVA aliquota 4%	€	76,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>1.976,00</b>

7. **DARE ATTO** che l’aggiudicazione della procedura in oggetto è avvenuta entro il termine di due mesi, stabilito dall’art. 1, comma 1, D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020;

8. **DARE ATTO**, altresì, che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse;

9. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'immediata attivazione della fornitura di cui al presente provvedimento.


Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato**


**Dott. Oreste Falco**

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere



Data

  
14/04/623

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Alessandro Mazzara**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Mario Zappia**

**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VC TPC  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cingue



Acc. n° 1

### Allegato C

**RICHIESTA D'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI, PRESIDI MEDICI CHIRURGICI,  
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
O ALTRI MATERIALI SANITARI DA UN PRODUTTORE/FORNITORE  
PREDETERMINATO (INFUNGIBILI e/o ESCLUSIVI)**

Unità operativa richiedente: CARDIOLOGIA

Prodotto e caratteristiche tecniche: PACEMAKER PM 1015 VAA M + E. CATERG. D

Codice Repertorio Nazionale: 2089570/R + 2089607/R CATPH44R

Esigenze che stabiliscono l'acquisto presso operatore determinato

NEL REPERTORIO AZIENDALE NON SONO DISPONIBILI PRODOTTI CON CARATTERISTICHE CHE GARANTISCANO SOLUZIONI EQUIVALENTI IN TERMINI DI PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI, FATTE SALVE LE VARIABILITÀ INDIVIDUALI.

□ I PRODOTTI PRESENTI IN REPERTORIO EQUIVALENTI HANNO REQUISITI FUNZIONALI CHE COMPORTANO INCOMPATIBILITÀ O DIFFICOLTÀ TECNICHE SPROPORZIONATE PER IL LORO IMPIEGO;

DETtagliare la motivazione: Per chi ha 61 anni già 210.000 lire al estremo  
di 210.000 lire di elettrificazione basta che le per la fabbrica.  
Per la riuscita delle installazioni è necessario un  
elettrificatore. Istituto per la riuscita delle installazioni è  
necessario il riconoscimento per tale. Per chi specifica  
che al 210.000 lire di  
Prodotto: MEDICO SRL  
Società Distributrice: MEDICO SRL  
Costo preventivato per l'acquisto: 1670,00 + 230,00  
Stima di consumi annuali: 11000 lire  
Dichiarazione di competenza per il mercato.

Il sottoscritto consapevoli delle conseguenti responsabilità di natura disciplinare e deontologica, amministrativo-contabile per danno erariale e penale, dichiarano che per le indicazioni sopra specificate nel repertorio nazionale, non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali.

data 16-01-2223

Il Direttore dell'Unità Operativa richiedente

PARERE del Direttore del P.O. di riferimento:  Favorevole con riserva.  Non favorevole.

DIRETTORE SANITARIO P.O.  
DOTT. G. MIGLIAZZO

Favorevole subordinato alla definizione di schede di monitoraggio e/o raccomandazioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle strumentazioni proposte

Sospensione del parere con richiesta di approfondimenti e/o ulteriore documentazione

CONTRARIO (motivare):

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

PARERE direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera:

FAVOREVOLE  CONTRARIO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

18/01/23

Tutt'adesso il pese MAKER, quindi chi  
dirigente Ospedaliero, questa Firma non  
può esprimere un voto, quindi solo lo  
Spediatore Cagliari, in questo caso il  
dir. u. delle U.O. di Cagliari Dr. G. CAILLANT  
a forte spese, a forte difesa in pubblico  
o meno fa ricevuto del d. aperto indicato  
Pertanto avendo a questo dichiarato  
del Dr. G. Cacciazzo -

  
A.R. Agilgeny UOC Farmacia  
P.O. San Giovanni Di Dio  
Il Direttore  
Dott. Giuseppe Bellavia



Spett.le  
**ASP DI AGRIGENTO**  
Viale della Vittoria, 321  
92100 – AGRIGENTO  
PEC: [economico.patrimoniale@pec.aspag.it](mailto:economico.patrimoniale@pec.aspag.it)

Rubano (PD), 10/01/2023

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITÀ**

**Sistema di cardiostimolazione VDDR composto dallo stimolatore cardiaco impiantabile pacemaker  
modello IRIS VDD MR ed elettrocavettone modello PHYMOS 44 MRI e PHYMOS 44L MRI.**

Si dichiara che Medico s.r.l. è l'unica azienda produttrice per il sistema in oggetto.

Sul mercato non sono infatti presenti dispositivi analoghi, ovvero cardiostimolatori VDDR con relativo monocabrettone, compatibili con la Risonanza Magnetica, pertanto il sistema di stimolazione in oggetto è da ritenersi unico ed infungibile.

Il dispositivo presenta quindi requisiti indispensabili per consentire al paziente di essere sottoposto in sicurezza all'esame di Risonanza Magnetica.

Ciò costituisce un rilevante beneficio clinico per tutti i pazienti che necessitano di questo esame, indispensabile per la diagnosi di alcune patologie.


A conferma dell'infungibilità del sistema, si notifica che in nessuna gara d'appalto relativa alla fornitura di stimolatori cardiaci impiantabili, è stato mai offerto da altre aziende, al di fuori di Medico s.r.l o Medicopace s.r.l., un sistema di cardiostimolazione di tipologia VDD monocabrettone, compatibile con la Risonanza Magnetica Nucleare.

In fede, distintamente

Medico Srl.  
Il Legale Rappresentante  
Eugenio Centin Snichelotto

# Iris VDD MR

## SCHEDA TECNICA

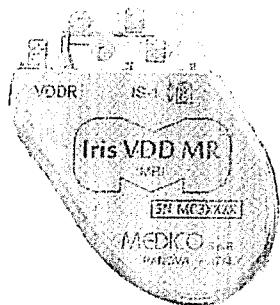

### FABBRICANTE :

MEDICO S.p.A.  
Via Pitagora n. 15  
35030 RUBANO (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 8976755  
Fax. +39 049 8976788  
www.medicoweb.com  
info@medicoweb.com

Modello	Codice	Tipo	Descrizione	Connessione	Identificatore Radiologico
Iris VDD MR	PMIRISVDDM	VDDR	Pacemaker bicamerale Rate Responsive	Bipolare, IS-1	M*C3 MRI

\*= lettera identificativa dell'anno di produzione

### CARATTERISTICHE FISICHE

Modello	Dimensioni (mm) (Altezza X Larghezza X Spessore)	Peso (g)	Volume (cc)	Vita prevista (100% pacing)*
Iris VDD MR	53.4 x 47.1 x 6.6	23.3	10.5	117 mesi

\* Vita prevista alle seguenti condizioni operative VDD, 60 min-1, 2.5V, 0.43 ms, 500 Ohm, sensore OFF.

### PARAMETRI PROGRAMMABILI

Parametri	Range di programmazione	Configurazione alla spedizione
MODO di PACING	ODO↔VDD, VDD, VDI, VDT, VVT, VAT, VVI, VOO, ODO, OVO, OAO, OOO Per tutti i modi di pacing è disponibile la funzione Rate Responsive	VDD
FREQUENZA BASE (min <sup>-1</sup> )	30 ÷ 130, passo 2; 135 ÷ 190, passo 5	60
ISTERESI IN FREQUENZA CON RICERCA (% frequenza corrente)	OFF - 6 - 11 - 20 - 27	OFF
Intervallo di ricerca (cicli)	32 ÷ 4096	256
PACING MAGNETICO	ON / OFF	ON
MODO MAGNETICO	VOO	VOO
AMPIEZZA IMPULSO VENTRICOLARE (V)	0.08 ÷ 0.4 passo 0.08; 0.5 ÷ 2.5 passo 0.1; 2.75 ÷ 6 passo 0.25; 6.5 ÷ 7.5 passo 0.5	2.5
DURATA IMPULSO VENTRICOLARE (ms)	0.06 ÷ 1.89, passo 0.06	0.43

MEDICO S.p.A.

Via Pitagora, 15 - 35030 RUBANO (PD) ITALY  
Tel. +39 049 8976755 - Fax. +39 049 8976788

www.medicoweb.com - info@medicoweb.com

POLARITÀ PACING VENTRICOLARE	UNIPOLARE / BIPOLARE	UNIPOLARE
POLARITÀ SENSING ATRIALE	BIPOLARE	BIPOLARE
POLARITÀ SENSING VENTRICOLARE	UNIPOLARE / BIPOLARE	UNIPOLARE
SENSIBILITÀ ATRIALE (mV)	0.08 ÷ 0.2, passo 0.04; 0.25; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8 1 ÷ 2, passo 0.25 2.5 ÷ 4, passo 0.5; 5; 6; 8	0.12
AUTOSET DELLA SENSIBILITÀ ATRIALE	Auto / Fissa	Auto
SENSIBILITÀ VENTRICOLARE (mV)	0.25; 0.3; 0.4 (solo Bipolare) 0.5; 0.6; 0.8 1 ÷ 2, passo 0.25 2.5 ÷ 4, passo 0.5; 5; 6; 8	2
AUTOSET DELLA SENSIBILITÀ VENTRICOLARE	Auto / Fissa	Auto
Segno sensibilità atriale e ventricolare	- / +	-
UPPER RATE (min <sup>-1</sup> )	80 ÷ 190, passo 5	120
PER. REFRATT. ATRIALE (ms)	184 ÷ 480, passo 8	280
PER. REFRATT. VENTRICOLARE (ms)	184 ÷ 600, passo 8	240
PVARP	184 ÷ 600, passo 8	280
Estensione PVARP	8 ÷ 352, passo 8	144
Estensione PVARP dopo PVC	ON / OFF	OFF
Estensione PVARP dopo Pacing Ventr. non sequenziale	ON / OFF	ON
RITARDO AV MASSIMO DOPO SENSING ATRIALE (ms)	0 ÷ 352, passo 8	128

## 2 FUNZIONI

Parametri	Range di programmazione	Configurazione alla spedizione
COMMUTAZIONE POLARITÀ CATETERE	ON / OFF	OFF
RICONOSCIMENTO AUTOMATICO D'IMPIANTO	ON	ON
AUTOSET DELLA SENSIBILITÀ	Auto / Fissa	Auto
La funzione Autoset della Sensibilità consente la regolazione automatica della sensibilità mediante adeguamento del valore programmato in funzione dell'ampiezza del segnale intrinseco del paziente, garantendo un margine di sicurezza di 3X.		
RITARDO AV ADATTATIVO	ON/OFF	ON
Ritardo AV massimo (ms)	0 ÷ 352, passo 8	128
Ritardo AV minimo (ms)	0 ÷ 352, passo 8	96
Frequenza Iniziale (min <sup>-1</sup> )	30 ÷ 130, passo 2	86
Frequenza Finale (min <sup>-1</sup> )	80 ÷ 130, passo 2; 130 ÷ 190, passo 5	110
ISTERESI RITARDO AV CON RICERCA (ms)	+0 ÷ +120, passo 8	+0
Intervallo di ricerca (cicli)	32 ÷ 4096	256

Le funzioni di Ritardo AV Adattativo e di Isteresi con Ricerca del Ritardo AV consentono di diminuire la percentuale di pacing ventricolare, favorendo la conduzione spontanea e i conseguenti benefici emodinamici per il paziente.

<b>SENSORE ACCELEROMETRICO</b>	OFF / PASSIVO / ON	OFF
Profili predefiniti	4 opzioni predefinite + programm. personalizz.	Moderata
Upper Rate sensore (min <sup>-1</sup> )	80 ÷ 190, passo 5	110
Velocità reazione RR	Lenta, Moderata, Normale, Veloce	Normale
Velocità recupero RR	Lenta, Moderata, Normale, Veloce	Normale
Limitatore frequenza (min <sup>-1</sup> / ciclo)	1, 2	1
<b>RITMO CIRCADIANO</b>	ON / OFF	OFF
Ora inizio sonno	0:00 ÷ 23:45, passo 15 min	23:00
Ora fine sonno	0:00 ÷ 23:45, passo 15 min	7:00
Abbassamento notturno (min <sup>-1</sup> )	2 ÷ 28, passo 2	10
<b>ADEGUAMENTO AL RIPOSO</b>	ON / OFF	OFF
Riconoscimento dopo (min)	8; 17; 34; 68; 136	34
Ripristino dopo (s)	2; 4; 8; 16	8
Abbassamento freq. a riposo (min <sup>-1</sup> )	2 ÷ 28, passo 2	10
<b>ADEGUAMENTO POST-ESERCIZIO</b>	ON / OFF	OFF
Soglia esercizio (min <sup>-1</sup> )	70 ÷ 150, passo 5	80
Durata minima (min)	2 ÷ 20, passo 2	4
Le funzioni Ritmo Circadiano e Adeguamento al riposo permettono di ottenere una regolazione fisiologica della frequenza di stimolazione coerentemente con lo stato di attività o riposo del paziente.		
<b>CONTROREL DECREMENTO FREQUENZA (RDC)</b>	ON / OFF	ON
Adeguamento alla frequenza spontanea (%)	75, 87, 94	87
Velocità Reazione RDC	Lenta, Moderata, Normale, Veloce	Normale
Velocità Recupero RDC	Lenta, Moderata, Normale, Veloce	Normale
La funzione Controllore Decremento in Frequenza, nel caso in cui si abbia una brusca caduta della frequenza spontanea del paziente, assicura una stimolazione ad una frequenza prossima (in percentuale programmabile) a quella spontanea rilevata nei cicli precedenti. E' in grado quindi di evitare episodi sintomatici per il paziente correlati a blocchi parossistici sino atriali o atrio-ventricolari o a sindrome neuromediativa.		
<b>ANTI-PMT</b>	ON / OFF	ON
Funzione di riconoscimento e interruzione di episodi di tachicardia mediata da PM.		
<b>CONVERSIONE DI MODO REVERSIBILE</b>	ON / OFF / ON-RR	ON-RR
Frequenza minima SVT (min <sup>-1</sup> )	125 ÷ 200, passo 5	160
Nº di cicli per riconoscimento SVT (cicli)	8, 16	8
Frequenza base durante la conversione (min <sup>-1</sup> )	30 ÷ 190	60
La Conversione di Modo Reversibile è una funzione di protezione in caso di tachicardia atriale: la stimolazione ventricolare (in modalità in VDI o VDIR) durante tali episodi sarà non sincronizzata al sensing atriale ad alta frequenza.		
<b>PRONTA RISPOSTA ALLE PAC</b>	ON / OFF	ON
Intervallo PAC (% ciclo di riferimento)	44, 50, 56, 62, 75	62
Funzione di protezione in caso di evento atriale prematuro che non sincronizza la stimolazione ventricolare all'evento atriale ad alta frequenza.		
<b>RIDUZIONE PACING VENTRICOLARE (VPR)</b>	ON / OFF	OFF
Controllo Emodinamico con TVI	ON / OFF	OFF
Commutazione	IMMEDIATA / RITARDATA	RITARDATA
Intervallo PR massimo dopo Sensing Atriale (ms)	200 ÷ 416, passo 24	296
Massimo livello di blocco tollerato	2:1; 3:2; 4:3; 5:4; 6:5; 7:6; 8:7; 9:8; 10:9	4:3
La funzione Riduzione Pacing Ventricolare promuove la conduzione spontanea atrio-ventricolare e riduce la stimolazione ventricolare, monitorando costantemente la conduzione A-V.		

MEDICO S.p.A.

Via Pitagora, 15 - 35030 RUBANO (PD) ITALY

tel. +39 049 8976755 - fax. +39 049 8976788

[www.medicoweb.com](http://www.medicoweb.com) - [info@medicoweb.com](mailto:info@medicoweb.com)

DIAGNOSTICA	ON / OFF	ON
Opzione trend	Frequenza+RR; TVI+CRate; TVI+CRate; TVI+CRate; TVI+RRate; Cattura	Frequenza+RR
Durata acquisizione	30 minuti; 6-12-24 ore; 2-3 giorni; 8 mesi	24 ore
Modo acquisizione	ONE SHOT/ROLL	ROLL
Modo di Riavvio (Contatori e Istrigrammi)	Reset / Continua	Reset
Modo di Riavvio (trend temporali)	Reset / Continua	Continua
Modo di Riavvio (trends di sensing)	Reset / Continua	Continua
Modo di Riavvio (trend di energia)	Reset / Continua	Continua

## SEGNALE DI IMPEDENZA TRANS-VALVOLARE (TVI) E FUNZIONI SPECIALI

Parametri	Range di programmazione	Configurazione alla spedizione
Connessione Atriale	Assente / Ring1 / Ring2 / Split-Ring1 / Split-Ring2	ASSENTE
Connessione Ventricolare	Assente / Tip / Ring / Split-Tip / Split-Ring / Locale	ASSENTE
Corrente TVI (µA)	3.5 ÷ 44.8	14
Conferma eiezione dopo pacing ventricolare	OFF / PASSIVA / ON	OFF
Conferma eiezione dopo sensing ventricolare	OFF / PASSIVA / ON	OFF
Protezione	PERMANENTE/ TEMPORANEA	PERMANENTE
L'Impedenza Trans-Valvolare è un segnale di impedenza intracardiaci rilevata tra Atrio e Ventricolo Destro senza l'uso di cateteri dedicati; questo segnale risulta direttamente correlato alla contrattilità miocardica e inversamente proporzionale alle variazioni volumetriche durante il ciclo cardiaco.		
Conferma eiezione dopo pacing ventricolare: Riconoscimento battito-battito di episodi di mancata cattura ventricolare con riprogrammazione dell'impulso ad energia di sicurezza; scansioni periodiche dell'energia di stimolazione ed eventuale riprogrammazione ai valori minimi impostati.		
Conferma eiezione dopo sensing ventricolare: Validazione del sensing ventricolare e disponibilità di una funzione di protezione in caso di oversensing.		

## MEMORIZZAZIONE "IECG" + TVI + EGM" DI EVENTI TACHICARDICI

Parametri	Range di programmazione	Configurazione alla spedizione
Memorizzazione Tracciato	ON / OFF	ON
Frequenza Ventr. per Rilevamento (min <sup>-1</sup> )	125 ÷ 200	160
Cicli per rilevamento	4, 6, 8	4
Cicli per terminazione	4, 8, 16, 32	16
1° segnale memorizzato	IECG / TVI / Aring1-Case / Aring1-Aring2 / Vring-Case / Vtip-Case / Vtip-Vring	IECG
2° segnale memorizzato	Nessuno / IECG / Aring1-Case / Aring1-Aring2 / Vring-Case / Vtip-Case / Vtip-Vring	Aring1 - Aring2
Durata acquisizione per episodio (sec)	8, 16	8
Modo di Riavvio (episodi tachicardici)	Reset / Continua	Continua
Durata minima per il riconoscimento SVT (mm:ss)	Qualsiasi; 00:30; 1:00, 1:30; 2:00	1:00

MEDICO s.p.a.

Via Pilagora, 15 - 35030 RUBANO (PD) ITALY  
tel. +39 049 8976755 - fax. +39 049 8976788  
www.medicoweb.com - info@medicoweb.com

## • CONTROLLO REMOTO PAZIENTE

Parametri	Range di programmazione	Configurazione alla spedizione
Follow-up Completo	MAI / 2 settimane / 1 mese / 2 mesi / 3 mesi / 4 mesi / 5 mesi / 6 mesi / 8 mesi / 12 mesi	3 mesi
Follow-up Veloce (solo Controllo Allarmi)	MAI / 1 giorno / 2 giorni / 3 giorni / 4 giorni / 5 giorni / 6 giorni / 1 settimana / 1 mese	MAI
Avvisare il paziente all'ora:	Orologio	21:00
Follow-up su richiesta del paziente	ON / OFF	ON
Tracciati Episodi Tachicardici	Ridotti / Completi	Ridotti
Avvisare il paziente di recarsi all'Ospedale al prossimo Follow-up	ON / OFF	OFF
Ospedaliero		
Alla Data	Calendario	--/--/----
<b>SETUP ALLARMI</b>		
RRT (Allarme di Batteria)	ON+H	ON+H
Impedenza del Catetere	ON+H / ON / OFF	OFF
Impedenza maggiore di (Ohm)	1500 – 3000, passo 250	2000
Impedenza minore di (Ohm)	200 – 500, passo 50	300
Commutazione Polarità	ON+H / ON / OFF	OFF
Catetere		
Margine di Sensing Atriale < 3X	ON+H / ON / OFF	OFF
Margine di Sensing Ventricolare < 3X	ON+H / ON / OFF	OFF
EPISODI TACHICARDICI ATRIALI	ON+H / ON / OFF	OFF
Solo se la durata è superiore di (min)	DISABILITATO / QUALUNQUE / 1 / 2 / 5 / 15 / 30 / 60	DISABILITATO
Solo se la Freq. Ventr. media è maggiore di (min <sup>-1</sup> )	DISABILITATO / QUALUNQUE / 100 / 125 / 150 / 175 / 200	DISABILITATO
EPISODI TACHICARDICI VENTRICOLARI	ON+H / ON / OFF	OFF
Solo se la durata è superiore di (min)	QUALUNQUE / 1 / 2 / 5 / 15 / 30 / 60	DISABILITATO

## • MODALITA' MRI

Parametri	Range di programmazione	Configurazione alla spedizione
MODALITA' MRI	OFF / ON	OFF
Tempo Massimo alla Fine della Scansione MRI (ore)	12; 24; 36; 48	36
Modo MRI	VOO; OOO	VOO
Frequenza Base (min <sup>-1</sup> )	80, 90, 100	90
Aampiezza Impulso Ventricolare (V)	5; 6	5
Durata Impulso Ventricolare (ms)	0.98 (fisso)	0.98
Polarità Impulso Ventricolare	BIPOLARE (fisso)	BIPOLARE

## • DIAGNOSTICA

### ATTIVITA' CARDIACA

- Conteggio del numero di eventi di sensing e pacing
- Conteggio degli eventi ventricolari prematuri (PVC)
- Rappresentazione grafica.



Acc. N° 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

Telefono 0922 407226/459  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[mariatirro@aspag.it](mailto:mariatirro@aspag.it)

#### AGLI OPERATORI ECONOMICI

#### **LETTERA INVITO/CAPITOLATO SPECIALE**

**Oggetto: Trattativa diretta per la fornitura di un «PACEMAKER IRIS VDD MR CON ELETTROCATETERE».**

Si invita codesto operatore economico, se interessato e senza alcun impegno per questa ASP, a presentare la propria miglior offerta, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs.vo 50/2016, per la fornitura **un «PACEMAKER IRIS VDD MR CON ELETTROCATETERE» per un importo a base di gara pari ad € 1.900,00=+ I.V.A..**

Codesto operatore economico è invitato a presentare – attesa l'urgenza determinata dall'aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 - **entro il 31 Gennaio 2023 ore 13:00** la propria offerta per la fornitura in parola a mezzo pec [furniture@pec.aspag.it](mailto:furniture@pec.aspag.it) .

Unitamente all'offerta economica, si invita a far pervenire la seguente documentazione:

- 1) **LETTERA INVITO/CAPITOLATO SPECIALE**, firmata per accettazione;
- 2) **SCHEDE TECNICHE E DEPLIANTS ILLUSTRATIVI DEL PRODOTTO OFFERTO;**
- 3) Dichiarazione d'impegno a fornire i beni di cui all'oggetto, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro gg. 10 lavorativi dall'ordine di fornitura;
- 4) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
  - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
  - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite pec indicando il relativo indirizzo \_\_\_\_\_;
  - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

10

- d. 1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020;  
ovvero  
2) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di aver provveduto al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;  
ovvero  
3) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di assumere formale impegno al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore al termine previsto del citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. In considerazione della straordinaria situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19, la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni normative emanate in materia virus Covid-19, e a fare riferimento ai documenti ASP "Valutazione Rischio Biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus")" scaricabili dal sito [www.aspag.it](http://www.aspag.it).

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica.

## **B) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, gli Operatori Economici per i quali ricorrono una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

## **C) DETERMINAZIONE DEL PREZZO**

- 1) L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta per giorni 180 dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il prezzo richiesto (IVA ESCLUSA), si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata del contratto.
- 3 ) Il prezzo s'intende comprensivo di ogni onere.
- 4) In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre è ritenuta valida quella più

conveniente per l'Azienda .

5) La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la qualità del bene offerto.

6) Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta di € 1.900,00= + I.V.A...

#### **E) PRESCRIZIONI**

**1) Il criterio di aggiudicazione previsto per ogni singolo lotto è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.**

**2) E' facoltà dell'ASP di Agrigento, a suo insindacabile giudizio:**

**a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;**

**b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;**

**c) di aumentare o diminuire la quantità della fornitura, fermo restando che qualunque variazione della fornitura è subordinata alle reali esigenze dell' Azienda Sanitaria , nel rispetto del limite legale, agli stessi patti e condizioni economiche ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016**

**d) qualora non sussistano offerte per l'intero lotto, di utilizzare le migliori offerte parziali;**

#### **F) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura verrà aggiudicata per ogni singolo lotto con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

La fornitura, distintamente per ogni singolo lotto, verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso/sconto percentuale maggiore rispetto a quello posto a base di gara.

#### **G) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**1) L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'accertamento dei requisiti ai fini della stipula del contratto che avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.**

A tal fine la ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà produrre, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta, dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 /2000, con la quale il contraente si impegna a:

**a) denunciare** all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

**b) rispettare** puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.

**c) comunicare** il numero di Conto bancario o postale "dedicato/i" anche non in via esclusiva al contratto di cui in oggetto, **in cui la stazione appaltante dovrà far confluire tutte le somme relative all'appalto di**

che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonchè le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relativi ai dati trasmessi, giusto art. 3 L.136/2010, art 2 co. 1 L.R. n. 15/2008 e Direttiva prot 847/DRT del 06/08/2013 dell'Assessorato Regionale della Salute;

2) L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ASP di Agrigento.

#### **H) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

- 1) Il contratto sarà stipulato telematicamente secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, Art.32
- 2) Per i contratti di fornitura di beni/attrezzature, la fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dall'ordine.
- 3) **Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia e a quanto prescritto nel capitolato tecnico.**

#### **I) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA FORNITURA**

- 1) Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso di mancato puntale svolgimento, totale o parziale, l' Azienda a suo insindacabile giudizio applicherà a carico del fornitore una penale giornaliera, dell'1 per cento dell'importo aggiudicato.
- 2) Qualora la superiore inadempienza totale o parziale si sia verificata più di una volta, l' Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
- 3) Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo.
- 4) Tutte le pratiche per la regolare e completa osservanza delle leggi, dei regolamenti sanitari e delle disposizioni che disciplinano la vendita della merce oggetto della fornitura dovranno essere esperite dal fornitore, il quale ne risponde in proprio sollevando l' Azienda da qualsiasi responsabilità.
- 5) Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le licenze, le certificazioni, le dichiarazioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti, nonchè le eventuali autorizzazioni (preventive e successive) relative alla fornitura del servizio aggiudicato.
- 6) La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'ASP di Agrigento per quanto riguarda il controllo degli stessi.
- 7) Qualora alle operazioni di collaudo risulti che i prodotti consegnati non corrispondono ai requisiti contrattuali, l'ASP procederà alla contestazione diretta alla Ditta aggiudicataria . In tal caso, è facoltà dell' Azienda Sanitaria di chiedere la sostituzione dei prodotti, entro breve termine fissato a suo insindacabile giudizio, e di applicare, eventuale penale di cui al superiore punto 1.

- 8) La mancata sostituzione del prodotto da parte del fornitore nel termine fissato dall'ASP di Agrigento, l'esito negativo del collaudo, saranno considerati quale "mancata consegna" e l'ASP di Agrigento avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito al presente punto 1.
- 9) Il prodotto non accettato resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarlo senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento dello stesso nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il relativo ritiro.
- 10) Qualora la non corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali sia contestata più di una volta, l'Azienda appaltante ha facoltà di agire ai sensi del precedente punto 1.
- 11) **La regolarità delle operazioni su indicate nonché l'accettazione con presa in carico dei prodotti, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti o, comunque non emersi al momento del controllo.**
- 12) Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; il subappalto della fornitura è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.
- 14) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria l'ASP di Agrigento potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.
- 15) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'A.S.P. di Agrigento senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.
- 16) Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.
- 17) L'A.S.P di Agrigento si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolo, di rinunciare nei seguenti casi:
- In qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
  - In qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art. 159 del Decreto legislativo del 06/09/2011 relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
  - Qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara Regionale o di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.
  - Qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi della L. 488/99 aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.
  - Qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata
  - In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

- Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria.

20) Per quanto non previsto espressamente nella presente richiesta si fa riferimento alle norme contenute nella legge e nel regolamento di contabilità dello Stato e successive modifiche e alle leggi regionali in materia.

#### **L) LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA**

La fatturazione avverrà in relazione alla consegna dei beni ricompresi in ciascun ordinativo di fornitura.

**La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata all'espletamento delle operazioni di controllo/collaudo, con esito positivo.**

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalla vigente normativa **entro 60 gg.** dal ricevimento della fattura.

Eventuali contestazioni interrompono il termine superiormente indicato.

La ditta aggiudicataria non potrà fare valere il "minimo fatturabile".

#### **M) - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.



Per accettazione

**Il Direttore U.O. C. Provveditorato ed Economo**

**Dott. Oreste Falco**

**U.O.C. PROVVEDITORATO**

**Il Dirigente Amministrativo**

**Dr.ssa Rosalia Cela'**

**(timbro e firma della ditta)**



Av. n° 3

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
[maria.tirro@aspag.it](mailto:maria.tirro@aspag.it)  
tel. 0922.407459

Prot. n. 17323 del 30.01.2023

A tutte le ditte interessate

## AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

### FORNITURA DI N. 1 «PACEMAKER IRIS VDD MR CON ELETTROCATETERE».

**Denominazione e recapito della Stazione Appaltante:** Azienda Sanitaria di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento

**Modalità di acquisto:** Procedura negoziata **affidamento diretto ex art. 63, comma 2) lettera b) 2) del D.lgs 50/2016 e smi**, che disciplina le acquisizioni di servizi o forniture forniti da un unico operatore nel caso di concorrenza assente per motivi tecnici – ove comprovata dal presente Avviso di volontaria trasparenza – e previe ulteriori valutazioni. Ovvero, in caso altri operatori economici manifestino di essere in grado di effettuare la fornitura richiesta, si procederà con procedura di gara aperta.

Quest'ASP si riserva l'insindacabile facoltà di procedere a gara aperta anche nel caso in cui il presente avviso non venga riscontrato da altri operatori economici, oltre quello di seguito specificato segnalato dallo specialista richiedente, proprio al fine di ulteriormente consentire la partecipazione agli interessati con prodotti equivalenti ex art. 68 D. Lgs. n. 50/2016.

**Denominazione e recapito dell'operatore economico fornitore/produttore di «PACEMAKER IRIS VDD MR CON ELETTROCATETERE»:** Medico S.p.A..

**Caratteristiche Tecniche:** Pacemaker IRIS VDD mono-catetere MRI compatibile. .

**Motivazione dell'infungibilità:** Pacemaker VDD mono-catetere è l'unico MRI compatibile VDD disponibile sul mercato.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web Aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) ed ha valore di interpello del mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni dichiarate dallo specialista richiedente e, come tali, in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici in grado di effettuare la fornitura con le modalità specificate nel capitolo tecnico allegato. In tal caso, l'operatore economico interessato dovrà far pervenire all'indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le utili informazioni tecniche atte a dimostrare che la "soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche", allegate, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016, e il relativo prezzo di mercato.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico sopra indicato, costituisca l'unico fornitore dei prodotti di che trattasi, questa Azienda potrà, salvo quanto superiormente riportato, valutare di procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 63 co. 2 b) 2) D. Lgs. n. 50/2016. In caso contrario si procederà ad avviare procedura di gara aperta.

Si resta in attesa di riscontro entro giorno 31/01/2023 ore 13.00, all'indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it).

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP di Agrigento.

L'Assistente Amministrativo  
Sig. Alfonso De Leo

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dott. Oreste Falco  
U.O.C. PROVVEDITORATO  
Il Dirigente Amministrativo  
Drs. Rosalia Cela

ОГАНОВАНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Spettabile  
**ASP AGRIGENTO**

### OFFERTA ECONOMICA

**OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UN  
"PACEMAKER IRIS VDD MR CON ELETTROCATETERE"**

Con la presente di seguito i prezzi dei singoli prodotti offerti:

- mod. Iris VDD MR € 1.670,00 (IVA 4% esclusa)
- mod. Phymos 44 MRI € 230,00 (IVA 4% esclusa)

**Prezzo offerto** € 1.900,00 (IVA 4% esclusa)

In fede, distintamente.

Rubano (PD,) lì 31/01/2023

Firmato digitalmente

*DITTA: MEDICO SRL*

*IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
CENTIN SNICHELOTTO EUGENIO*

## DICHIARAZIONI

**OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UN  
"PACEMAKER IRIS VDD MR CON ELETTROCATETERE"**

Con la presente la ditta Medico srl DICHIARA AI SENSI DEL DPR 445/2000:

- L'impegno a fornire i beni di cui all'oggetto, entro gg. 10 lavorativi dall'ordine di fornitura;
- l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite pec indicando il relativo indirizzo medicospa@legalmail.it
- di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020;  
ovvero
- di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di aver provveduto al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;  
ovvero
- di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di assumere formale impegno al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

In fede, distintamente.

Rubano (PD), lì 31/01/2023

Firmato digitalmente  
**DITTA: MEDICO SRL**  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**  
**CENTIN SNICHELOTTO EUGENIO**

**MEDICO SRL - Richiesta offerta per un «PACEMAKER IRIS VDD MR CON ELETTROCATETERE».**

**Da** MEDICO SPA <[medicospa@legalmail.it](mailto:medicospa@legalmail.it)>  
**A** forniture@pec.aspag.it <[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)>  
**Data** martedì 31 gennaio 2023 - 12:35

In data 2023-01-30T15:42:33+0100, [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) <[forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)> ha scritto:

lettera invito scadenza Ore 13:00 del giorno 31 Gennaio. 2023.

Con la presente si invia in allegato documenti richiesti per TRATTATIVA DIRETTA come da oggetto.  
A disposizione, distinti saluti.

=====

MEDICO s.r.l.  
Via Pitagora, 15 - 35030 Rubano (PD) - ITALY  
Tel +39 049.8976755 - Fax +39 049.8976788  
website: [www.medicoweb.com](http://www.medicoweb.com)

=====


In ottemperanza al Reg. Ce 679/16, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.

In compliance with the Reg. CE 679/16, the information contained in this message are strictly confidential and exclusively addressed to the indicated recipient. Please note that any use, reproduction or disclosure of this message is prohibited. In case you received this mail in error, please kindly notify the sender and destroy this message.

DICHIARAZIONI.pdf.p7m  
Lettera invito.pdf.p7m  
OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m  
SCHEDE TECNICHE\_CE\_DEPLIANTS.zip

# Iris VDD MR

## SCHEDA TECNICA

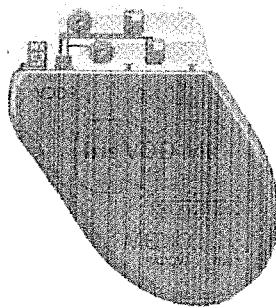

FABBRICANTE : MEDICO S.p.A.  
 Via Pitagora n. 15  
 35030 RUBANO (PD) - ITALY  
 Tel. +39 049 8976755  
 Fax. +39 049 8976788  
 www.medicoweb.com  
 info@medicoweb.com

Modello	Codice	Tipo	Descrizione	Connessione	Identificatore Radiologico
Iris VDD MR	PMIRISVDDM	VDDR	Pacemaker bicamerale Rate Responsive	Bipolare, IS-1	M*C3 MRI

\*= lettera identificativa dell'anno di produzione

### CARATTERISTICHE FISICHE

Modello	Dimensioni (mm) (Altezza x Larghezza x Spessore)	Peso (g)	Volume (cc)	Vita prevista (100% pacing)*
Iris VDD MR	53.4 x 47.1 x 6.6	23.3	10.5	117 mesi

\* Vita prevista alle seguenti condizioni operative VDD, 60 min-1, 2.5V, 0.43 ms, 500 Ohm, sensore OFF.

### PARAMETRI PROGRAMMABILI

Parametri	Range di programmazione	Configurazione alla spedizione
MODO di PACING	ODO↔VDD, VDD, VDI, VDT, VVT, VAT, VVI, VOO, ODO, OVO, OAO, OOO Per tutti i modi di pacing è disponibile la funzione Rate Responsive	VDD
FREQUENZA BASE (min <sup>-1</sup> )	30 ÷ 130, passo 2; 135 ÷ 190, passo 5	60
ISTERESI IN FREQUENZA CON RICERCA (% frequenza corrente)	OFF - 6 - 11 - 20 - 27	OFF
Intervallo di ricerca (cicli)	32 ÷ 4096	256
PACING MAGNETICO	ON / OFF	ON
MODO MAGNETICO	VOO	VOO
AMPIEZZA IMPULSO VENTRICOLARE (V)	0.08 ÷ 0.4 passo 0.08; 0.5 ÷ 2.5 passo 0.1; 2.75 ÷ 6 passo 0.25; 6.5 ÷ 7.5 passo 0.5	2.5
DURATA IMPULSO VENTRICOLARE (ms)	0.06 ÷ 1.89, passo 0.06	0.43

MEDICO S.p.A.

Via Pitagora, 15 - 35030 RUBANO (PD) ITALY

tel. +39 049 8976755 - fax. +39 049 8976788

www.medicoweb.com - info@medicoweb.com



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'Incaricato**

**Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 15 FEB 2023

Agrigento, li 15 FEB 2023

**Il Referente Ufficio atti deliberativi  
Il collaboratore amm.vo  
Sig.ra Sabrina Terrasi**



## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

**Il Referente Ufficio atti deliberativi  
Il collaboratore amm.vo  
Sig.ra Sabrina Terrasi**