



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI N. 1 SISTEMA INTEGRATO DI URODINAMICA, COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO, PER L'UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. AGRIGENTO – RDO n. 3508347

Lotto unico - C.I.G. 9738515CCC

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di giugno, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirò | - Presidente |
| 2) Sig. Biagio De Martino | - Teste |
| 3) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 562 del 24.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI N. 1 SISTEMA INTEGRATO DI URODINAMICA, COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO, PER L'UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. AGRIGENTO –Lotto unico - C.I.G. 9738515CCC**

- che con RDO n. 3508347 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 27.04.2023;

- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);

- che con comunicato del 13.04.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica resi dagli specialisti a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;

- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 27.04.2023, sono pervenute le sottoelencate candidature:

1 ADS MED DI ALESSANDRA DE SANTIS

2 HC ITALIA SRL

3 COMPUMED EUROPE SRL

4 MEDICA S.P.A.

Che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 è stato dato della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle società partecipanti e dell'ammissione delle stesse alla successiva fase di valutazione tecnica delle offerte tecniche di gara;

che con prot. 69801 del 5.5.2023 le offerte tecniche sono state trasmesse allo specialista per la relativa valutazione di competenza;

che lo specialista in parola ha trasmesso proprio verbale di valutazione tecnica ex prot. 86751 del 6.6.2023.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Prende atto del contenuto della valutazione tecnica prot. 86751 del 6.6.2023 di cui da pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, gli esiti:

ADS MED DI ALESSANDRA DE SANTIS – non conforme

HC ITALIA SRL – non conforme

COMPUMED EUROPE SRL – conforme

MEDICA S.P.A. – non conforme

E rinviando per le motivazioni di non conformità al verbale tecnico allegato.

Esclude dal prosieguo di gara per la non conseguita conformità tecnica le società ADS MED DI ALESSANDRA DE SANTIS, HC ITALIA SRL e MEDICA S.P.A.

Ammette alla successiva fase di gara la società COMPUMED EUROPE SRL che ha conseguito giudizio tecnico di conformità.

Dispone la notifica agli esclusi ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.


Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL TESTE

IL TESTE

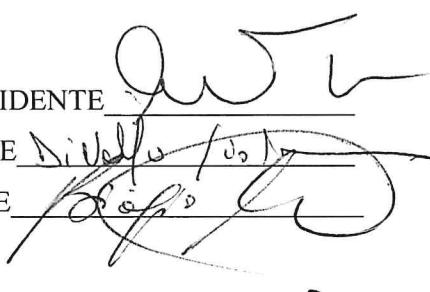

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO – AGRIGENTO
U.O.C. OSTETRICIA e GINECOLOGIA
Direttore Dr.ssa M.R. Falco Abramo



Prot. N. 86751 del 6/06/2023

Al Direttore U.O.C Provveditorato
Dott. O. Falco

Oggetto: valutazione schede tecniche RDO n.3508347 per la fornitura di n. 1 sistema integrato di urodinamica, comprensivo del materiale di consumo, per l'U.O.C P.O. Agrigento.

Dall'analisi delle schede tecniche fornite dagli O.E., in sede di gara telematica in oggetto, si descrive di seguito le risultanze derivanti dal confronto di quanto offerto e quanto richiesto dal capitolato di gara:

Ditta ADS: il lettino ha una seduta fissa ed un solo motore per regolazione altezza con seduta a 60 cm dal suolo e quindi molto alta e non idoneo a gestione pazienti disabili (pag. 19 della relazione tecnica). Si ritiene, pertanto **non conforme** (in particolare sembra un normale lettino ginecologico non specifico per urodinamica)

Ditta HC: il lettino risulta molto alto, con una seduta a 56 cm di altezza dal suolo non idoneo a gestione pazienti disabili (pagina 1 della relazione tecnica Poltrona Ginecologica FG-04). Inoltre il sistema di urodinamica non dispone di modulo EMG senza fili come richiesto da capitolato (vedere pagina 2 della relazione tecnica MAESTRO). Pertanto si ritiene **non conforme**.

Ditta MEDICA: il lettino ha una portata massima di 170 kg non conforme alle richieste in capitolato (200 Kg), inoltre ha una seduta a 66 cm di altezza dal suolo quindi non idoneo a gestione pazienti disabili (pagina 5 della relazione tecnica completa). Inoltre il sistema di urodinamica non è di tipo con comunicazione senza fili e comunque non dispone di modulo EMG senza fili come richiesto da capitolato (vedere pagina 2 della relazione tecnica completa). Pertanto si ritiene **non conforme**.

Ditta COMPUMED: prodotto offerto aderente al capitolato. Pertanto si ritiene **conforme**.

Agrigento 05/06/2023

AS SANITARIO PROVINCIALE AGRIGENTO
PRES. OSP S GIOVANNI DI DIO, AGRIGENTO
U.O.C OSTETRICIA e GINECOLOGIA
DR MARIARITA FALCOABRAMO AG3587
CODICE FISCALE FLGMR77R49H1480
CODICE EMPAN: 3002101177

