



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 880 DEL 24 APR 2025

OGGETTO: Fornitura in somministrazione, di durata annuale, in 58 lotti di carta per apparecchiature elettromedicali. Approvazione verbali di gara e operazioni di gara telematica RDO ME.PA. n. 4644600, autorizzazione aggiudicazione fornitura agli operatori economici Biodiagram S.r.l. e Ceracarta S.p.A...

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Provveditorato

PROPOSTA N. 933 DEL 23.04.2025

Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Cristina Bellavia

Il Dirigente Amministrativo UOS
Acquisizione Beni e servizi non sanitari
Dott. Rosalia Calà

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Alessandro Diolfo

Il RUP/ L'Assistente Amministrativo
Dott. Alfonso De Leo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

P. N. 128997/2024 Imcentri

() Autorizzazione n. del

C.E.

C.P.

0501010908

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ADDETTO RESPONSABILE
Cust. Amm. CIRIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PAGAMENTI

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

24 APR 2025

L'anno duemila ventiquattr'è il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TELESACINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, Dr.ssa Cinzia Schinelli

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/2020.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione DG n. 508 del 20/09/2024 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, a mezzo RDO/ME.PA., per l'affidamento della fornitura in somministrazione annuale, in 61 lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA..
- con la suindicata Delibera sono stati approvati i documenti denominati "Condizioni particolari di contratto" – All. 1 -, "Capitolato tecnico" – All. 2 - e "Schema di offerta economica" – All. 3 -.
- con successiva delibera DG n. 546 del 26/06/2024 sono stati modificati e approvati i nuovi documenti di gara "capitolato tecnico", "schema di offerta" e "Condizioni particolari di contratto", riducendo nello stesso tempo i lotti previsti in gara in 58 (cinquantotto) lotti anziché 61 (sessantuno), per come indicato dalla Dirigente Farmacista del P.O. di Licata con nota prot. n. 144916/2024, che ha unificato il lotto n. 10 con il lotto 17, il lotto 13 con il lotto 14 e il lotto 24 con il lotto n. 28.

DATO ATTO che:

- l'U.O.C. proponente in data 30.09.2024 ha proceduto, ai sensi della normativa sopra citata, alla pubblicazione della RDO ME.PA. n. 4644600 aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "33190000-8" - descrizione CPV: "Dispositivi e prodotti medici vari" - categorie di abilitazione: "Altri dispositivi medici".
- sono stati generati tramite il portale www.acquistinretepa.it i codici CIG della procedura.

CONSIDERATO CHE:

- entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 20/10/2024, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
1	BODIAGRAM S.R.L.	Singolo economico	operatore 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58.
2	CERACARTA S.p.A.	Singolo economico	operatore 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58.
3	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C.	Singolo economico	operatore 7 – 58.
4	BIOTECNICA CATALANO LEA & C	DI Singolo economico	operatore 57.

- con il verbale di gara n. 1 del 28.10.2024, n. 2 del 07.02.2025, n. 3 del 19.03.2025 e n. 4 del 22.04.2025 i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente atto, sono state compiute le attività ivi indicate ed, in particolare, preso atto del giudizio di conformità reso dall'organo tecnico di supporto al RUP, – giusta nomina del Direttore Generale prot. n. 165421 del 29.10.2024 -, con verbali della seduta privata del 4 e 5 dicembre 2024 -, si è proceduto in particolare nella seduta del 19.03.2025 all'apertura telematica delle buste economiche relative agli operatori economici che sono risultati conformi e ammessi al prosieguo di gara, come di seguito riportati:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	€ 52,80	€ 52,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	€ 405,00	NON CONFORME	
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO		DITTA BIODIAGRAM S.r.l.	
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE		€ 168,00	
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO		BIODIAGRAM S.r.l.	
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE		€ 150,00	
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	€ 51,00	€ 49,20	
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	€ 1.205,60	
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C.
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE	€ 22.400,00	€ 21.800,00	€ 30.000,00

		RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO			
--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	€ 282,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	€ 2.354,40	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	€ 765,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	€ 378,00	€ 357,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI	MARCA MODELLO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
-------	-------------------------	---------------	-------------------	------------------

	MINIMI	APPARECCHIO		
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	€ 2.760,00	€ 2.970,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	€ 3.042,00	€ 2.574,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	€ 54,00	€ 55,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	€ 126,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	€ 1.368,00	€ 1.386,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	€ 192,00	€ 207,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.771,20	€ 1.911,60

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETTROCARDIOGRAFO		€ 149,98

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETTROCARDIOGRAFO	€ 114,00	€ 117,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.

21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETTROCARDIOGRAFO	€ 15.168,00	€ 15.262,80
----	---	--	-------------	-------------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETTROCARDIOGRAFO	€ 11.475,00	€ 12.410,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO	€ 192,00	€ 234,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 216,00	€ 264,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	€ 108,00	€ 116,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.170,00	€ 1.155,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.200,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	€ 7.488,00	€ 9.079,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	€ 300,00	€ 322,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.173,00	€ 1.234,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 90,00	
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 54,00	€ 57,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 783,00	NON CONFORME
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 9.465,90	€ 9.549,30
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 9.450,00	€ 10.260,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 10.854,00	€ 11.738,40
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	€ 1.405,00	
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	€ 288,00	NON CONFORME
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	€ 12.420,00	€ 11.610,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	
40	Rotoli bianchi di carta termica	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S		

	75mm x 50m	APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 210,00
--	------------	---	----------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	€ 79,20	€ 79,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	€ 300,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 599,90

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 201,60	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	€ 78,00	€ 73,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	€ 600,00	€ 588,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 150,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	€ 2.592,00	€ 2.688,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	€ 29,98	€ 28,80

LOTTO	DESCRIZIONE E	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
-------	---------------	---------------------------	-------------------	------------------

	REQUISITI MINIMI				
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m		MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	€ 486,00	NON CONFORME
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	€ 85,80		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	€ 84,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 59,98	€ 57,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 450,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	€ 119,98

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	€ 299,98	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 53.200,00	€ 54.350,00	ESCLUSA
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	DITTA TIOZZO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	mitsubishi electric CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 2.850,00	€ 1.980,00	NON CONFORME

ATTESO CHE:

- la U.O.C. Provveditorato ha chiesto, - su invito del seggio di gara - con nota prot. n. 53619 del 28.03.2025, agli operatori economici Bodiagram S.r.l. e Ceracarta S.p.A. offerta migliorativa per il Lotto n. 1 e Lotto n. 41, essendo che gli stessi hanno presentato offerta alla pari.
- il seggio di gara, ha preso atto che gli operatori economici Caracarta S.p.A. e Bodiagram S.r.l., con comunicazioni pervenute a mezzo ME.PA. rispettivamente in data 28.03.2025 e 31.03.2025, hanno presentato offerta migliorativa per il Lotto n. 1 e Lotto n. 41 per come segue:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	€ 50,40	€ 50,88

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H IP E TS SO AUTOCLAVE	€ 75,60	€ 76,32

ATTESO, altresì, che nella seduta di gara giusta verbale n. 4 del 22.04.2025 – preso atto del giudizio finale di conformità o meno reso dall'organo tecnico di supporto al RUP con verbale della seduta privata del 4 marzo 2025, il seggio di gara ha proceduto all'aggiudicazione della RDO ME.PA. n. 4644600 per la fornitura in somministrazione, annuale, in 58 lotti di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo pari ad € 180.752,84, così suddiviso per i singoli Lotti:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	120 rotoli	€ 0,42	€ 50,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	450 rotoli	€ 0,90	€ 405,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	DITTA BODIAGRAM S.r.l.
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	300 rotoli	€ 0,56	€ 168,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	300 rotoli	€ 0,50	€ 150,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	60 rotoli	€ 0,82	€ 49,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	2.740 rotoli	€ 0,44	€ 1.205,60

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	4.000 rotoli	€ 5,45	€ 21.800,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	300 rotoli	€ 0,94	€ 282,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	6.540 rotoli	€ 0,36	€ 2.354,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	1.500 rotoli	€ 0,51	€ 765,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	300 risme	€ 1,19	€ 357,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	6.000 risme	€ 0,46	€ 2.760,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	5.850 rotoli	€ 0,44	€ 2.574,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	90 risme	€ 0,60	€ 54,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	180 risme	€ 0,70	€ 126,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	1.800 rotoli	€ 0,76	€ 1.368,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	300 risme	€ 0,64	€ 192,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	1.080 risme	€ 1,64	€ 1.771,20
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	150 risme	€ 0,99986	€ 149,98
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.

20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	150 rotoli	€ 0,76	€ 114,00
----	---	------------	--------	----------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	4.740 risme	€ 3,20	€ 15.168,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	4.250 risme	€ 2,70	€ 11.475,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	300 rotoli	€ 0,64	€ 192,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	60 risme	€ 3,60	€ 216,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	120 risme	€ 0,90	€ 108,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	1.500 risme	€ 0,77	€ 1.155,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	1.200 risme	€ 1,00	€ 1.200,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	2.340 risme	€ 3,20	€ 7.488,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	150 rotoli	€ 2,00	€ 300,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BIODIAGRAM S.r.l.
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4	510 risme	€ 2,30	€ 1.173,00

	210X295mm, 100 fogli			
--	----------------------	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	150 rotoli	€ 0,60	€ 90,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	60 rotoli	€ 0,90	€ 54,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	450 rotoli	€ 1,74	€ 783,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	2.085 risme	€ 4,54	€ 9.465,90

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	4.500 risme	€ 2,10	€ 9.450,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	4.020 risme	€ 2,70	€ 10.854,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	1.350 rotoli	€ 1,04075	€ 1.405,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	360 risme	€ 0,80	€ 288,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	5.400 risme	€ 2,15	€ 11.610,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	150 rotoli	€ 1,40	€ 210,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.

41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	180 rotoli	€ 0,42	€ 75,60

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	600 rotoli	€ 0,50	€ 300,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	1.500 rotoli	€ 0,39993	€ 599,90

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	480 rotoli	€ 0,42	€ 201,60

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	150 rotoli	€ 0,49	€ 73,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	1.200 rotoli	€ 0,49	€ 588,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	300 rotoli	€ 0,50	€ 150,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	480 risme	€ 5,40	€ 2.592,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	60 rotoli	€ 0,48	€ 28,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	900 rotoli	€ 0,54	€ 486,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	DITTA BODIAGRAM
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	165 rotoli	€ 0,52	€ 85,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	150 rotoli	€ 0,56	€ 84,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	60 rotoli	€ 0,95	€ 57,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	750 rotoli	€ 0,60	€ 450,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	300 rotoli	€ 0,39993	€ 119,98

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	750 rotoli	€ 0,39997	€ 299,98

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	BODIAGRAM S.r.l.
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	700 risme	€ 76,00	€ 53.200,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	FABBISOGNO ANNUO	IMPORTO UNITARIO	CERACARTA S.p.A.
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	300 rotoli	€ 6,60	€ 1.980,00

ATTESO che i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari, ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs.vo 36/2023, sono stati avviati e conclusi con esito positivo tramite procedura telematica FVOE 2.0.

RITENUTO, pertanto, opportuno con il presente atto aggiudicare la fornitura della carta per apparecchiature elettromedicali così come riportato nelle tabelle sopra riportate:

- alla **Bodiagram S.r.l.** con sede legale in Via Bruno Buozzi, 1, San Sebastiano al Vesuvio (NA) - 80040, Partita I.V.A./Codice fiscale 03526561216, i lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 54 – 55 – 56 – 57 -, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 138.509,74= + I.V.A..
- alla **Ceracarta S.p.A.** con sede legale in Via Secondo Casadei, 14, Forlì – 47122, Partita I.V.A./Codice fiscale 00136740404, i lotti nn. 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 13 – 26 – 39 – 45 – 46 – 49 – 53 – 58 -, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 42.243,10= + I.V.A..

RITENUTO, altresì, necessario nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista del P.O. di Licata, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 36/2023 e dell'art. 32 comma 4 allegato II.14 del D. L.vo 36/2023, in quanto le prestazioni del presente appalto richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ed inoltre la fornitura della carta per apparecchiature elettromedicali, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

DATO ATTO CHE:

- l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, sarà garantita nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023;
- l'onere derivante dal presente atto, ammonta ad € 180.752,84=IVA e competenze interne escluse, da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura	€ 180.752,84
IVA aliquota 22%	€ 39.765,62
Competenze interne 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.373,77
TOTALE	€ 224.892,93

DATO ATTO, altresì, che la somma nascente dal presente atto deve essere imputata per come segue:

- ✓ rimodulare la prima nota n. 128997/2024 - giusta delibera D.G. n. 508 del 20.09.2024 per un importo pari ad € 4.373,77 conto economico C516040605 e conto P202050601.
- ✓ € 220.518,46= I.V.A. inclusa suddivisa in € 147.012,31 conto economico C501010508 esercizio 2025, mentre per la rimanente somma pari ad € 73.506,15 conto economico C501010508 esercizio 2026.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **APPROVARE** i verbali di gara n. 1 del 28.10.2024, n. 2 del 07.02.2025, n. 3 del 19.03.2025 e n. 4 del 22.04.2025 i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente atto, nonché i verbali resi dell'Organo Tecnico di supporto al RUP inerenti le sedute private del 4 e 5 dicembre 2024 e del 4 marzo 2025 – **All. n. 1** –.
2. **APPROVARE**, altresì, le operazioni della gara telematica RDO ME.PA. n. 4644600 aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: “33190000-8” - descrizione CPV: “Dispositivi e prodotti medici vari” - categorie di abilitazione: “Altri dispositivi medici”.
3. **AGGIUDICARE** la fornitura della carta per apparecchiature elettromedicali così come riportato nelle tabelle in premessa:
 - alla **Biodiagram S.r.l.** con sede legale in Via Bruno Buozzi, 1, San Sebastiano al Vesuvio (NA) - 80040, Partita I.V.A./Codice fiscale 03526561216, i lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 54 – 55 – 56 – 57 -, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 138.509,74= + I.V.A..
 - alla **Ceracarta S.p.A.** con sede legale in Via Secondo Casadei, 14, Forlì – 47122, Partita I.V.A./Codice fiscale 00136740404, i lotti nn. 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 13 – 26 – 39 – 45 – 46 – 49 – 53 – 58 -, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 42.243,10= + I.V.A..
4. **INDIVIDUARE E NOMINARE** Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista del P.O. di Licata, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 36/2023, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.vo 36/2023 e dell'art. 32 comma 4 allegato II.14 del D. L.vo 36/2023, in quanto le prestazioni del presente appalto richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ed inoltre la fornitura della carta per apparecchiature elettromedicali, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
5. **DARE ATTO CHE** l'onere derivante dal presente atto, ammonta ad € 180.752,84=IVA e competenze interne escluse, da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura	€ 180.752,84
IVA aliquota 22%	€ 39.765,62
Competenze interne 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.373,77
TOTALE	€ 224.892,93

6. **DARE ATTO**, altresì, che la somma nascente dal presente atto deve essere imputata per come segue:

- ✓ rimodulare la prima nota n. 128997/2024 - giusta delibera D.G. n. 508 del 20.09.2024 per un importo pari ad € 4.373,77 conto economico C516040605 e conto P202050601.

- ✓ € 220.518,46 = I.V.A. inclusa suddivisa in € 147.012,31 conto economico C501010508 esercizio 2025, mentre per la rimanente somma pari ad € 73.506,15 conto economico C501010508 esercizio 2026.
7. **AUTORIZZARE**, il Servizio proponente alla stipula del contratto telematico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 e comma 3 lett.) del D. Lgs.vo 36/2023, atteso che i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari, ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs.vo 36/2023, sono stati avviati e conclusi con esito positivo tramite procedura telematica FVOE 2.0.
 8. **DARE ATTO**, altresì, che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse;
 9. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'immediata attivazione della fornitura di cui al presente provvedimento.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

Ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favolabile
Data 24/04/2025

Parere Favolabile
Data 24/04/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ersilia Riggio


Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia


IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

IL DIRETTORE GENERALE


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci

Il Segretario verbalizzante

Le collazioni sono state fatte in base alle indicazioni dei responsabili delle singole gestioni.
Riferimenti: Presidente Consiglio, Consigliere, Consigliere.



ALL. 1

Verbale n. 1

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 4644600 – per la fornitura in somministrazione annuale, in 58 lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.


VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di Ottobre in Agrigento, alle ore 10,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr.ssa Rosalia Calà – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.S. Economato e Acquisizione di beni e servizi non sanitari;
- Rag. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento
- Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig.ra Daniela Parla – Testimone – Assistente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento; i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per dare atto della verifica della documentazione amministrativa tramite apertura delle buste contenente la predetta documentazione degli operatori economici partecipanti alla RDO ME.PA. aperta n. 4644600, per l'affidamento della fornitura in cinquantotto lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

PREMESSO CHE

- con deliberazione DG n. 508 del 20/09/2024 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, a mezzo RDO/ME.PA., per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 218.688,57= +IVA 22%, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- con la suindicata Delibera sono stati approvati i documenti denominati denominati “Condizioni particolari di contratto” – All. 1 -, “Capitolato tecnico” – All. 2 - e “Schema di offerta economica” – All. 3 -.
- con successiva delibera DG n. 546 del 26/06/2024 sono stati modificati e approvati i nuovi documenti “capitolato tecnico”, “schema di offerta” e “Condizioni particolari di contratto”, riducendo nello stesso tempo i lotti previsti in gara in 58 (cinquantotto) lotti anziché 61 (sessantuno), per come indicato dalla Dirigente Farmacista del P.O. di Licata con nota prot. n. 144916/2024, che ha unificato il lotto n. 10 con il lotto 17, il lotto 13 con il lotto 14 e il lotto 24 con il lotto n. 28.
- la presente gara si articola in cinquantotto lotti.

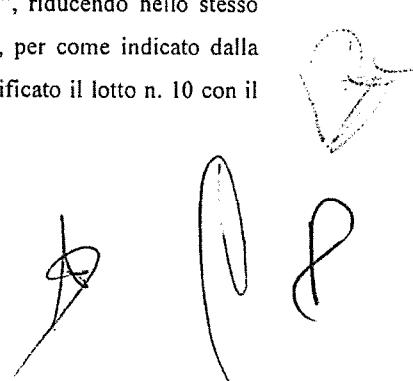

- in data 30.09.2024 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 4644600 aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "33190000-8" - descrizione CPV: "Dispositivi e prodotti medici vari" - categorie di abilitazione: "Altri dispositivi medici".
- il termine di scadenza è stato fissato per le ore 11:00 del 20/10/2024, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI ESPONE QUANTO SEGUE

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Rag. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso il sistema ME.PA.

Il Presidente dà atto che tramite piattaforma telematica sono pervenuti i plichi inviati, sempre tramite sistema, dai seguenti operatori economici:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
1	BIODIAGRAM S.R.L.	Singolo operatore economico	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58.
2	CERACARTA S.p.A.	Singolo operatore economico	1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58.
3	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C.	Singolo operatore economico	7 – 58.
4	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C	Singolo operatore economico	57.

Il Presidente, preliminarmente, comunica che in data 25.10.2024 e 28.10.2024 si è proceduto all'apertura telematica delle buste amministrative con conseguente download dei file in esse contenute, mentre in data odierna si procede alla verifica della documentazione amministrativa.

Premesso quanto sopra, si riscontra quanto segue:

#	Denominazione concorrente	AMMISSIONE
1	BIODIAGRAM S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA (limitatamente al Lotto n. 15)
2	CERACARTA S.p.A.	AMMESSA
3	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C.	AMMESSA
4	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C	AMMESSA
1)	BIODIAGRAM S.R.L.:	La documentazione amministrativa, contenuta nella relativa area di sistema, è presente, ma viene attivato, ai sensi dell'art. 101 del D. L.vo 36/2023, soccorso istruttorio in quanto l'operatore economico per il Lotto n. 15, ha inserito nella relativa riga la dichiarazione sostitutiva di partecipazione del Lotto n. 14 anziché quella del lotto di riferimento, si specifica che l'ammissione

con riserva è limitata solamente al Lotto n. 15, mentre viene ammesso per tutti i lotti a cui ha partecipato.

Il Presidente di gara vista l'urgenza dell'approvvigionamento della fornitura di che trattasi, da mandato al segretario verbalizzante di procedere all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica degli operatori economici partecipanti, omnicomprensiva della busta tecnica di cui al Lotto n. 15 presentata dall'operatore economico Biodiagram S.r.l. ammesso con riserva.

La seduta di gara è sospesa in attesa che la Direzione Strategica di questa ASP individui l'organo tecnico di supporto al RUP, che svolgerà la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti ed ammesse alla gara in oggetto.

Il seggio di gara con successiva seduta di gara procederà allo scioglimento della riserva per l'ammissione o meno dell'operatore economico Biodiagram S.r.l., limitatamente al Lotto n. 15..

Il presente verbale, che consta di tre pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 13,10 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dr.ssa Rosalia Calà Rosalba Presidente
- Rag. Alfonso De Leo Alfonso De Leo Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Cristina Bellavia Cristina Bellavia
- Sig.ra Daniela Parla Daniela Parla

Verbale n. 2

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 4644600 – per la fornitura in somministrazione annuale, in 58 lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventicinque il giorno 7 del mese di Febbraio in Agrigento, alle ore 9,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i Sigg.:

- **Dott. Rosalia Calà** – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato;
- **Dott. Alfonso De Leo** – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento
- **Sig.ra Cristina Bellavia** – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- **Sig.ra Daniela Parla** – Testimone – Assistente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento; i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per dare lettura dei verbali trasmessi dall'organo tecnico di supporto al RUP, nominato con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 165421 del 29.10.2024, per l'affidamento della fornitura in cinquantotto lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

PREMESSO CHE

- con deliberazione DG n. 508 del 20/09/2024 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, a mezzo RDO/ME.PA., per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 218.688,57= +IVA 22%, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- con la suindicata Delibera sono stati approvati i documenti denominati denominati “Condizioni particolari di contratto” – All. 1 -, “Capitolato tecnico” – All. 2 - e “Schema di offerta economica” – All. 3 -.
- con successiva delibera DG n. 546 del 26/06/2024 sono stati modificati e approvati i nuovi documenti “capitolato tecnico”, “schema di offerta” e “Condizioni particolari di contratto”, riducendo nello stesso tempo i lotti previsti in gara in 58 (cinquantotto) lotti anziché 61 (sessantuno), per come indicato dalla Dirigente Farmacista del P.O. di Licata con nota prot. n. 144916/2024, che ha unificato il lotto n. 10 con il lotto 17, il lotto 13 con il lotto 14 e il lotto 24 con il lotto n. 28.
- la presente gara si articola in cinquantotto lotti.
- in data 30.09.2024 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 4644600 aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativa CPV: “33190000-8” - descrizione CPV: “Dispositivi e prodotti medici vari” - categorie di abilitazione: “Altri dispositivi medici”.
- che entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 20/10/2024, quale termine ultimo per la presentazione

1

D
S
P
B

delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
1	BIODIAGRAM S.R.L.	Singolo operatore economico	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58.
2	CERACARTA S.p.A.	Singolo operatore economico	1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58.
3	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C.	Singolo operatore economico	7 – 58.
4	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C	Singolo operatore economico	57.

Con verbale del 28 Ottobre del 2024 il seggio di gara ha svolto i seguenti lavori:

- esaminato la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti.
- ammesso alla fase successiva l'operatore economico CERACARTA S.p.A., TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C e BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C e ammesso con riserva limitatamente per il Lotto n. 15 l'operatore economico BIODIAGRAM S.R.L. per le motivazioni ivi riportati nel sopra citato verbale.
- proceduto all'apertura delle buste tecniche degli operatori partecipanti compreso l'operatore cui è stato attivato soccorso istruttorio.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Dott. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Il seggio di gara ammette alla fase successiva l'operatore economico BIODIAGRAM S.R.L., cui è stato attivato soccorso istruttorio, avendo il medesimo operatore economico sanato la carenza documentale riportata analiticamente nel verbale n. 1 del 28 ottobre 2024.

Il presidente di gara da mandato, al Segretario Verbalizzante di leggere il verbale del 4 dicembre e del 5 dicembre 2024 resi dall'organo tecnico di supporto al RUP e ricevuti a mezzo email in data 6 dicembre, dove si riportano le conformità e/o non conformità nella tabella sottostante:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	OK	OK		

The table is signed by several individuals with handwritten initials and names, including 'S', '2', 'D', 'P', and 'B'.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE				

In merito al Lotto 6 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP	OK	OK	OK	



		UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON SB ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO				
--	--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO



D
P
P
B

9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	OK	NON CONFORME		
---	---	--	----	--------------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	OK	OK		



	riferimento alla plena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura					
--	---	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETROCARDIOGRAFO	OK			

6

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI MISURE	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA

7

8

9

PZ

						CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOPIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI			

8

8 6

A

B

	(colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli			CHIARIMENTI		
--	---	--	--	-------------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 Elettrocardiografo	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 Elettrocardiografo	CHIARIMENTI	OK		


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 Elettrocardiografo	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 Elettrocardiografo	OK	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 Elettrocardiografo	OK	OK		

9

Bl

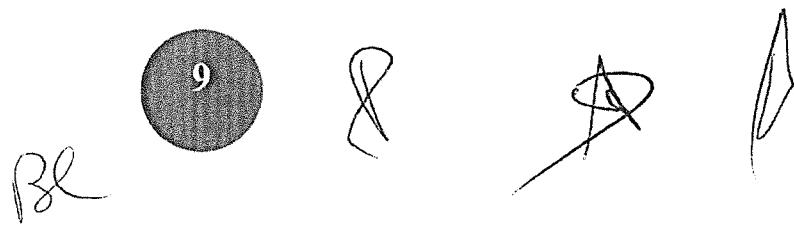

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE				

In merito al Lotto 46 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA

11

8

D

M

Be

						CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	OK	NON CONFORME		


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK		OK


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP6SHM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK	NON CONFORME	

Le motivazioni della non conformità tecnica delle offerte non conformi sono riportate analiticamente nel verbale del 4 dicembre e del 5 dicembre 2024 reso dall'Organo tecnico di supporto al RUP, che si allegano al presente verbale.

Il presente verbale, che consta di ventiquattro pagine e trentatré facciate, viene letto e sottoscritto alle ore 12,00 per come segue:


IL SEGGIO DI GARA


- Dr.ssa Rosalia Calà  Presidente

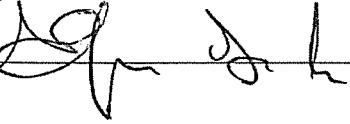- Dott. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Cristina Bellavia 

- Sig.ra Daniela Parla 

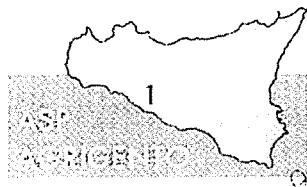

*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*

**Organo Tecnico di supporto al Rup
Gara Fornitura Carta per Apparecchiature Elettromedicali**

Il giorno 04 Dicembre 2024, alle ore 10.30 presso i locali della Direzione del Dipartimento del Farmaco si insedia l'Organo Tecnico di Supporto al RUP per la "Fornitura in Somministrazione annuale in 58 lotti unici e indivisibili, di Carta per Apparecchiature Elettromedicali", Giusta Nota di Nomina dei componenti prot. n. 165421 del 29/10/2024, Giusta Nota di Nomina del Segretario Verbalizzante, prot. N. 185284 del 03/12/2024, nonché Giusta Convocazione prot. n. 185296 del 03/12/2024 che si allegano.

Sono presenti la Dott.ssa Valentina Impellizzeri in qualità di Presidente, le Dott.sse Roberta Ragusa e Elisa Drago in qualità di Componenti.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante l'Ass.nte Amministrativo Dott. Gianluca Ciotta.

Il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente i componenti prendono atto della documentazione fatta pervenire a questo Organo dal Settore Provveditorato con mail del 20/11/2024 e si passa all'esame della stessa.

Dopo aver visionato il Capitolato definitivo si comincia ad esaminare ciascun lotto.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda la lunghezza 25-23 mt, delle quali la misura 25 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 23 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

G.P. - G.P.

C50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica relativa all'articolo con cod. Ref. RDNNR080020000 è prodotta sia per lotto 3 (16 mt) che per il lotto 23 (20 mt). Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta le motivazioni che li ha indotti ad utilizzare lo stesso cod. Ref. per due lotti diversi ed eventualmente come distinguerà in sede di ordine le due misure.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 58-57 mm, delle quali la misura 58 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 57 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE				

In merito al Lotto 6 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO	
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9x9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO	OK	OK	OK		

The image shows four handwritten signatures in black ink, likely belonging to the authorized representatives of the companies mentioned in the table. The signatures are located at the bottom right of the document.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 107-108 mm, delle quali la misura 107 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 108 mm contemporaneamente riportato sulla scheda; per quanto riguarda la lunghezza 23-25 mt, delle quali la misura 25 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 23 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.


CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	OK		

BIODIAGRAM: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede carta termica bianca e la Ditta offre carta diagrammata come da scheda tecnica.

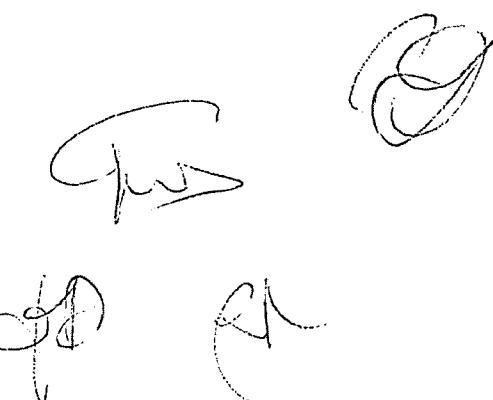

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 200-300, dei quali il numero di fogli 200 è conforme al Capitolato, contrariamente al 300 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

BIODIAGRAM – CERACARTA: Le relative schede tecniche prodotte non riportano la presenza della tacca nera così come prevista dal Capitolato Tecnico. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alle Ditte l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	OK	OK		

Handwritten signatures and initials in blue ink, likely belonging to the responsible parties or witnesses, are placed below the tables. The signatures include stylized initials such as 'G.P.', 'R.W.', and 'R.C.'.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	OK	OK		


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 300-315, dei quali il numero di fogli 300 è conforme al Capitolato, contrariamente al 315 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.


CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero di fogli in quanto da Capitolato Tecnico si chiedono 300 fogli e la Ditta offre 315 fogli come da scheda tecnica.

Vista l'ora tarda i componenti la Commissione sospendono la seduta alle ore 13.30 del giorno 04/12/2024 e concordano di riprendere i lavori alle ore 09.30 del giorno 05/12/2024.
Agrigento, 04/12/2024


Il Segretario Verbalizzante
Ass.nte Amministrativo
Dott. Gianluca Ciotta

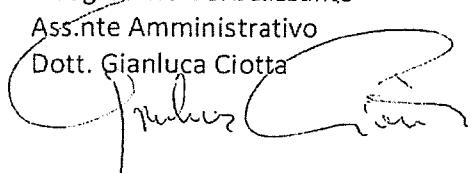


La Commissione
Dir. Farmaciste
Dott.ssa Roberta Ragusa
Dott.ssa Elisa Drago



Il Presidente
Dir. Farmacista
Dott.ssa Valentina Impellizzeri

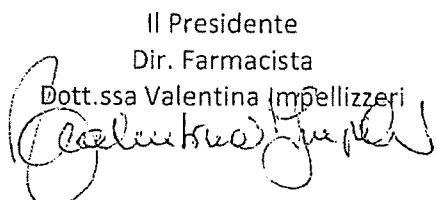



trasmissione verbali gara fornitura carta per apparecchiature elettromedicali

Da PO Licata - Distribuzione Farmaci <policata.distribuzionefarmaci@ASPAG.IT>

Data ven 06/12/2024 09:25

A Alfonso De Leo <alfonso.deleo@aspag.it>

Cc Valentina Impellizzeri <v.impellizzeri@aspag.it>; Roberta Ragusa <roberta.ragusa@aspag.it>; Elisa Drago <elisa.drago@aspag.it>

📎 1 allegato (3 MB)

doc04457920241206091357.pdf;

In uno alla presente, si invia copia del verbale 1 del 04/12/2024 per gli opportuni adempimenti.
D'ordine dell'Organo Tecnico di Valutazione.

Dott. Gianluca Ciotta

UOS FARMACIA PO LICATA PO LICATA, ASP AG

RESPONSABILE:

DR. CHRISTIAN INTORRE -----0922869113

DIRIGENTI FARMACISTI

DR.SSA VALENTINA IMPELLIZZERI -----0922869552

DR.SSA FABIOLA VIZZINI -----0922869551

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita informativa. Il presente messaggio, corredata da eventuali allegati, contiene informazioni di natura riservata ed è da considerarsi ad utilizzo esclusivo del destinatario. Qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione, conservazione, copia, stampa o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso ad opera di soggetti diversi dal destinatario è strettamente vietata. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di avvisare tempestivamente il mittente e di provvedere alla relativa cancellazione unitamente ai contenuti allo stesso allegati.





*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*

**Organo Tecnico di supporto al Rup
Gara Fornitura Carta per Apparecchiature Elettromedicali**

Il giorno 05 Dicembre 2024, alle ore 09.30 presso i locali della Direzione del Dipartimento del Farmaco si insedia, come previsto dal Verbale n. 1 della presente gara redatto in data 04 Dicembre 2024, l'Organo Tecnico di Supporto al RUP per la "Fornitura in Somministrazione annuale in 58 lotti unici e indivisibili, di Carta per Apparecchiature Elettromedicali", Giusta Nota di Nomina dei componenti prot. n. 165421 del 29/10/2024, Giusta Nota di Nomina del Segretario Verbalizzante, prot. n. 185284 del 03/12/2024, nonché Giusta Convocazione prot. n. 185296 del 03/12/2024 che si allegano.

Sono presenti la Dott.ssa Valentina Impellizzeri in qualità di Presidente, le Dott.sse Roberta Ragusa e Elisa Drago in qualità di Componenti.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante l'Ass.nte Amministrativo Dott. Gianluca Ciotta.

Il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

I componenti la Commissione proseguono le operazioni d'esame del Capitolato a partire dal Lotto n. 16.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda la lunghezza 25-20 mt, delle quali la misura 25 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 20 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Inoltre si chiedono chiarimenti in merito al colore del diagramma in quanto su scheda tecnica è riportato "Diagramma (colore) Rosso/ o Bianco", mentre come da Capitolato si chiede "Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto)".

Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

GP
CPA
RS
SG

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 142-143, dei quali il numero di fogli 142 è conforme al Capitolato, contrariamente al 143 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETTROCARDIOGRAFO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

The image shows four handwritten signatures in black ink, each consisting of a stylized initial followed by a surname. The signatures are positioned directly above their respective table rows, corresponding to Lots 17, 18, 19, and 20. The first signature is on the left, the second is in the center, the third is on the right, and the fourth is at the bottom center.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI MISURE	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di pieghe 295-297 mm formato A4, dei quali il numero 295 mm è conforme al Capitolato, contrariamente al 297 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica relativa all'articolo con cod. Ref. RDNNR080020000 è prodotta sia per lotto 3 (16 mt) che per il lotto 23 (20 mt). Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta le motivazioni che li ha indotti ad utilizzare lo stesso cod. Ref. per due lotti diversi ed eventualmente come distinguerà in sede di ordine le due misure.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

BIODIAGRAM – CERACARTA: Le relative schede tecniche prodotte non riportano la presenza della tacca nera così come prevista dal Capitolato Tecnico. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alle Ditte l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 280-250, dei quali il numero di fogli 250 è conforme al Capitolato, contrariamente a 280 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 200 come da scheda tecnica.

Handwritten signatures of the responsible parties, likely representing the companies involved in the quality control process.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

BIODIAGRAM – CERACARTA: Le relative schede tecniche prodotte non riportano la presenza della tacca nera così come prevista dal Capitolato Tecnico. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alle Ditte l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 107-108 mm, delle quali la misura 108 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 107 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	CHIARIMENTI		

CERACARTA: La scheda tecnica prodotta non riporta la presenza del diagramma come da Capitolato. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGewriter TC 30 ELETROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 151-152 mm, delle quali la misura 151 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 152 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBB8C SERIES 2 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 160-150, dei quali il numero di fogli 150 è conforme al Capitolato, contrariamente a 160 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 160 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 143-142 mm, delle quali la misura 143 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 142 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 143 mm e la Ditta ne offre 142 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 75-76 mm, delle quali la misura 75 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 76 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 30 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 16 mt e la Ditta ne offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 58 mm e la Ditta ne offre 57 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE				

In merito al Lotto 46 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica e inoltre non indica la compatibilità con il modello espressamente richiesta dal Capitolato.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 13 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda la larghezza 110-112 mm, delle quali la misura 110 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 112 mm contemporaneamente riportato sulla scheda; per quanto riguarda la lunghezza 15-13 mt, delle quali la misura 15 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 13 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 11 mt come da scheda tecnica. Inoltre il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 110 mm e la Ditta offre 112 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 10 mt e la Ditta ne offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK		OK

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP6SHM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK	NON CONFORME	

TIOZZO: Il prodotto risulta non conforme in quanto non indica la piena compatibilità con l'apparecchiatura richiesta e la scheda tecnica è incompleta.

La Commissione sospende la seduta alle ore 18.00 del giorno 05/12/2024 incaricando il Segretario Verbalizzante di trasmettere i Verbali 1 e 2 al RUP a mezzo mail per gli atti consequenziali.

La Commissione resta in attesa dei chiarimenti richiesti per riaggiornare la seduta. Nella quale verranno riesaminati i lotti 6 e 46 e si riserva di valutare gli opportuni approfondimenti.

Il Segretario-Verbalizzante
Ass.nte Amministrativo
Dott. Gianluca Ciotta

La Commissione
Dir. Farmaciste
Dott.ssa Roberta Ragusa
Dott.ssa Elisa Drago

Il Presidente
Dir. Farmacista
Dott.ssa Valentina Impellizzeri



Outlook

trasmissione verbali gara fornitura carta per apparecchiature elettromedicali

Da PO Licata - Distribuzione Farmaci <policata.distribuzionefarmaci@ASPAG.IT>

Data ven 06/12/2024 09:30

A Alfonso De Leo <alfonso.deleo@aspag.it>

Cc Valentina Impellizzeri <v.impellizzeri@aspag.it>; Roberta Ragusa <roberta.ragusa@aspag.it>; Elisa Drago <elisa.drago@aspag.it>

1 allegato (5 MB)

doc04458020241206091433.pdf;

Segue mail del verbale 1.

D'ordine dell'Organo Tecnico di Valutazione

Dott. Gianluca Ciotta

UOS FARMACIA PO LICATA PO LICATA, ASP AG

RESPONSABILE:

DR. CHRISTIAN INTORRE -----0922869113

DIRIGENTI FARMACISTI

DR.SSA VALENTINA IMPELLIZZERI -----0922869552

DR.SSA FABIOLA VIZZINI -----0922869551

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita informativa Il presente messaggio, corredata da eventuali allegati, contiene informazioni di natura riservata ed è da considerarsi ad utilizzo esclusivo del destinatario. Qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione, conservazione, copia, stampa o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso ad opera di soggetti diversi dal destinatario è strettamente vietata. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di avvisare tempestivamente il mittente e di provvedere alla relativa cancellazione unitamente ai contenuti allo stesso allegati



Verbale n. 3

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 4644600 – per la fornitura in somministrazione annuale, in 58 lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventicinque il giorno 19 del mese di Marzo in Agrigento, alle ore 11,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i Sigg.:

- **Dott. Rosalia Calà** – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato;
 - **Dott. Alfonso De Leo** – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento
 - **Sig.ra Cristina Bellavia** – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
 - **Sig.ra Daniela Parla** – Testimone – Assistente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per dare lettura dei verbali trasmessi dall'organo tecnico di supporto al RUP, nominato con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 165421 del 29.10.2024, per l'affidamento della fornitura in cinquantotto lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

PREMESSO CHE

- con deliberazione DG n. 508 del 20/09/2024 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, a mezzo RDO/ME.PA., per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 218.688,57= +IVA 22%, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- con la suindicata Delibera sono stati approvati i documenti denominati denominati “Condizioni particolari di contratto” – All. 1 -, “Capitolato tecnico” – All. 2 - e “Schema di offerta economica” – All. 3 -.
- con successiva delibera DG n. 546 del 26/06/2024 sono stati modificati e approvati i nuovi documenti “capitolato tecnico”, “schema di offerta” e “Condizioni particolari di contratto”, riducendo nello stesso tempo i lotti previsti in gara in 58 (cinquantotto) lotti anziché 61 (sessantuno), per come indicato dalla Dirigente Farmacista del P.O. di Licata con nota prot. n. 144916/2024, che ha unificato il lotto n. 10 con il lotto 17, il lotto 13 con il lotto 14 e il lotto 24 con il lotto n. 28.
- la presente gara si articola in cinquantotto lotti.
- in data 30.09.2024 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 4644600 aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativa CPV: “33190000-8” - descrizione CPV: “Dispositivi e prodotti medici vari” - categorie di abilitazione: “Altri dispositivi medici”.
- che entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 20/10/2024, quale termine ultimo per la presentazione delle

offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
1	BIODIAGRAM S.R.L.	Singolo economico operatore	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58.
2	CERACARTA S.p.A.	Singolo economico operatore	1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58.
3	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R. & C.	Singolo economico operatore	7 – 58.
4	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C	Singolo economico operatore	57.

Con verbale del 28 Ottobre del 2024 e verbale del 7 Febbraio 2025 il seggio di gara ha svolto i seguenti lavori:

- esaminato la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti.
- ammesso alla fase successiva l'operatore economico CERACARTA S.p.A., TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C. e BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C e ammesso con riserva limitatamente per il Lotto n. 15 l'operatore economico BIODIAGRAM S.R.L. per le motivazioni ivi riportati nel sopra citato verbale.
- proceduto all'apertura delle buste tecniche degli operatori partecipanti compreso l'operatore cui è stato attivato soccorso istruttorio.
- ammesso, altresì, alla fase successiva l'operatore economico BIODIAGRAM S.R.L. avendo il medesimo operatore economico sanato la carenza documentale riportata analiticamente nel verbale n. 1 del 28 ottobre 2024.
- proceduto alla lettura del verbale del 4 dicembre e del 5 dicembre 2024 resi dall'organo tecnico di supporto al RUP e ricevuti a mezzo email in data 6 dicembre, dove si riportano le conformità e/o non conformità nella tabella sottostante:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO

3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			
---	--	-------------------------	-------------	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE				

In merito al Lotto 6 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O	OK	OK	OK	

		DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ PS PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO				
--	--	---	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA	DITTA	DITTA

	REQUISITI MINIMI			CERACARTA	TIOZZO	BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 Elettrocardiografo	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 Elettrocardiografo	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L Elettrocardiografo	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma carta termica diagrammata	CARDIOLINE ECG200+ Elettrocardiografo	CHIARIMENTI MISURE			

	(colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica			OK		
--	---	--	--	----	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - Elettrocardiografo	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG Elettrocardiografo	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 Elettrocardiografo	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO Elettrocardiografo	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il	GE HEALTHCARE MAC 600 Elettrocardiografo	CHIARIMENTI	OK		

	giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli					
--	---	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA	DITTA	DITTA
-------	---------------	---------------------------	------------------	-------	-------	-------

	REQUISITI MINIMI			CERACARTA	TIOZZO	BIOTENICA CATALANO
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBB SERIES 2 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	OK	NON		

	50mm X 16m			CONFORME		
--	------------	--	--	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE				

In merito al Lotto 46 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34				

	carta termica 112mm X 13m	AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		
--	------------------------------	------------	----	--------------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta	SONY CORP UP 25 MD				

	ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK		OK
--	---	---	----	----	--	----

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK	NON CONFORME	

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI ESPONE QUANTO SEGUE

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Dott. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Il seggio di gara, visti i chiarimenti pervenuti dagli operatori economici Ceracarta S.p.A. e Biodiagram S.r.l., procede alla lettura del verbale dell'organo tecnico di supporto al RUP della seduta privata del 4 Marzo 2025, che si è riunita per valutare i chiarimenti pervenuti e la rivisitazione di alcuni lotti che vengono riportati nel predetto verbale di cui si da lettura.

Il presidente di gara da mandato, al Segretario Verbalizzante di leggere il predetto verbale dell'organo di supporto al RUP, della seduta privata del 4 Marzo 2025 dove si è determinata l'ammissione o meno delle offerte in gara:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta è relativa al lotto 1.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE	CONFORME	CONFORME	CONFORME	

		ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON 5B ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO				
--	--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	CONFORME		

BIODIAGRAM: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede carta termica bianca e la Ditta offre carta diagrammata come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CONFORME			

	(colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli			CONFORME		
--	--	--	--	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero di fogli in quanto da Capitolato Tecnico si chiedono 300 fogli e la Ditta offre 315 fogli come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------------------

16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CONFORME	CONFORME		
----	--	---	----------	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto)	CARDIOLINE ECG200+ ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

	210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica					
--	---	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 Elettrocardiografo	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 200 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 Elettrocardiografo	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO

32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		
----	--	---	----------	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CONFORME			

	giusto contrasto) 151mm x 20m				
--	----------------------------------	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 160 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 30 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 16 mt e la Ditta ne offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica e inoltre non indica la compatibilità con il modello espressamente richiesta dal Capitolato.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	CONFORME	CONFORME		

--	--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 13 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 11 mt come da scheda tecnica. Inoltre il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 110 mm e la Ditta offre 112 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 10 mt e la Ditta ne offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	CONFORME	CONFORME		CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	

TIOZZO: Il prodotto risulta non conforme in quanto non indica la piena compatibilità con l'apparecchiatura richiesta e la scheda tecnica è incompleta.

Per quanto sopra premesso

Il seggio di gara da atto che il RUP della procedura procede all'esclusione, tramite piattaforma www.acquistinretepa.it, delle offerte dichiarate non conformi – dall'organo tecnico di supporto al RUP – che sono riportati nelle superiori tabelle.

Il presidente di gara tramite il RUP della procedura soggetto accreditato nella piattaforma telematica www.acquistinretepa.it come punto istruttore ME.PA., procede all'apertura dei plachi telematici contenenti le offerte economiche degli operatori economici che hanno conseguito la conformità tecnica. La commissione di gara da lettura delle offerte che di seguito si trascrivono:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	€ 52,80	€ 52,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	€ 405,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM S.r.l.
-------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------

3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	€ 168,00
---	--	-------------------------	----------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HDI LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	€ 150,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	€ 51,00	€ 49,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	€ 1.205,60

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R. & C.	
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O	€ 22.400,00	€ 21.800,00	€ 30.000,00	   

		DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO			
--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	€ 282,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	€ 2.354,40	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+	NON CONFORME	€ 765,00

DEFIBRILLATORE				
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	€ 378,00	€ 357,00
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	€ 2.760,00	€ 2.970,00
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	€ 3.042,00	€ 2.574,00
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	€ 54,00	€ 55,80
15	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	€ 126,00	NON CONFORME
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	€ 1.368,00	€ 1.386,00
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	€ 192,00	€ 207,00
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm,	ZONCARE IMAC 120 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.771,20	€ 1.911,60

	142 fogli		
--	-----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT I ELETTROCARDIOGRAFO	€ 149,98

Si rileva una discrasia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 149,98= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 150,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 149,98= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETTROCARDIOGRAFO	€ 114,00	€ 117,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETTROCARDIOGRAFO	€ 15.168,00	€ 15.262,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETTROCARDIOGRAFO	€ 11.475,00	€ 12.410,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO	€ 192,00	€ 234,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 216,00	€ 264,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	€ 108,00	€ 116,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.170,00	

	giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli			€ 1.155,00
--	--	--	--	------------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.200,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	€ 7.488,00	€ 9.079,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mm X 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	€ 300,00	€ 322,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.173,00	€ 1.234,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 90,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 54,00	€ 57,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 783,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 9.465,90	€ 9.549,30

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 9.450,00	€ 10.260,00

Si rileva una discrasia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 1.405,00= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 1.485,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 1.405,00= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 10.854,00	€ 11.738,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	€ 1.405,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	€ 288,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	€ 12.420,00	€ 11.610,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 210,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H I P E TS SO AUTOCLAVE	€ 79,20	€ 79,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.

42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	€ 300,00	NON CONFORME
----	---	--	----------	--------------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu I8 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 599,90

Si rileva una discrasia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 599,90= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 600,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 599,90= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 201,60	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	€ 78,00	€ 73,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	€ 600,00	€ 588,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 150,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	€ 2.592,00	€ 2.688,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	€ 29,98	€ 28,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.		
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	€ 486,00	NON CONFORME		
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	€ 85,80			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	€ 84,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 59,98	€ 57,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 450,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	€ 119,98

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	€ 299,98	NON CONFORME

Si rileva una discrasia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 299,98= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 300,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 299,98= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 53.200,00	€ 54.350,00	ESCLUSA

L'offerta economica dell'operatore economico Biotecnica di Catalano Lea & C. è esclusa in quanto il predetto operatore economico ha presentato offerta complessiva per € 28.000,00=oltre I.V.A. e per un prezzo pari a € 40,00=oltre I.V.A. per

ogni risma di carta composta da n. 50 fogli, mentre il capitolato tecnico prevede la risma da 200 fogli. Si specifica, altresì, che l'offerta dell'operatore economico Biotecnica di Catalano Lea & C. risulta a rialzo moltiplicando il prezzo per ogni risma da 50 fogli pari ad € 40,00 per 4 volte per raggiungere il quantitativo di 200 fogli a risma.

Per quanto sopra, si aggiudica il Lotto 57 alla società Biodiagram s.r.l. che ha offerto la carta per un importo complessivo pari ad € 53.200,00=oltre I.V.A. e per un importo unitario pari ad € 76,00= oltre iva per la risma da 200 fogli.



LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	DITTA TIOZZO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 2.850,00	€ 1.980,00	NON CONFORME

Il seggio di gara prende atto che per il Lotto n. 1 e per il Lotto n. 41, gli operatori economici Biodiagram S.r.l. e Ceracarta S.p.A. hanno presentato offerta alla pari, per cui si procederà a richiedere ai concorrenti interessati un miglioramento dell'offerta presentata, che per ragioni di tracciabilità dovrà essere presentata esclusivamente per il tramite della piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it – RDO aperta n. 4644600 sezione comunicazione.



Il seggio di gara si autoconvoca per giorno 2 aprile p.v., per procedere all'aggiudicazione della fornitura.

Il presente verbale, che consta di n. 17 pagine e n. 33 facciate –, viene letto e sottoscritto alle ore 14,30 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

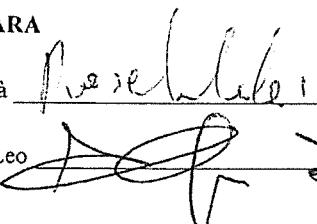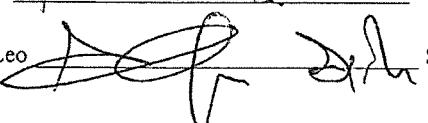- Dr.ssa Rosalia Calà  Presidente
- Dott. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Cristina Bellavia 
- Sig.ra Daniela Parla 

Verbale n. 3

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 4644600 – per la fornitura in somministrazione annuale, in 58 lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventicinque il giorno 19 del mese di Marzo in Agrigento, alle ore 11,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i Sig.:

- Dott. Rosalia Calà – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato;
- Dott. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento
- Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig.ra Daniela Parla – Testimone – Assistente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per dare lettura dei verbali trasmessi dall'organo tecnico di supporto al RUP, nominato con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 165421 del 29.10.2024, per l'affidamento della fornitura in cinquantotto lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

PREMESSO CHE

- con deliberazione DG n. 508 del 20/09/2024 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, a mezzo RDO/ME.PA., per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 218.688,57= +IVA 22%, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- con la suindicata Delibera sono stati approvati i documenti denominati denominati “Condizioni particolari di contratto” – All. 1 -, “Capitolato tecnico” – All. 2 - e “Schema di offerta economica” – All. 3 -.
- con successiva delibera DG n. 546 del 26/06/2024 sono stati modificati e approvati i nuovi documenti “capitolato tecnico”, “schema di offerta” e “Condizioni particolari di contratto”, riducendo nello stesso tempo i lotti previsti in gara in 58 (cinquantotto) lotti anziché 61 (sessantuno), per come indicato dalla Dirigente Farmacista del P.O. di Licata con nota prot. n. 144916/2024, che ha unificato il lotto n. 10 con il lotto 17, il lotto 13 con il lotto 14 e il lotto 24 con il lotto n. 28.
- la presente gara si articola in cinquantotto lotti.
- in data 30.09.2024 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 4644600 aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: “33190000-8” - descrizione CPV: “Dispositivi e prodotti medici vari” - categorie di abilitazione: “Altri dispositivi medici”.
- che entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 20/10/2024, quale termine ultimo per la presentazione delle

offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
1	BIODIAGRAM S.R.L.	Singolo operatore economico	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58.
2	CERACARTA S.p.A.	Singolo operatore economico	1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58.
3	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C.	Singolo operatore economico	7 – 58.
4	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C	Singolo operatore economico	57.

Con verbale del 28 Ottobre del 2024 e verbale del 7 Febbraio 2025 il seggio di gara ha svolto i seguenti lavori:

- esaminato la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti.
- ammesso alla fase successiva l'operatore economico CERACARTA S.p.A., TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C. e BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C e ammesso con riserva limitatamente per il Lotto n. 15 l'operatore economico BIODIAGRAM S.R.L. per le motivazioni ivi riportati nel sopra citato verbale.
- proceduto all'apertura delle buste tecniche degli operatori partecipanti compreso l'operatore cui è stato attivato soccorso istruttorio.
- ammesso, altresì, alla fase successiva l'operatore economico BIODIAGRAM S.R.L. avendo il medesimo operatore economico sanato la carenza documentale riportata analiticamente nel verbale n. 1 del 28 ottobre 2024.
- proceduto alla lettura del verbale del 4 dicembre e del 5 dicembre 2024 resi dall'organo tecnico di supporto al RUP e ricevuti a mezzo email in data 6 dicembre, dove si riportano le conformità e/o non conformità nella tabella sottostante:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTECNICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTECNICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTECNICA CATALANO

3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			
---	--	-------------------------	-------------	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE				

In merito al Lotto 6 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MI RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O	OK	OK	OK	



	DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ PS PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO					
--	---	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA	DITTA	DITTA
-------	---------------	---------------------------	------------------	-------	-------	-------

	REQUISITI MINIMI			CERACARTA	TIOZZO	BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 Elettrocardiografo	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 Elettrocardiografo	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L Elettrocardiografo	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma carta termica diagrammata	CARDIOLINE ECG200+ Elettrocardiografo	CHIARIMENTI MISURE			

	(colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica			OK		
--	---	--	--	----	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

	giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli					
--	---	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 Elettrocardiografo	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER Elettrocardiografo	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI Elettrocardiografo	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 Elettrocardiografo	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 Elettrocardiografo	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA	DITTA	DITTA
-------	---------------	---------------------------	------------------	-------	-------	-------

	REQUISITI MINIMI			CERACARTA	TIOZZO	BIOTENICA CATALANO
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	CHIARIMENTI		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CHIARIMENTI			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	OK	NON		

	50mm X 16m			CONFORME		
--	------------	--	--	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE				

In merito al Lotto 46 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34				

	carta termica 112mm X 13m	AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		
--	------------------------------	------------	----	--------------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	OK	NON CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta	SONY CORP UP 25 MD				

	ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK		OK
--	---	---	----	----	--	----

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK	NON CONFORME	

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI ESPONE QUANTO SEGUE

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Dott. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Il seggio di gara, visti i chiarimenti pervenuti dagli operatori economici Ceracarta S.p.A. e Biodiagram S.r.l., procede alla lettura del verbale dell'organo tecnico di supporto al RUP della seduta privata del 4 Marzo 2025, che si è riunita per valutare i chiarimenti pervenuti e la rivisitazione di alcuni lotti che vengono riportati nel predetto verbale di cui si da lettura.

Il presidente di gara da mandato, al Segretario Verbalizzante di leggere il predetto verbale dell'organo di supporto al RUP, della seduta privata del 4 Marzo 2025 dove si è determinata l'ammissione o meno delle offerte in gara:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	CONFORME		

BODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta è relativa al lotto 1.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE	CONFORME	CONFORME	CONFORME	

		ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO				
--	--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	CONFORME		

BODIAGRAM: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede carta termica bianca e la Ditta offre carta diagrammata come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CONFORME			

	(colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli			CONFORME		
--	--	--	--	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero di fogli in quanto da Capitolato Tecnico si chiedono 300 fogli e la Ditta offre 315 fogli come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------------------

16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CONFORME	CONFORME		
----	--	---	----------	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto)	CARDIOLINE ECG200+ ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

	210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica				
--	---	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 Elettrocardiografo	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 200 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 Elettrocardiografo	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 Elettrocardiografo	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO

32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		
----	--	---	----------	----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CONFORME			

	giusto contrasto) 151mm x 20m					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBB SERIES 2 MONITOR FETALE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 160 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 30 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 16 mt e la Ditta ne offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica e inoltre non indica la compatibilità con il modello espressamente richiesto dal Capitolato.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	CONFORME	CONFORME		

--	--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 13 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 11 mt come da scheda tecnica. Inoltre il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 110 mm e la Ditta offre 112 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 10 mt e la Ditta ne offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta ecografica UPC-Z1L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	CONFORME	CONFORME		CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	

TIOZZO: Il prodotto risulta non conforme in quanto non indica la piena compatibilità con l'apparecchiatura richiesta e la scheda tecnica è incompleta.

Per quanto sopra premesso

Il seggio di gara da atto che il RUP della procedura procede all'esclusione, tramite piattaforma www.acquistinretepa.it, delle offerte dichiarate non conformi – dall'organo tecnico di supporto al RUP – che sono riportati nelle superiori tabelle.

Il presidente di gara tramite il RUP della procedura soggetto accreditato nella piattaforma telematica www.acquistinretepa.it come punto istruttore ME.PA., procede all'apertura dei plachi telematici contenenti le offerte economiche degli operatori economici che hanno conseguito la conformità tecnica. La commissione di gara da lettura delle offerte che di seguito si trascrivono:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	€ 52,80	€ 52,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	€ 405,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM S.r.l.

3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	€ 168,00
---	--	-------------------------	----------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HDI LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	€ 150,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	€ 51,00	€ 49,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	€ 1.205,60

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R. & C.	
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O	€ 22.400,00	€ 21.800,00	€ 30.000,00	<i>f</i> <i>R</i> <i>D</i> <i>P</i>

		DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP I200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO			
--	--	--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	€ 282,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	€ 2.354,40	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+	NON CONFORME	€ 765,00

DEFIBRILLATORE				
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	€ 378,00	€ 357,00
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	€ 2.760,00	€ 2.970,00
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	€ 3.042,00	€ 2.574,00
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	€ 54,00	€ 55,80
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	€ 126,00	NON CONFORME
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	€ 1.368,00	€ 1.386,00
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	€ 192,00	€ 207,00
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm,	ZONCARE IMAC 120 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.771,20	€ 1.911,60

	142 fogli		
--	-----------	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 149,98

Si rileva una discrasia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 149,98= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 150,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 149,98= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETTROCARDIOGRAFO	€ 114,00	€ 117,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETTROCARDIOGRAFO	€ 15.168,00	€ 15.262,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETTROCARDIOGRAFO	€ 11.475,00	€ 12.410,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO	€ 192,00	€ 234,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 216,00	€ 264,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 min, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	€ 108,00	€ 116,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.170,00	

	giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli			€ 1.155,00
--	--	--	--	------------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.200,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	€ 7.488,00	€ 9.079,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	€ 300,00	€ 322,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 1.173,00	€ 1.234,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 90,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 54,00	€ 57,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 783,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 9.465,90	€ 9.549,30

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 9.450,00	€ 10.260,00

Si rileva una diserbia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 1.405,00= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 1.485,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 1.405,00= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	€ 10.854,00	€ 11.738,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	€ 1.405,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBCB SERIES 2 MONITOR FETALE	€ 288,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	€ 12.420,00	€ 11.610,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 210,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H IP E TS SO AUTOCLAVE	€ 79,20	€ 79,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.

42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	€ 300,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 599,90

Si rileva una discrasia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 599,90= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 600,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 599,90= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 201,60	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	€ 78,00	€ 73,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	€ 600,00	€ 588,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 150,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SPORZO	€ 2.592,00	€ 2.688,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	€ 29,98	€ 28,80

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.		
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	€ 486,00	NON CONFORME		
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	€ 85,80			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	€ 84,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 59,98	€ 57,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 450,00	NON CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	€ 119,98

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	€ 299,98	NON CONFORME

Si rileva una discrasia tra il documento offerta economica ove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 299,98= oltre I.V.A. e lo Schema di offerta economica dove viene indicato un importo offerto del lotto pari ad € 300,00= oltre I.V.A., per cui si ritiene valida l'offerta più favorevole alla scrivente stazione appaltante ovvero € 299,98= oltre I.V.A..

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C
57	Risine di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 53.200,00	€ 54.350,00	ESCLUSA

L'offerta economica dell'operatore economico Biotecnica di Catalano Lea & C. è esclusa in quanto il predetto operatore economico ha presentato offerta complessiva per € 28.000,00=oltre I.V.A. e per un prezzo pari a € 40,00=oltre I.V.A. per

ogni risma di carta composta da n. 50 fogli, mentre il capitolato tecnico prevede la risma da 200 fogli. Si specifica, altresì, che l'offerta dell'operatore economico Biotecnica di Catalano Lea & C. risulta a rialzo moltiplicando il prezzo per ogni risma da 50 fogli pari ad € 40,00 per 4 volte per raggiungere il quantitativo di 200 fogli a risma.

Per quanto sopra, si aggiudica il Lotto 57 alla società Biodiagram s.r.l. che ha offerto la carta per un importo complessivo pari ad € 53.200,00=oltre I.V.A. e per un importo unitario pari ad € 76,00= oltre iva per la risma da 200 fogli.


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.	DITTA TIOZZO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 2.850,00	€ 1.980,00	NON CONFORME

Il seggio di gara prende atto che per il Lotto n. 1 e per il Lotto n. 41, gli operatori economici Biodiagram S.r.l. e Ceracarta S.p.A. hanno presentato offerta alla pari, per cui si procederà a richiedere ai concorrenti interessati un miglioramento dell'offerta presentata, che per ragioni di tracciabilità dovrà essere presentata esclusivamente per il tramite della piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it – RDO aperta n. 4644600 sezione comunicazione.



Il seggio di gara si autoconvoca per giorno 2 aprile p.v., per procedere all'aggiudicazione della fornitura.

Il presente verbale, che consta di n. 17 pagine e n. 33 facciate –, viene letto e sottoscritto alle ore 14,30 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dr.ssa Rosalia Calà  Presidente
- Dott. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Cristina Bellavia 
- Sig.ra Daniela Parla 

Verbale n. 4

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 4644600 – per la fornitura in somministrazione annuale, in 58 lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventicinque il giorno 22 del mese di Aprile in Agrigento, alle ore 8,40 circa presso la sede dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, sono presenti i Sigg.:

- **Dott. Rosalia Calà** – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato;
 - **Dott. Alfonso De Leo** – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
 - **Dott. Giuseppe Tedesco** – Testimone – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
 - **Sig.ra Cristina Bellavia** – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per continuare i lavori del 19.03.2025 per l'affidamento della fornitura in cinquantotto lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 218.688,57= + IVA.

PREMESSO CHE

- con deliberazione DG n. 508 del 20/09/2024 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, a mezzo RDO/ME.PA., per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 218.688,57= +IVA 22%, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- con la suindicata Delibera sono stati approvati i documenti denominati denominati “Condizioni particolari di contratto” – All. 1 -, “Capitolato tecnico” – All. 2 - e “Schema di offerta economica” – All. 3 -.
- con successiva delibera DG n. 546 del 26/06/2024 sono stati modificati e approvati i nuovi documenti “capitolato tecnico”, “schema di offerta” e “Condizioni particolari di contratto”, riducendo nello stesso tempo i lotti previsti in gara in 58 (cinquantotto) lotti anziché 61 (sessantuno), per come indicato dalla Dirigente Farmacista del P.O. di Licata con nota prot. n. 144916/2024, che ha unificato il lotto n. 10 con il lotto 17, il lotto 13 con il lotto 14 e il lotto 24 con il lotto n. 28.
- la presente gara si articola in cinquantotto lotti.
- in data 30.09.2024 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 4644600 aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: “33190000-8” - descrizione CPV: “Dispositivi e prodotti medici vari” - categorie di abilitazione: “Altri dispositivi medici”.
- che entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 20/10/2024, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
1	BIODIAGRAM S.R.L.	Singolo economico operatore	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58.
2	CERACARTA S.p.A.	Singolo economico operatore	1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 39 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58.
3	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.& C.	Singolo economico operatore	7 – 58.
4	BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C	Singolo economico operatore	57.

Con verbale del 28 Ottobre del 2024, verbale del 7 Febbraio 2025 e verbale del 19 Marzo 2025 il seggio di gara ha svolto i lavori meglio descritti nei predetti verbali, che qui si intendono integralmente riportati.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUUE**

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Dott. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

Il Presidente comunica che il seggio di gara, autoconvocato nel verbale n. 3 del 19 marzo 2025, non si è potuto insediare in data 2 Aprile u.s. per ragioni prettamente organizzative della U.O.C. Servizio Provveditorato.

Il seggio di gara, prende atto che gli operatori economici Caracarta S.p.A. e Biodiagram S.r.l., con comunicazioni pervenute a mezzo ME.PA. rispettivamente in data 28.03.2025 e 31.03.2025, hanno presentato offerta migliorativa per il Lotto n. 1 e n. 41 per come segue:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	€ 50,40	€ 50,88

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.	CERACARTA S.p.A.
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	€ 75,60	€ 76,32

Il seggio di gara procede all'aggiudicazione provvisoria dei lotti per come di seguito riportato:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	€ 50,40
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore)	BEXEN CARDIO REANIBEX 800	€ 405,00



	adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	DEFIBRILLATORE	
--	---	----------------	--


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM S.r.l.
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	€ 168,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	€ 150,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	€ 49,20

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	€ 1.205,60

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME	€ 21.800,00

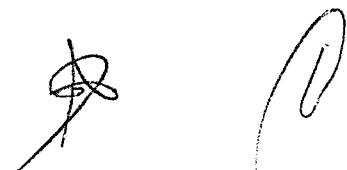

		MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO	
--	--	--	--

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	€ 282,00


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	€ 2.354,40

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	€ 765,00


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	€ 357,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	€ 2.760,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN	




	30 mt	CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	€ 2.574,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	€ 54,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
15	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	€ 126,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	€ 1.368,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	€ 192,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETROCARDIOGRAFO	€ 1.771,20
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT I ELETROCARDIOGRAFO	€ 149,98
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETROCARDIOGRAFO	€ 114,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETROCARDIOGRAFO	€ 15.168,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETROCARDIOGRAFO	€ 11.475,00



LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETROCARDIOGRAFO	€ 192,00
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETROCARDIOGRAFO	€ 216,00
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETROCARDIOGRAFO	€ 108,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETROCARDIOGRAFO	€ 1.155,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETROCARDIOGRAFO	€ 1.200,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETROCARDIOGRAFO	€ 7.488,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETROCARDIOGRAFO	€ 300,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETROCARDIOGRAFO	€ 1.173,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETROCARDIOGRAFO	€ 90,00



LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETROCARDIOGRAFO	€ 54,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETROCARDIOGRAFO	€ 783,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETROCARDIOGRAFO	€ 9.465,90
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETROCARDIOGRAFO	€ 9.450,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETROCARDIOGRAFO	€ 10.854,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	€ 1.405,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	€ 288,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	€ 11.610,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 210,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.



41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	€ 75,60
----	---	--------------------------------------	---------

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	€ 300,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 599,90

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	€ 201,60


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	€ 73,50

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	€ 588,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	€ 150,00


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	€ 2.592,00

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	€ 28,80





LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	€ 486,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	€ 85,80
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	€ 84,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 57,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	€ 450,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	€ 119,98
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	€ 299,98
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	BIODIAGRAM S.r.l.
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI- 200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 53.200,00
LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	CERACARTA S.p.A.
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	€ 1.980,00

Il Presidente di gara dichiara conclusi i lavori e trasmette al RUP, per il seguito di competenza, il presente verbale n. 4



del 22/04/2025, che consta di 8 pagine e n. 15 facciate – compreso gli allegati di cui alle migliori prodotte dalla Ceracarta S.p.A. e Biodiagram S.r.l. rispettivamente per il Lotto n. 1 e Lotto n. 41 -, che viene letto e sottoscritto alle ore 9,15 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

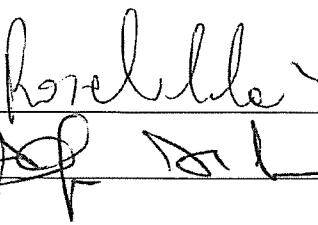- Dr.ssa Rosalia Calà  Presidente
- Dott. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Cristina Bellavia _____
- Dott. Giuseppe Tedesco _____

Comunicazione

 Anna Cobelli CERACARTA

31/03/2025 16:52:10 ✓

A:
Cc: ALFONSO DE LEO;

RDO ME.PA. aperta n. 4644600 per la fornitura in somministrazione di carta per apparecchiature elettromedicali. Richiesta miglioria Lotto n. 1 e lotto n. 41.

 Allegati OFFERTA MIGLIORATIVA LOTTI 1 E 41.pdf.p7m

Buonasera,
si inoltra in allegato file economico compilato per i lotti 1 e 41 con offerta migliorativa.
Cordiali saluti

ANALISI

 DOMENICO MAIELLO BIODIAGRAM

28/03/2025 18:17:19 ✓

A:
Cc: ALFONSO DE LEO;

RDO ME.PA. aperta n. 4644600 per la fornitura in somministrazione di carta per apparecchiature elettromedicali. Richiesta miglioria Lotto n. 1 e lotto n. 41.

 Allegati

Buonasera
Grazie della richiesta

In considerazione dei buoni rapporti con la Vs. amministrazione ,considerando che nelle offerte sono compresi i costi di trasporto, siamo disponibile ad offrire per entrambi i lotti 1 e 41,di cui si richiede miglioria, di offrire il prodotto RBDGN050020000 a € 0,42. Pertanto il totale del lotto 1 è di € 50,40 e del Lotto 41 è di € 75,60.

Sperando di aver fatto cosa gradita

In attesa di riscontro

Cordiali Saluti

Maiello Domenico

SCHIMMA UN KERIA ECONOMICA

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Fabbisogno annuale	UNITÀ DI MISURA	Base di gesta per imposta complessiva	Importo complessivo lotto	Iniziativa lungo rete			Prezzo offerto per il tutto el singolo lotto
							Rotolo	Unità di gesta per imposta	Iniziativa numero di ogni rotolo	
1	Ruoli banchi di carta termica 50 mm X 20m ad ottenere il giusto contrasto	ARTENIA AND SAW MONITORING AND EMERGENCY CARE CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	120	rotolo	0,49 €	58,80 €	20m		0,424 €	50,88 €
2	Ruoli di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 105mm X 2,5m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	450	rotolo	0,94 €	423,00 €				0,00 €
3	Ruoli di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 105mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	300	rotolo	0,58 €	174,00 €				0,00 €
4	Ruoli carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 105mm X 20m	ES-AOTE SPA ADF DEFIBRILLATORE	60	rotolo	0,60 €	180,00 €				0,00 €
5	Ruoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	60	rotolo	0,50 €	54,00 €				0,00 €
6	Ruoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	2740	rotolo	0,45 €	1.233,00 €				0,00 €
7	Ruoli di carta ecografica UPP 1.0 HG 110mm X 8m (compatibile)	SONY CORP UP-DIGITAL RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-D98 MD RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-X 69 MD RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-D99 MD RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-D23 MD RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-S98 MD RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-970 AD RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-960 CE RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-S93 MDW RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-S98 MD RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-897 RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-895 CE RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-2100P RUTRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI; SONY CORP UP-2100P	4800	rotolo	8,00 €	32.000,00 €			0,00 €	
8	Ruoli carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	300	rotolo	1,00 €	300,00 €				0,00 €
9	Ruoli carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEFIBRIT 15 DEFIBRILLATORE	6540	rotolo	0,40 €	2.616,00 €				0,00 €
10	Ruoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEFIBRIT 15 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	1500	rotolo	0,55 €	825,00 €				0,00 €
11	Ruoma di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 100m 200 fogli.	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	300	rima	1,30 €	390,00 €				0,00 €

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA/ MODELLO APPARECCHIO	Fabbro/ gno annuale	UNITÀ DI MISURA	IN base alla valuta re-fer- so al giorno	Importo complessivo per lotto	Indicare impienze- ziale di ogni nro.	Indicare numero fogli per ogni risma	Prezzo offerto a singola rollo o a risma	Prezzo offerto per una quantità di lotto
12	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con teca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	6000	risma	0,57 €	3.420,00 €			0,00 €	
13	Rotoli di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 200 mm	NIHON KOHDEN CORP TEC 651 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 651 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MIX DEFIBRILLATORE	5850	rotolo	0,60 €	3.510,00 €			0,00 €	
14	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con teca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piatta compatibile con la macchina e con il modello dell'etichettatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 771 K DEFIBRILLATORE	90	risma	0,65 €	58,50 €			0,00 €	
15	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEHIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	180	risma	0,90 €	162,00 €			0,00 €	
16	Rotoli di Carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm x 75mm	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORD X SERIES e CORP M SERIES	1800	rotolo	0,90 €	1.620,00 €			0,00 €	
17	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP X SERIES ALS DEFIBRILLATORE	300	risma	0,70 €	210,00 €			0,00 €	
18	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 40 mm, 142 fogli	ZONCARIE IMAC 120 ELETROCARDIOGRAFO	1080	risma	1,80 €	1.944,00 €			0,00 €	
19	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 100f 140gsm - fingerograf a 1 strumento	SCHILLER AG CARDIOVIT 1 ELETROCARDIOGRAFO	150	risma	1,00 €	150,00 €			0,00 €	
20	Rotolo di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 250 mm, 150 fogli	CARDIOLINE ECG 100L ELETROCARDIOGRAFO	150	rotolo	0,80 €	120,00 €			0,00 €	
21	Risma carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 250mm, 140gsm - fingerograf a 1 strumento	CARDIOLINE ECG200+ ELETROCARDIOGRAFO	4740	risma	4,70 €	22.278,00 €			0,00 €	
22	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 250mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000-MAC 1200 ST - ELETROCARDIOGRAFO	4250	risma	3,02824 €	12.870,02 €			0,00 €	
23	Rotoli di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 100m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETROCARDIOGRAFO	200	rotolo	0,90 €	270,00 €			0,00 €	
24	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIRWIN 4320 ELETROCARDIOGRAFO	60	risma	5,00 €	300,00 €			0,00 €	
25	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 40 fogli. Trac prescrit	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETROCARDIOGRAFO	120	risma	1,20 €	144,00 €			0,00 €	
26	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm, 50 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETROCARDIOGRAFO	1500	risma	0,80 €	1.200,00 €			0,00 €	
27	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 40 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETROCARDIOGRAFO	1200	risma	1,20 €	1.440,00 €			0,00 €	
28	Risma di Carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 800 POWER ELETROCARDIOGRAFO	2340	risma	4,40 €	10.296,00 €			0,00 €	
29	Rotoli di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mm X 22mm	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-4-12 CANALI ELETROCARDIOGRAFO	150	rotolo	2,25 €	337,50 €			0,00 €	
30	Risma di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con teca nera, 14 210x25mm 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEFICART R12 ELETROCARDIOGRAFO	510	risma	2,50 €	1.275,00 €			0,00 €	


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA/ MODELLO APPARECCHIO	Fabbisogno animale	UNITÀ DI MISURA	BIGLIETTO PER singola rotella	Importo complessivo Lotto	Indicare lunghezza di ogni rotolo	Indicare numero fogli per ogni rotolo	Prezzo offerto a singolare rotolo o a rotoli	Prezzo offerto per totale dei singoli Lotti
31	Rotoli di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m.	MINDRAY LTD BENEFHEART R3 ELETROCARDIOGRAFO	150	rotolo	0,70 €	105,00 €			0,00 €	
32	Rotoli di carta termica a disegnatura (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m.	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETROCARDIOGRAFO	60	rotolo	1,00 €	60,00 €			0,00 €	
33	Rotoli di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m.	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETROCARDIOGRAFO	450	rotolo	1,80 €	810,00 €			0,00 €	
34	Risma di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m.	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETROCARDIOGRAFO	2085	risma	6,40 €	13.344,00 €			0,00 €	
35	Risma di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 100mm, 100 fogli.	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PACSWITER TC 30 ELETROCARDIOGRAFO	4500	risma	2,45 €	11.025,00 €			0,00 €	
36	Risma di Carta termica disegnata SL12 misure 210mmx 295mm x 130 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETROCARDIOGRAFO	4020	risma	3,00 €	12.060,00 €			0,00 €	
37	Rotoli di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m.	BIOMET CO LTD FC 400 MONITOR FETALE	1350	rotolo	1,20 €	1.620,00 €			0,00 €	
38	Risma di Carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm X 50mm, 150 fogli.	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBBC SERIE S3 MONITOR FETALE	360	risma	0,90 €	324,00 €			0,00 €	
39	Risma di carta termica disegnata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 50mm, 300 fogli.	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID. TEAM SONICAID LTD.	5400	risma	2,50 €	13.500,00 €			0,00 €	
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 30m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERIRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	150	rotolo	1,45 €	217,50 €			0,00 €	
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 21270 II PETS SO AUTOCLAVE CISA SPA	180	rotolo	0,50 €	90,00 €	20m		0,424 €	75,32 €
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELLA APPARECCHIATURA)	600	rotolo	0,60 €	360,00 €			0,00 €	
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	1500	rotolo	0,40 €	600,00 €			0,00 €	
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 15m	RENO-D30 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	480	rotolo	0,45 €	216,00 €			0,00 €	
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	150	rotolo	0,55 €	82,50 €			0,00 €	
46	Rotolo bianco carta termica per A466EP per le misure fare riferimento alla lista compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	1200	rotolo	0,60 €	720,00 €			0,00 €	
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla lista compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNOGAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	200	rotolo	0,55 €	110,00 €			0,00 €	
48	Risma carta termica 214x216 mm x 280mm, 300 fogli.	GE HEALTHCARE CASE VS 7 SISTEMA PER ANALISI DUAL CCPTR-K400 AUTOREFRAZIONE STORCO	480	risma	6,00 €	2.880,00 €			0,00 €	
49	Rotoli bianchi di carta termica 37mm X 20m	DUAL CCPTR-K400 AUTOREFRAZIONE STORCO	60	rotolo	0,50 €	30,00 €			0,00 €	
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC M1341 AUDIOMETRO	900	rotolo	0,55 €	585,00 €			0,00 €	
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC M1341 AUDIOMETRO	165	rotolo	0,55 €	90,75 €			0,00 €	
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R35 AUDIOMETRO	150	rotolo	0,65 €	97,50 €			0,00 €	
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MRI SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB II SPROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	60	rotolo	1,00 €	60,00 €			0,00 €	
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SPA PONY FX SPROMETRO A USO CLINICO BIOMEDICAL EQUIPMENT	750	rotolo	0,65 €	487,50 €			0,00 €	
55	Rotoli bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EQUIPMENT EMORRAGIAZIONE	300	rotolo	0,40 €	120,00 €			0,00 €	
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 ENDOSANALIZZATORE	750	rotolo	0,40 €	300,00 €			0,00 €	

LOTTO	DESCRIZIONE E RISQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Ribaltaggio annuale	IN ITALIA DI NUOVI STAMPATI	base fissata per ogni singolo rotolo	In porto complessivo	Indicare lunghezza di ogni rotolo	Indicare numero fogli per ogni rotolo	Prezzo offerto a singola rotolo o a rima	Prezzo offerto per il rotolo o a rima minimo del singolo rotolo
57	Risone di carta geografica UPG-21L - 141mm X 100mm - STAMPA A COLORI - 200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 22 MD RIPRODUTTORE VIDEO	700	rima	80,00 €	56.000,00 €			0,00 €	1.616
58	Rotolo carta termica KRS51M-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI	300	rotolo	9,50 €	2.880,00 €			0,00 €	

218.688,57 €

FORLI, 31/03/2025

CERCCORDI S.p.A.
Il Presidente
Alessandro Bonadini

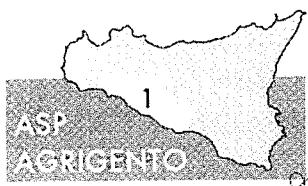Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Organo Tecnico di supporto al Rup
Gara Fornitura Carta per Apparecchiature Elettromedicali

Il giorno 04 Dicembre 2024, alle ore 10.30 presso i locali della Direzione del Dipartimento del Farmaco si insedia l'Organo Tecnico di Supporto al RUP per la "Fornitura in Somministrazione annuale in 58 lotti unici e indivisibili, di Carta per Apparecchiature Elettromedicali", Giusta Nota di Nomina dei componenti prot. n. 165421 del 29/10/2024, Giusta Nota di Nomina del Segretario Verbalizzante, prot. N. 185284 del 03/12/2024, nonché Giusta Convocazione prot. n. 185296 del 03/12/2024 che si allegano.

Sono presenti la Dott.ssa Valentina Impellizzeri in qualità di Presidente, le Dott.sse Roberta Ragusa e Elisa Drago in qualità di Componenti.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante l'Ass.nte Amministrativo Dott. Gianluca Ciotta.

Il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente i componenti prendono atto della documentazione fatta pervenire a questo Organo dal Settore Provveditorato con mail del 20/11/2024 e si passa all'esame della stessa.

Dopo aver visionato il Capitolato definitivo si comincia ad esaminare ciascun lotto.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda la lunghezza 25-23 mt, delle quali la misura 25 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 23 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica relativa all'articolo con cod. Ref. RDNNR080020000 è prodotta sia per lotto 3 (16 mt) che per il lotto 23 (20 mt). Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta le motivazioni che li ha indotti ad utilizzare lo stesso cod. Ref. per due lotti diversi ed eventualmente come distinguerà in sede di ordine le due misure.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 58-57 mm, delle quali la misura 58 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 57 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE				

In merito al Lotto 6 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9ck9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVIDI BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO	OK	OK	OK	

Handwritten signatures of Biocarta S.p.A. staff members, likely representing the signatures of the four companies involved in the table above.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 107-108 mm, delle quali la misura 107 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 108 mm contemporaneamente riportato sulla scheda; per quanto riguarda la lunghezza 23-25 mt, delle quali la misura 25 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 23 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	OK		

BIODIAGRAM: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede carta termica bianca e la Ditta offre carta diagrammata come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 200-300, dei quali il numero di fogli 200 è conforme al Capitolato, contrariamente al 300 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

BIODIAGRAM – CERACARTA: Le relative schede tecniche prodotte non riportano la presenza della tacca nera così come prevista dal Capitolato Tecnico. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alle Ditte l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	OK	OK		

The image shows four handwritten signatures in black ink, each consisting of a stylized initial followed by a surname. They are positioned below their respective table rows:

- A signature starting with 'G' and ending with 'B' is located under the first row (Lotto 11).
- A signature starting with 'G' and ending with 'B' is located under the second row (Lotto 12).
- A signature starting with 'G' and ending with 'P' is located under the third row (Lotto 13).
- A signature starting with 'G' and ending with 'T' is located to the right of the third row (Lotto 13).

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 300-315, dei quali il numero di fogli 300 è conforme al Capitolato, contrariamente al 315 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero di fogli in quanto da Capitolato Tecnico si chiedono 300 fogli e la Ditta offre 315 fogli come da scheda tecnica.

Vista l'ora tarda i componenti la Commissione sospendono la seduta alle ore 13.30 del giorno 04/12/2024 e concordano di riprendere i lavori alle ore 09.30 del giorno 05/12/2024.

Agrigento, 04/12/2024

Il Segretario Verbalizzante

Ass.nte Amministrativo

Dott. Gianluca Ciotta

La Commissione

Dir. Farmaciste


Dott.ssa Roberta Ragusa

Dott.ssa Elisa Drago

Il Presidente

Dir. Farmacista

Dott.ssa Valentina Impellizzeri

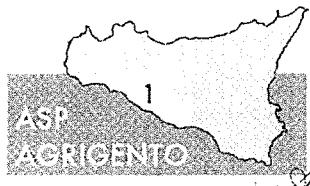

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Organo Tecnico di supporto al Rup
Gara Fornitura Carta per Apparecchiature Elettromedicali

Il giorno 05 Dicembre 2024, alle ore 09.30 presso i locali della Direzione del Dipartimento del Farmaco si insedia, come previsto dal Verbale n. 1 della presente gara redatto in data 04 Dicembre 2024, l'Organo Tecnico di Supporto al RUP per la "Fornitura in Somministrazione annuale in 58 lotti unici e indivisibili, di Carta per Apparecchiature Elettromedicali", Giusta Nota di Nomina dei componenti prot. n. 165421 del 29/10/2024, Giusta Nota di Nomina del Segretario Verbalizzante, prot. n. 185284 del 03/12/2024, nonché Giusta Convocazione prot. n. 185296 del 03/12/2024 che si allegano.

Sono presenti la Dott.ssa Valentina Impellizzeri in qualità di Presidente, le Dott.sse Roberta Ragusa e Elisa Drago in qualità di Componenti.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante l'Ass.nte Amministrativo Dott. Gianluca Ciotta.

Il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

I componenti la Commissione proseguono le operazioni d'esame del Capitolato a partire dal Lotto n. 16.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda la lunghezza 25-20 mt, delle quali la misura 25 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 20 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Inoltre si chiedono chiarimenti in merito al colore del diagramma in quanto su scheda tecnica è riportato "Diagramma (colore) Rosso/ o Bianco", mentre come da Capitolato si chiede "Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto)".

Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 142-143, dei quali il numero di fogli 142 è conforme al Capitolato, contrariamente al 143 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETTROCARDIOGRAFO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI MISURE	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di pieghe 295-297 mm formato A4, dei quali il numero 295 mm è conforme al Capitolato, contrariamente al 297 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica relativa all'articolo con cod. Ref. RDNNR080020000 è prodotta sia per lotto 3 (16 mt) che per il lotto 23 (20 mt). Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta le motivazioni che li ha indotti ad utilizzare lo stesso cod. Ref. per due lotti diversi ed eventualmente come distinguerà in sede di ordine le due misure.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

BIODIAGRAM – CERACARTA: Le relative schede tecniche prodotte non riportano la presenza della tacca nera così come prevista dal Capitolato Tecnico. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alle Ditte l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 280-250, dei quali il numero di fogli 250 è conforme al Capitolato, contrariamente a 280 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 200 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	CHIARIMENTI		

BIODIAGRAM – CERACARTA: Le relative schede tecniche prodotte non riportano la presenza della tacca nera così come prevista dal Capitolato Tecnico. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alle Ditte l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	CHIARIMENTI	OK		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 107-108 mm, delle quali la misura 108 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 107 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	CHIARIMENTI		

CERACARTA: La scheda tecnica prodotta non riporta la presenza del diagramma come da Capitolato. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

The image shows three handwritten signatures in black ink, likely belonging to the company representatives mentioned in the table above. The signatures are somewhat stylized and overlapping, making them difficult to read individually but clearly identifying the four companies: BIODIAGRAM, CERACARTA, TIOZZO, and BIOTENICA CATALANO.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 151-152 mm, delle quali la misura 151 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 152 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda il numero di fogli 160-150, dei quali il numero di fogli 150 è conforme al Capitolato, contrariamente a 160 contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 160 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 143-142 mm, delle quali la misura 143 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 142 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 143 mm e la Ditta ne offre 142 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CHIARIMENTI			

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda l'altezza 75-76 mm, delle quali la misura 75 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 76 mm contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 30 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 16 mt e la Ditta ne offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 58 mm e la Ditta ne offre 57 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE				

In merito al Lotto 46 la Commissione sospende il giudizio in merito alla conformità riservandosi di fare ulteriori approfondimenti tecnici.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica e inoltre non indica la compatibilità con il modello espressamente richiesta dal Capitolato.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 13 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	OK	OK		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CHIARIMENTI	NON CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta riporta, per quanto riguarda la larghezza 110-112 mm, delle quali la misura 110 mm è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 112 mm contemporaneamente riportato sulla scheda; per quanto riguarda la lunghezza 15-13 mt, delle quali la misura 15 mt è conforme al Capitolato, contrariamente alla mis. 13 mt contemporaneamente riportato sulla scheda. Pertanto, prima di esprimersi in merito alla conformità, si invita Codesto Provveditorato a chiedere alla Ditta l'attestazione che la carta avrà le caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico.

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 11 mt come da scheda tecnica. Inoltre il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 110 mm e la Ditta offre 112 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	OK			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	OK	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 10 mt e la Ditta ne offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK		OK

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	OK	OK	NON CONFORME	

TIOZZO: Il prodotto risulta non conforme in quanto non indica la piena compatibilità con l'apparecchiatura richiesta e la scheda tecnica è incompleta.

La Commissione sospende la seduta alle ore 18.00 del giorno 05/12/2024 incaricando il Segretario Verbalizzante di trasmettere i Verbali 1 e 2 al RUP a mezzo mail per gli atti consequenziali.

La Commissione resta in attesa dei chiarimenti richiesti per riaggiornare la seduta. Nella quale verranno riesaminati i lotti 6 e 46 e si riserva di valutare gli opportuni approfondimenti.

Il Segretario-Verbalizzante
Ass.nte Amministrativo

Dott. Gianluca Ciotta

La Commissione

Dir. Farmaciste


Dott.ssa Roberta Ragusa

Dott.ssa Elisa Drago

Il Presidente

Dir. Farmacista

Dott.ssa Valentina Impellizzeri

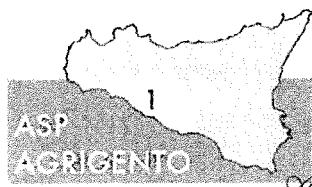

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Organo Tecnico di supporto al Rup
Gara Fornitura Carta per Apparecchiature Elettromedicali

Il giorno 04 Marzo 2025, alle ore 10.00 presso i locali della Direzione del Dipartimento del Farmaco si insedia, l'Organo Tecnico di Supporto al RUP per la "Fornitura in Somministrazione annuale in 58 lotti unici e indivisibili, di Carta per Apparecchiature Elettromedicali", Giusta Nota di Nomina dei componenti prot. n. 165421 del 29/10/2024, Giusta Nota di Nomina del Segretario Verbalizzante, prot. n. 185284 del 03/12/2024, nonché Giusta Convocazione prot. n. 37084 del 03/03/2025 che si allegano.

Sono presenti la Dott.ssa Valentina Impellizzeri in qualità di Presidente, le Dott.sse Roberta Ragusa e Elisa Drago in qualità di Componenti.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante l'Ass.nte Amministrativo Dott. Gianluca Ciotta.

Il Presidente accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

I componenti la Commissione, a seguito dei chiarimenti pervenuti per il tramite del RUP, si esprimono come segue.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	CONFORME		

BIODIAGRAM: La scheda tecnica prodotta è relativa al lotto 1.

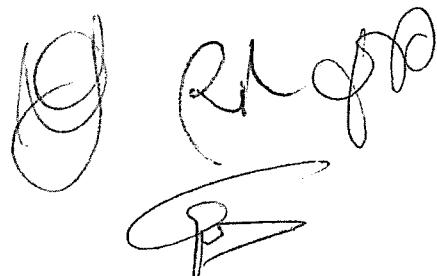

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	MEDISON CO LTD SONOACE 7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO	CONFORME	CONFORME	CONFORME	

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, followed by a large, decorative flourish at the bottom right.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 25 mt e la Ditta offre 23 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	NON CONFORME	CONFORME		

BODIAGRAM: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede carta termica bianca e la Ditta offre carta diagrammata come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5521 K; CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
14	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
15	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero di fogli in quanto da Capitolato Tecnico si chiedono 300 fogli e la Ditta offre 315 fogli come da scheda tecnica.

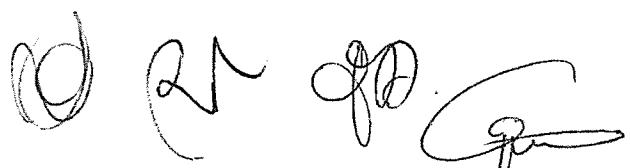

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
16	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES e CORP M SERIES	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
17	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
18	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
20	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG100L ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
21	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	CARDIOLINE ECG200+ ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
22	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
23	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
24	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
25	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
26	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
27	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 200 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
28	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
29	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
30	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
31	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
32	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
33	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
34	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
35	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
36	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
37	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
38	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBC SERIES 2 MONITOR FETALE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per il numero dei fogli in quanto da Capitolato Tecnico se ne chiedono 150 e la Ditta ne offre 160 come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
39	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD,	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
40	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
41	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
42	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 30 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
43	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
44	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 16 mt e la Ditta ne offre 20 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
45	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA,	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
46	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 20 mt e la Ditta ne offre 25 mt come da scheda tecnica e inoltre non indica la compatibilità con il modello espressamente richiesta dal Capitolato.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
48	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
49	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
50	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 13 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
51	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	CONFORME			

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
52	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta ne offre 11 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CONFORME	CONFORME		

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
54	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 15 mt e la Ditta offre 11 mt come da scheda tecnica. Inoltre il prodotto risulta non conforme per l'altezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 110 mm e la Ditta offre 112 mm come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
55	Rotoli bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE	CONFORME			


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
56	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE	CONFORME	NON CONFORME		

CERACARTA: Il prodotto risulta non conforme per la lunghezza in quanto da Capitolato Tecnico si chiede 10 mt e la Ditta ne offre 15 mt come da scheda tecnica.

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
57	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	CONFORME	CONFORME		CONFORME

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	DITTA BIODIAGRAM	DITTA CERACARTA	DITTA TIOZZO	DITTA BIOTENICA CATALANO
58	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME	


TIOZZO: Il prodotto risulta non conforme in quanto non indica la piena compatibilità con l'apparecchiatura richiesta e la scheda tecnica è incompleta.

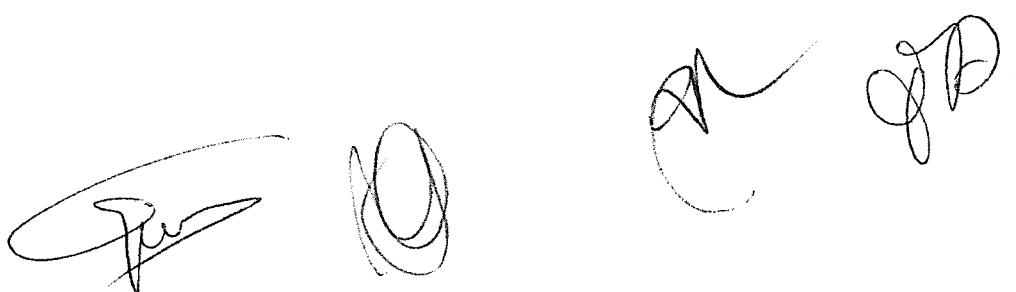


La Commissione sospende la seduta e chiude i lavori alle ore 16.30 del giorno 04/03/2025 incaricando il Segretario Verbalizzante di trasmettere il Verbale n. 3 al RUP a mezzo mail per gli atti consequenziali.

Agrigento, 04/03/2025

Il Segretario Verbalizzante
Ass.nte Amministrativo
Dott. Gianluca Ciotta

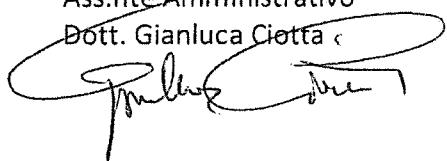



La Commissione
Dir. Farmaciste
Dott.ssa Roberta Ragusa
Dott.ssa Elisa Drago



Il Presidente
Dir. Farmacista

Dott.ssa Valentina Impellizzeri

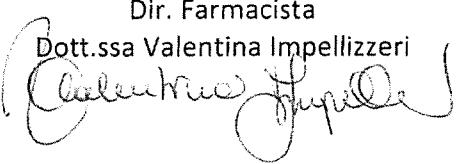A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valentina Impellizzeri".



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

➤ Immediatamente esecutiva dal 24 APR 2025

Agrigento, li 24 APR 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le Sig. DOMENICO ALAIMO
Sig.ra Sabrina Terrasi Coadiutore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi