



Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di

## AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 892 DEL 24 APR 2025

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo RdO/Mepa aperta n. 5192005, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione triennale, di "Coppie di placche per defibrillatori", installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento. Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva ed efficace.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 912 DEL 26/04/2025

Il Collab. Amm.vo  
E RUP  
(Dr. Giuseppe Palumbo)

Il Dirig. Amm.vo  
UOS Econ./Beni-Serv. non Sanitari  
(Dr.ssa Rosalia Calà)

Il Direttore UOC  
Serv. Provveditorato  
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.  C.P. 050100512

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

G.C.  
LAUREATO IN RESPONSABILE  
COL. ATTA. GIUSEPPE PICONE

SERVIZIO ECONOMICO  
IL DIRETTORE UOC SEF e P.I.  
84

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

24 APR 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 310/Serv.1% S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore UOC Servizio Provveditorato, Ing. Alessandro Dinolfo**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

**PREMESSO CHE** con Deliberazione del D. G. n. 517 del 13.03.2025:

- ✓ è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. e) D. Lgs. n. 36/2023, l'esperimento di Procedura Negoziate, a mezzo RDO/MEPA aperta, per l'affidamento della fornitura, in somministrazione triennale ed in due lotti, di "Coppie di Placche per defibrillatori" installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento, per un importo posto a base di gara di € 46.387,68 oltre opzioni ed IVA di legge, da aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- ✓ è stato approvato il documento denominato "Condizioni particolari di contratto", che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA;
- ✓ Responsabile Unico di Progetto (RUP) è stato nominato il Dr. Giuseppe Palumbo, mentre la nomina del Dec è stata differita all'adozione del presente provvedimento;
- ✓ l'onere derivante dal suddetto provvedimento, pari presuntivamente ad € 67.946,57 IVA compresa, come da seguente quadro economico:

Fornitura, in somministrazione triennale ed in due lotti, di "Coppie di Placche per defibrillatori" installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento	€ 46.387,68
Opzione ex art. 120 c. 9 (V d'Obbl.)	€ 9.277,54
IVA 22%	€ 12.246,35
Contrib. Anac	€ 35,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 67.946,57</b>

è stato imputato:

- Per € 14.148,24 IVA compresa sul Conto Economico n. C501010512 del corrente Bilancio d'esercizio (nove mesi);
- Per € 18.864,32 IVA compresa sul medesimo Conto Economico di ciascuno dei Bilanci d'esercizio 2026/2027 (ventiquattro mesi);
- Per € 16.034,68 IVA compresa sul medesimo Conto del Bilancio d'esercizio 2028 (tre mesi + opzioni);
- Per € 35,00 sul conto n. C502020199 del corrente Bilancio di esercizio;

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

**ATTESO CHE**

- ✓ in esecuzione della sopra citata Delibera a Contrarre, pubblicata in data 17.03 u.s. sul sito web aziendale, sezione Amministrazione trasparente, conformemente all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, in pari data si è avviata la RdO/MEPA aperta n. 5192005 sulla piattaforma AcquistiinretePa, con scadenza 25.03.2025;

- ✓ entro il termine utile, hanno proposto offerta alla già menzionata RdO le seguenti Società, con indicazione a latere del lotto d'interesse:

Lotto	Cig	Società	P. Iva
Lotto 01	B6123ECA2C	Bs Medical Srl	01167730355
		Stryker Italia Srl	06032681006
		Gi.Pi. Medical Srl	05261540875
		Med.Ita. Srl	04440311217
Lotto 02	B6123EDAFF	Med.Ita. Srl	04440311217
		Gi.Pi. Medical Srl	05261540875
		Tecnomed Srl	03617080878

- ✓ in data 31.03 u.s., si è provveduto all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa, verificata la quale si è reso necessario avviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 36/2023, per le Società Tecnomed Srl e Stryker Italia Srl l'istituto del soccorso istruttorio con richiesta, trasmessa tramite Sistema, di documentazione amministrativa integrativa, da queste prodotta nei termini assegnati;
- ✓ esaminata e giudicata conforme la documentazione amministrativa richiesta alle Società partecipanti e da queste prodotta, si trasmetteva la documentazione tecnica al Dirigente Medico incaricato del Giudizio di conformità che, con prot. 731/25 U del 08.04 u.s. (all. A), rendeva, per ciascun lotto e per ciascuna delle Società partecipanti, il richiesto parere di conformità/non conformità, per come in detta nota riportato e sinteticamente rappresentato nella sottostante tabella:

Lotto 01	Bs Medical Srl	Non Conforme
	Stryker Italia Srl	Conforme
	Gi.Pi. Medical Srl	Conforme
	Med.Ita. Srl	Non Conforme
Lotto 02	Med.Ita. Srl	Non Conforme
	Gi.Pi. Medical Srl	Non Conforme
	Tecnomed Srl	Conforme

- ✓ preso atto del succitato giudizio di conformità/non conformità, con prot. 60467, 60470, 60474 del 08.04 u.s. (all. B, C, D), trasmesse tramite pec e tramite Sistema, si notificava l'esclusione dal proseguo della procedura agli Operatori dichiarati non conformi;
- ✓ esaminata infine l'offerta economica dei concorrenti ammessi, si è rilevato il prezzo da questi offerto, per come di seguito riportato:

LOTTO	Ditta	OFFERTA
Lotto 01	Gi.Pi. Medical Srl	€ 21.060,00
	Stryker Italia Srl	€ 26.691,90
Lotto 02	Tecnomed Srl	€ 19.440,00

#### DATO ATTO CHE

- ✓ nei confronti della società Gi.Pi. Medical Srl, miglior offerente per il lotto n. 01, la proponente UOC ha completato la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attuate tramite FVOE in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCpass e pertanto, ai sensi dell'art. 50, c. 6, D. Lgs. 36/2023, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- ✓ nei confronti della società Tecnomed Srl la proponente UOC ha avviato tramite FVOE, in data 08/04 u.s. e successivi solleciti, la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, dei quali si

atteride ad oggi un unico riscontro e tuttavia, stante il ruolo “salvavita” del dispositivo richiesto e stante altresì l’ultravigenza dell’art. 8, comma 1, lett. a), D. L. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, disposta dall’art. 224, comma 2, lett. c) D. Lgs. 36/2023, per effetto della quale, anche dopo il 1° luglio 2023, è possibile autorizzare, ai sensi dell’articolo 32, c. 8 D. Lgs. n. 50/2016 (ora art. 17 c. 8 D. Lgs. 36/2023), “..., nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti...”, con espressa riserva di procedere all’eventuale revoca della presente aggiudicazione, nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell’aggiudicatario diano esito infausto per lo stesso ed, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

- ✓ l’invio delle comunicazioni prescritte dall’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., è garantito anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli art. 27 e 28 D. Lgs. 36/2023;

#### RITENUTO CHE

- ✓ risulta pertanto necessario proporre l’aggiudicazione della RdO/Mepa n. 5192005 per l’affidamento della fornitura, in somministrazione triennale ed in due lotti, di “Coppie di Placche per defibrillatori” installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell’ASP di Agrigento, alle condizioni indicate nel documento denominato “Condizioni particolari di contratto” e nelle offerte prodotte (all. E, F), per come segue:
  - lotto n. 01, all’Operatore Economico Gi.Pi. Medical Srl, avente sede legale in Via Gabriele D’Annunzio, 158, 95127 Catania, p. IVA e cod. fisc. 05261540875, per l’importo complessivo di € 21.060,00 oltre opzioni ed IVA di legge;
  - lotto n. 02, all’Operatore Economico Tecnomed srl con sede a Tremestieri Etneo (CT), Via Pietra dell’Ova 404/A, P.IVA e Cod. Fisc. 03617080878, per l’importo complessivo di € 19.440,00 oltre opzioni ed IVA di legge;
- ✓ l’onere derivante dal presente atto, come da sottostante quadro economico, rimodulato rispetto a quello elaborato in sede di indizione, ammontante a € 59.327,00 compresa IVA, come da seguente quadro economico:

Fornitura, in somministrazione triennale ed in due lotti, di “ <i>Coppie di Placche per defibrillatori</i> ” installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell’ASP di Agrigento	€ 40.500,00
Opzione ex art. 120 c. 9 (V d’Obbl.)	€ 8.100,00
IVA 22%	€ 10.692,00
Contrib. Anac	€ 35,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.327,00</b>

venga imputato:

- Per € 10.980,00 IVA compresa sul Conto Economico n. C501010512 del corrente Bilancio d’esercizio (otto mesi);
- Per € 16.470,00 IVA compresa sul medesimo Conto Economico di ciascuno dei Bilanci d’esercizio 2026/2027 (ventiquattro mesi);
- Per € 15.372,00 IVA compresa sul medesimo Conto del Bilancio d’esercizio 2028 (quattro mesi + opzioni);
- Per € 35,00 sul conto n. C502020199 del corrente Bilancio di esercizio;

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall’esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell’effettiva risultanza di gara;

- ✓ di dover nominare, ai sensi art. 114, c. 1 D. Lgs 36/2023 e per ragioni concernenti l'organizzazione interna di questa Stazione Appaltante, che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse dai soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 2 All. II.14 D. Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dr. G. Misuraca, Direttore Centrale Operativa S.U.E.S.118;

**PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- ✓ **APPROVARE** le operazioni di gara telematica, di cui alla RdO/MePa n. 5192005 per l'affidamento della fornitura, in somministrazione triennale ed in due lotti, di “Coppie di Placche per defibrillatori” installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento, per come in premessa riportato;
- ✓ **AGGIUDICARE**, alle condizioni indicate nel documento denominato “Condizioni particolari di contratto” e nelle offerte prodotte, la RdO/MePa n. 5192005 di cui all'oggetto per come segue:
  - o lotto n. 01, all'Operatore Economico Gi.Pi. Medical Srl, avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio, 158, 95127 Catania, p. IVA e cod. fisc. 05261540875, per l'importo complessivo di € 21.060,00 oltre opzioni ed IVA di legge;
  - o lotto n. 02, all'Operatore Economico Tecnomed srl con sede a Tremestieri Etneo (CT), Via Pietra dell'Ova 404/A, P.IVA e Cod. Fisc. 03617080878, per l'importo complessivo di € 19.440,00 oltre opzioni ed IVA di legge;
- ✓ **PRENDERE ATTO** che nei confronti della società Gi.Pi. Medical Srl, miglior offerente per il lotto n. 01, essendo state completata la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attuate tramite FVOE in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, è possibile, ai sensi dell'art. 50, c. 6, D. Lgs. 36/2023, procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- ✓ **PRENDERE ATTO** che nei confronti della società Tecnomed Srl, unica offerente giudicata conforme per il lotto n. 02, la proponente UOC ha avviato tramite FVOE, in data 08/04 u.s. e successivi solleciti, la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, per i quali si attende ad oggi un solo riscontro e tuttavia, stante il ruolo “salvavita” del dispositivo richiesto e stante altresì l'ultravigenza dell'art. 8, comma 1, lett. a), D. L. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, disposta dall'art. 224, comma 2, lett. c) D. Lgs. 36/2023, per effetto della quale, anche dopo il 1° luglio 2023, è possibile autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, c. 8 D. Lgs. n. 50/2016 (ora art. 17 c. 8 D. Lgs. 36/2023), “..., nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti...”, con espressa riserva di procedere all'eventuale revoca della presente aggiudicazione, nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicatario diano esito infausto per lo stesso e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- ✓ **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente provvedimento, rimodulato rispetto a quello elaborato in sede di indizione, ammonta a € 59.327,00 compresa IVA, come da seguente quadro economico:

Fornitura, in somministrazione triennale ed in due lotti, di “Coppie di Placche per defibrillatori” installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento	€ 40.500,00
Opzione ex art. 120 c. 9 (V d'Obbl.)	€ 8.100,00
IVA 22%	€ 10.692,00
Contrib. Anac	€ 35,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.327,00</b>

venga imputato:

- o Per € 10.980,00 IVA compresa sul Conto Economico n. C501010512 del corrente Bilancio d'esercizio (otto mesi);

- Per € 16.470,00 IVA compresa sul medesimo Conto Economico di ciascuno dei Bilanci d'esercizio 2026/2027 (ventiquattro mesi);
  - Per € 15.372,00 IVA compresa sul medesimo Conto del Bilancio d'esercizio 2028 (quattro mesi + eventuali opzioni);
  - Per € 35,00 sul conto n. C502020199 del corrente Bilancio di esercizio;
- ✓ **NOMINARE**, ai sensi art. 114, c. 1 D. Lgs 36/2023 e per ragioni concernenti l'organizzazione interna di questa Stazione Appaltante, che impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse dai soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 2 All. II.14 D. Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dr. G. Misuraca, Direttore Centrale Operativa S.U.E.S.118;
- ✓ **AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con le Società aggiudicatarie, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 D. Lgs. 36/2023;
- ✓ **CHE** l'esecuzione della presente Deliberazione verrà curata dal Servizio proponente nonché dalle competenti Farmacie Ospedaliere, ciascuno per la parte di propria competenza;
- ✓ **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità agli art. 27 e 28 D. Lgs. 36/2023;
- ✓ **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
- ✓ **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per consentire alle UU.OO. destinataria l'immediata fruizione dei dispositivi *de quo*.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore-UOC Servizio Provveditorato

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorabile  
Data 24/04/2025

Parere ASSENTE  
Data

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggio

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo ~~e dal Direttore Sanitario~~ 

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Provveditorato.


### IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci

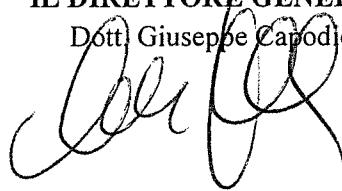

### Il Segretario verbalizzante

COLLABORATORE AMM.VO TPC  
"Ufficio Stile - Controllo di Gestione"  
  
Teresa Cingue





**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato della Salute  
A.S.P. di Caltanissetta  
**Centrale Operativa S.U.E.S. 118**  
**CALTANISSETTA**  
Direttore Dott. Giuseppe Misuraca  
Tel. 0934/595988 – 563005 FAX 0934/557073  
E-mail [centrale118@asp.cl.it](mailto:centrale118@asp.cl.it)  
PEC [centrale118@pec.asp.cl.it](mailto:centrale118@pec.asp.cl.it)



Prot. n° 731/25 U

Caltanissetta 08/04/2025

*Aee A*

AL UOC Servizio Provveditorato

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett e) D.Lgs. 36/2023, a mezzo RdO/Mepa aperta, per l'affidamento della fornitura, in somministrazione triennale ed in due lotti, di "Coppie di Placche per defibrillatori" installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento. Parere di conformità tecnica**

Facendo seguito alla Vostra mail del 31/03/2025, dopo avere esaminato le schede tecniche, con le relative caratteristiche dei prodotti offerti dai diversi Operatori Economici che hanno partecipato all' Indagine di Mercato, RdO n. 5192005, si esprime la seguente valutazione tecnica di parere di conformità:

#### **Lotto 1**

##### **a) Ditta BS Medical:**

- 1) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico
  - 1.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.
  - 1.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

*[Signature]*

2) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

2.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

2.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

3) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

3.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

3.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

4) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

4.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

4.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

b) Ditta GI.PI. Medical s.r.l.:

1) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto, Marca FIAB mod. F7952W, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

2) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto, Marca FIAB mod. F7952W, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

3) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto, Marca FIAB mod. F7952PL, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato

tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

4) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca FIAB mod. F7752P, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

c) Ditta Med.Ita s.r.l:

1) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

1.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

1.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

2) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

2.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

2.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

3) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

3.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

3.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

4) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

4.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15



scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

4.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

**d) Ditta Stryker Italia s.r.l.:**

1) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto originale offerto, Marca Stryker mod. Quick-Combo electrodes with redi-pack pre-connect system, Cod. 11996-000017 soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

2) Piastre monouso **ADULTI** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto originale offerto, Marca Stryker mod. Quick-Combo electrodes with redi-pack pre-connect system, Cod. 11996-000017, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

3) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto originale offerto, Marca Stryker mod. Electassy -AED Infantchild reduced energy-ww, Cod. 11101-000016, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

4) Piastre monouso **PEDIATRICHE** compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto originale offerto, Marca Stryker mod. Electrode-EDGE, PED, QC RTS, INTL, Cod. 11996-000093, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

**Lotto 2**

**a) Ditta GI.PI. Medical s.r.l.:**

1) Piastre monouso **ADULTI** multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto, Marca FIAB mod. F7952, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

2) Piastre monouso pediatriche con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto, Marca FIAB mod. F7952P, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, solo per Reanibex 800, mentre non risulta compatibile con Reanibex 300 pertanto il prodotto viene ritenuto **non conforme**;

**b) Ditta Med. Ita. s.r.l.:**

1) Piastre monouso **ADULTI** multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto

funzionalmente equivalente offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

1.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

1.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;

2) Piastre monouso pediatriche con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

2.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

2.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto **non conforme**;


c) Ditta TECNOMED s.r.l.:

1) Piastre monouso **ADULTI** multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto originale offerto, Marca Bexen Cardio mod. TKL0311D, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**;

2) Piastre monouso pediatriche con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto originale offerto, Marca Bexen Cardio mod. KSA0501D, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, pertanto il prodotto viene ritenuto **conforme**.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

ASP di Campania  
Distr. Osp. CL 11 Prosecco S. Biagio  
Direttore U.O.C. Centrale Operativa 118  
Bott. Giacomo Misuraca  
Cod. ENPA 00300276471P  
Kct-Osp. Medici CL 1501

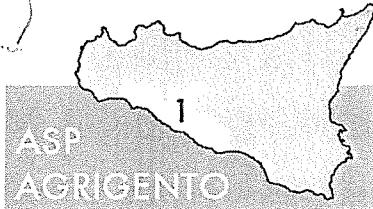

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 60467 del 08-04-2025

AQ. B

Spett. BS Medical srl  
bsmedicalsr@postepec.eu

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo RdO/Mepa aperta N. 5192005, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione triennale, di "Coppie di placche per defibrillatori", installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento.

Notifica esclusione lotto n. 01 (CIG: B6123ECA2C)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, c. 1 lett. d) D. Lgs. 36/2023, si comunica che l'offerta tecnica prodotta da codesta Ditta per i lotti in oggetto indicati, è stata giudicata non conforme dal Dirigente medico incaricato per la seguente motivazione:

Lotto 1

1) Piastre monouso ADULTI compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

1.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

1.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

2) Piastre monouso ADULTI compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

2.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

2.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

3) Piastre monouso PEDIATRICHE compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

3.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

3.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

4) Piastre monouso PEDIATRICHE compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

4.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

4.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

Codesta Società viene pertanto esclusa dalla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica relativamente ai lotti sopra indicati.


Distinti saluti

Il Collab. Amm. e RUP  
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U O S ECON-ACQUISIZIONE  
BENI/SERVIZI NON SANITARI  
DOTT.SSA ROSALIA CALA'

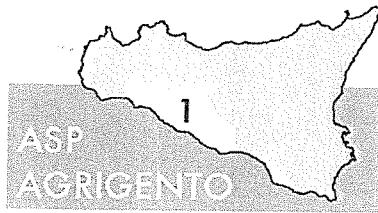

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 60170 del 08.04.2025

*Adde. C*

Spett. Gi.Pi. Medical s.r.l.  
gipimrdicalsrl@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo RdO/Mepa aperta N. 5192005, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione triennale, di "Coppie di placche per defibrillatori", installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento.

Notifica esclusione lotto n. 02 (CIG: B6123EDAFF)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, c. 1 lett. d) D. Lgs. 36/2023, si comunica che l'offerta tecnica prodotta da codesta Ditta per i lotti in oggetto indicati, è stata giudicata non conforme dal Dirigente medico incaricato per la seguente motivazione:

- 1) Piastre monouso ADULTI multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto, Marca FIAB mod. F7952, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico; pertanto, il prodotto viene ritenuto conforme;
- 2) Piastre monouso pediatriche con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto, Marca FIAB mod. F7952P, soddisfa i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico, solo per Reanibex 800, mentre, non risulta compatibile con Reanibex 300 pertanto il prodotto viene ritenuto non conforme;

Codesta Società viene pertanto esclusa dalla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica relativamente ai lotti sopra indicati.

Distinti saluti

Il Collab. Amm. e RUP  
Dr. Giuseppe Palumbo

*Dr. Palumbo*

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.S. ECON-ACQUISIZIONE  
BENI/SERVIZI NON SANITARI  
DOTTSSA ROSALIA CALA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 60471 del 08-04-2023

All. D

Spett. Med.Ita. Srl  
meditasrl@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mezzo RdO/Mepa aperta N. 5192005, per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione triennale, di "Coppie di placche per defibrillatori", installati a bordo dei mezzi di soccorso del S.U.E.S. 118, operanti nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento.

Notifica esclusione lotto n. 01 (CIG: B6123ECA2C)

Notifica esclusione lotto n. 02 (CIG: B6123EDAFF)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, c. 1 lett. d) D. Lgs. 36/2023, si comunica che l'offerta tecnica prodotta da codesta Ditta per i lotti in oggetto indicati, è stata giudicata non conforme dal Dirigente medico incaricato per la seguente motivazione:

Lotto 1

1) Piastre monouso ADULTI compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

1.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

1.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

2) Piastre monouso ADULTI compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

2.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

2.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

3) Piastre monouso PEDIATRICHE compatibili con defibrillatore Lifepack 500/1000 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

3.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

3.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

4) Piastre monouso PEDIATRICHE compatibili con defibrillatore Lifepack 15 marca Medtronic/Phisyo-Control: Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico;

4.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

4.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C.

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme.

#### Lotto 2

1) Piastre monouso ADULTI multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto-funzionalmente equivalente offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-1015, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

1.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50x360J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

1.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

2) Piastre monouso pediatriche con sistema di riduzione energia, per bambini inferiori agli 8 anni o peso inferiore a 25 kg, multifunzione, per defibrillazione, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECO, compatibili con defibrillatore REANIBEX 300/800 marca Bexen Cardio: Il prodotto funzionalmente equivalente offerto Il prodotto offerto, Marca Desfi-Dormo mod. EDC-P115, non soddisfa i seguenti requisiti richiesti nel Capitolato tecnico

2.1 Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 25x100J. Il prodotto offerto resiste fino a 15 scariche consecutive di defibrillazione a 360 J.

2.2 Intervallo di temperature di esercizio da 0°C a 50°C. Il prodotto offerto presenta un intervallo di temperatura da 5°C a 35°C

Pertanto, il prodotto offerto viene ritenuto non conforme;

Codesta Società viene pertanto esclusa dalla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica relativamente ai lotti sopra indicati.

Distinti saluti

Il Collab. Amm. e RUP  
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.S./ECON-ACQUISIZIONE  
BENI/SERVIZI NON SANITARI  
DOTT. ROSALIA CALA

*Alle. €*

Offerta Economica relativa a

**Descrizione** Placche per defibrillatori ambulanze SUES118 Asp Agrigento**RdO nr.** 5192005**Numero lotto** 1

Amministrazione titolare del procedimento

**Nome ente** AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**Ufficio** SERVIZIO PROVVEDITORATO**Codice Fiscale** 02570930848 **Codice univoco ufficio IPA** Non presente**Indirizzo sede** Viale della vittoria, 321**Città** Agrigento**Recapito telefonico** +390922407407**Email** alessandro.dinolfo@aspag.it**Punto Ordinante** ALESSANDRO DINOLFO

Concorrente

**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

GI.PI. MEDICAL SRL

**Partita IVA**

05261540875

**Tipologia societaria**

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

**DESCRIZIONE**

Prezzo Offerto

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Prezzo offerto	21060

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta Economica relativa a

**Descrizione** Placche per defibrillatori ambulanze SUES118 Asp Agrigento

*Ad F*

RdO nr. 5192005

Numero lotto 2

Amministrazione titolare del procedimento

**Nome ente** AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**Ufficio** SERVIZIO PROVVEDITORATO

**Codice Fiscale** 02570930848 **Codice univoco ufficio IPA** Non presente

**Indirizzo sede** Viale della vittoria, 321

**Città** Agrigento

**Recapito telefonico** +390922407407

**Email** alessandro.dinolfo@aspag.it

**Punto Ordinante** ALESSANDRO DINOLFO

Concorrente

**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

tecnomed srl

**Partita IVA**

03617080878

**Tipologia societaria**

Società a responsabilità limitata (SRL)

**Oggetto dell'Offerta****DESCRIZIONE**

Prezzo offerto

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Prezzo offerto	19440

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47942078	Data richiesta	24/02/2025	Scadenza validità	24/06/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GI.PI.MEDICAL SRL SOCIO UNICO
Codice fiscale	05261540875
Sede legale	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 158 95127 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line


Numero Protocollo	INPS_44934203	Data richiesta	05/03/2025	Scadenza validità	03/07/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOMED S.R.L.
Codice fiscale	03617080878
Sede legale	VIA PIETRA DELL'OVA 404/A TREMESTIERI ETNEO CT 95030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.  
 I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_


## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

~~Immediatamente esecutiva dal 24 APR 2025~~

Agrigento, li 24 APR 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

  
Sig. DOMENICO ALAIMO  
Coordinatore Amministrativo

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi