

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 159 DEL 29.01.2026

OGGETTO: Dichiarazione procedura di gara deserta RDO N. 5785931 del 06/11/2025 ed indizione nuova Procedura negoziata aperta RDO MePA per la fornitura di "strumentario chirurgico" (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc) necessario per l'avvio dell'attività di Chirurgia Vascolare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs.36/2023 - Approvazione atti di gara ed autorizzazione a contrarre -

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 133 DEL 22-1-2026

Il Funzionario Istruttore

Collaboratore Amministrativo P.le
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

Il Direttore E.F. U.O.C Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.
P. N. 6990/2026

() Autorizzazione n. del

C.E. C.P.

A101020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 27.01.2026

L'anno duemilaventisei il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Provveditorato Dott.ssa Rosalia Calà

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020

PREMESSO CHE:

- con delibera n.2243 del 03/11/2025, custodita agli atti, è stata autorizzata l'indizione della Procedura negoziata MePA per la fornitura di " strumentario chirurgico" (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc) necessario per l'avvio dell'attività di Chirurgia Vascolare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs.36/2023 "importo a base d'asta € 215.000,00"
- in data 06/11/2025 si è proceduto alla creazione della Procedura negoziata RDO MePA n. 5785931
- in pari data sul sito aziendale di questa A.S.P. di Agrigento – www.aspag.it è stato reso noto a tutti gli Operatori Economici interessati, l'avviso di pubblicazione gara su MePA , come da nota che si allega al presente atto;
- entro il termine di scadenza fissato nella RDO n. 5785931 del 06/11/2025, (20/11/2025), hanno presentato offerta, custodite agli atti, le società come di seguito si indicano:
 - 1) Altea Srl
 - 2) Axosan
 - 3) Lepè Srl
- previa verifica della documentazione amministrativa richiesta, risultata regolare, si è proceduto quindi, a verificare la presenza della documentazione tecnica di gara di ogni partecipante a seguito di tale verifica si è proceduto ad escludere la società Altea Srl, per mancata presentazione della documentazione tecnica (schede tecniche) alla sopracitata società, a mezzo MePA è stata data la comunicazione di esclusione con la seguente motivazione (mancata presentazione di schede tecniche)
- con nota e-mail del 25/11/2025 si è proceduto a trasmettere all'organo tecnico di supporto al Rup - Dr. Salvatore Alberto Turiano - Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento - la documentazione tecnica presentata dalle società Axosan e Lepè Srl per la necessaria valutazione, circa la corrispondenza con quanto richiesto giusto capitolato tecnico come da nota del 16/10/2025;
- con nota e-mail del 01/12/2025, che si allega al presente atto, il Dr. Salvatore Alberto Turiano - Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento – ha trasmesso apposita relazione tecnica, dichiarando con parere circostanziato la non conformità tecnica delle schede tecniche presentate dalle società Axosan e Lepè Srl;
- in data 12/12/2025, a mezzo MePA, alle società Axosan e Lepè Srl è stata data la comunicazione di esclusione per non conformità tecnica, giuste motivazioni di cui alla relazione inviata con e- mail del 01/12/2025, dal Dr. Salvatore Alberto Turiano - Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento -;
- la società Lepè Srl in data 29/12/2025, in merito alla comunicazione di non conformità tecnica ha presentato una nota di osservazioni proponendo soluzioni alternative circa le voci di cui al lotto unico, per le quali è stata data la non conformità tecnica e la stessa, in data 08/01/2026, è stata inoltrata al Dr. Salvatore Alberto Turiano nella qualità, con invito, alla luce delle osservazioni presentate dalla società Lepè Srl di confermare e/ modificare il capitolato tecnico relativo all'acquisto di che trattasi nella considerazione del fatto che avrebbe dovuto essere indetta nuova procedura di gara, stante che quella indetta con la RDO 5785931 del 06/11/2025 è andata deserta per offerta tecnica non valida,
- in data 12/01/2026 alla società Lepè Srl, a mezzo MePA, è stata riconfermata l'esclusione per non conformità tecnica, giuste motivazioni comunicate con e - mail del 12/12/2025, comunicando al

- contempo che ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 36/2023 non possono essere prese in considerazione soluzioni alternative;
- con nota e-mail 08/01/2026, che si allega alla presente, il Dr Turiano, ha confermato il capitolato tecnico relativo alla procedura di che trattasi, già in precedenza trasmesso con nota e-mail del 16/10/2025;

DATO ATTO:

- che la Procedura negoziata per la fornitura di "strumentario chirurgico" (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc) necessario per l'avvio dell'attività di Chirurgia Vascolare indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs.36/2023 "importo a base d'asta € 215.000,00 giusta RDO MePA n. 5785931 del 06/11/2025 è andata deserta per mancanza di offerte valide;

RITENUTO:

- necessario al fine di non pregiudicare l'avvio delle attività di Chirurgia Vascolare procedere all'indizione di nuova Procedura negoziata a mezzo di RDO MePA, per l'acquisto della fornitura di "Strumentario Chirurgico (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc)" ai sensi dell'art dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs 36/2023, criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate ovvero le cui condizioni sono definite dal mercato per la durata di anni uno;

CHE:

- a tal fine sono stati redatti i seguenti atti:
 - ✓ capitolato tecnico
 - ✓ lettera invito
 - ✓ allegato "A" prospetto per la formulazione dell'offerta economica
- in ragione della tipologia della fornitura richiesta l'appalto è costituito da un unico lotto per un importo complessivo a base d'asta in € 215.000,00 IVA esclusa, + € 4.300,00 2% di competenze interne di funzioni tecniche ex art 45 del D.lgs. 36/2023 di cui
 - ✓ € 0,40 ex art 45 Dlgs36/2023 (quota fondo innovazione) pari ad € 860,00
 - ✓ € 1,60 ex art 45 Dlgs36/2023 (funzioni tecniche) pari ad € 3.440,00
 - ✓ € 292,40 IRAP (8,5% sulle funzioni tecniche)
- che la base d'asta per l'acquisto di che trattasi pari a € 215.000,00 IVA esclusa, è stata determinata, sulla base delle offerte pervenute a seguito di consultazione preliminare di mercato, giusta nota prot.n.122461 del 30/07/2025 custodita agli atti;
- l'onere scaturente dall'adozione del presente provvedimento ammonta presuntivamente e complessivamente in € 266.600,00 IVA compresa e che lo stesso dovrà essere imputato ai conti economici ed esercizio finanziario come di seguito si indica:
 - ✓ € 262.300,00 al Conto economico C A101020501 bilancio d'esercizio 2026
 - ✓ € 4.300,00 al Conto economico C 516040605 e P 202050601 bilancio d'esercizio 2026
 - ✓ € 292,40 al Conto economico C901010101 per IRAP bilancio d'esercizio 2026
- con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale interessato ex art 45 del D.lgs. 36/2023 e ss mm. ii. e nel rispetto del regolamento aziendale come da ordine di servizio prot. n.169519 del 30/10/205, custodito agli atti;

ANNULLARE:

- l'impegno di spesa pari ad € 4.300,00 (somma determinata nella misura del 2% quali competenze interne di funzioni tecniche ex art. 45 del D.lg.s. 36/2023) assunto con delibera 2243 del 03/11/2025 P.N. 174935/25 – bilancio 2025 -

RITENUTO:

- di dover nominare ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 responsabile unico del progetto la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C.) - punto istruttore Consip/MePA;

- di individuare, altresì, quale direttore esecutivo del contratto (DEC) il Dr. Salvatore Alberto Turiano - Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento, come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art. 8 comma 4 all.to 1.2. e dall'art. 32 commi 2e3 all.to II.14 del D.lgs. 36/2023 “per ragioni concernenti l’organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento “;

PROPONE

Per le argomentazioni esposte in premessa che si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Dare atto che con nota e-mail del 01/12/2025, allegata al presente atto, il Dr. Salvatore Alberto Turiano - Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento – ha trasmesso apposita relazione tecnica, dichiarando con parere circostanziato la non conformità tecnica delle schede tecniche presentate dalle società Axosan e Lepè Srl;
- 2) Dare atto che con nota e- mail 08/01/2026, il Dr. Salvatore Alberto Turiano - Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento, ha confermato il capitolato tecnico relativo alla procedura di che trattasi, già in precedenza trasmesso con nota e-mail del 16/10/2025,
- 3) Dichiarare deserta per mancanza di offerte valide la Procedura negoziata MePA per la fornitura di” strumentario chirurgico” (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc) necessario per l’avvio dell’attività di Chirurgia Vascolare indetta ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs.36/2023 “importo a base d’asta € 215.000,00 giusta RDO MePA n. 5785931 del 06/11/2025
- 4) Autorizzare nuova Procedura Negoziata aperta RDO MePA per l’acquisto di “Strumentario Chirurgico (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc)” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 108 comma 3 del D.lgs 36/2023, criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate ovvero le cui condizioni sono definite dal mercato e per la durata di anni uno
- 5) Dare atto che l’appalto è costituito da un unico lotto
- 6) Di approvare i seguenti atti:
 - ✓ capitolato tecnico
 - ✓ lettera invito
 - ✓ allegato “A” prospetto per la formulazione dell’offerta economica
- 7) Dare atto che l’onere scaturente dall’adozione del presente provvedimento ammonta presuntivamente e complessivamente in € 266.600,00 IVA compresa e che lo stesso dovrà essere imputato ai conti economici ed esercizio finanziario come di seguito si indica:
 - ✓ € 262.300,00 al Conto economico C A101020501 bilancio d’esercizio 2026 a valere sui fondi di economia per investimenti
 - ✓ € 4.300,00 al Conto economico C 516040605 e P 202050601 bilancio d’esercizio 2026
 - ✓ € 292,40 al Conto economico C901010101 per IRAP bilancio d’esercizio 2026
- 8) Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale interessato ex art 45 del D.lgs. 36/2023 e ss mm. ii. e nel rispetto del regolamento aziendale come da ordine di servizio prot. n.169519 del 30/10/205, custodito agli atti;
- 9) Dare mandato al SEF di annullare l’impegno di spesa pari ad € 4.300,00 (somma determinata nella misura del 2% quali competenze interne di funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023) assunto con delibera 2243 del 03/11/2025 P.N. 174935/25 – bilancio 2025 -
- 10) Di nominare ai sensi dell’art.15 del D. lgs 36/2023 responsabile unico del progetto la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C.) - punto istruttore Consip/MePA
13) Di nominare, altresì, quale direttore esecutivo del contratto (DEC) 2025 il Dr. Salvatore Alberto Turiano - Direttore della UOC Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento, come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall’art. 8 comma 4 all.to 1.2. e dall’art. 32 commi 2e3 all.to II.14 del D.lgs.

36/2023 "per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

- 12) Dare atto che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse.
- 13) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato, ed il S.E.F. ognuno per le proprie competenze;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

DichiaraRE IL PRESENTE ATTO UBBIAMENTE ESECUTIVO
IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott.ssa Rosalia Calà

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere FAVORABILE

Data 29/01/2026

Parere Favorabile

Data 29/01/2026

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Rosalia Riggio

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore F.F. della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore F.F. della U.O.C. Provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci

IL SEGR^ETARIO VERBALIZZANTE

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Sistemi di Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque





Outlook

R: Trasmissione schede tecniche - fornitura ferri chirurgici- RDO n. 5785931

Da: Salvatore Alberto Turiano <salvatore.turiano@aspag.it>

Data: Lun 1/12/25 12:01

A: Giusy Petrucci <giusy.petrucci@aspag.it>; Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

✉ 1 allegato (1 MB)

Lotti ch. vasc..pdf;

Spett.le Provveditorato
Dr.ssa Calà
Dr.ssa Petrucci

Invio, in allegato, parere circostanziato circa la corrispondenza tecnica delle schede fornite, al capitolato ferri chirurgici per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare.
Cordiali Saluti.

Da: Giusy Petrucci <giusy.petrucci@aspag.it>

Inviato: martedì 25 novembre 2025 10:12

A: Salvatore Alberto Turiano <salvatore.turiano@aspag.it>; Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

Oggetto: Trasmissione schede tecniche - fornitura ferri chirurgici- RDO n. 5785931

Buongiorno,
con riferimento alla RDO in oggetto si trasmettono le schede tecniche presentate dalle società concorrenti come di seguito si indica, al fine di verificare la corrispondenza tecnica con quanto richiesto da capitolato.
1) società Axsosan
2) Lepè srl

Gentile dr.ssa G. Petrucci,

dopo attenta revisione delle schede tecniche presentate dalle società concorrenti come da allegati forniti in data 25-11-2025 si fornisce il parere conseguente:

- 1) La scheda tecnica fornita dalla **ditta Axosan** è semplicemente l'elenco degli strumenti in capitolato della ditta produttrice Aesculap senza alcun riferimento ai lotti di inventario, inoltre tale scheda viene inoltrata, senza alcun apparente motivo, in triplice copia. Non è possibile esprimere alcuna valutazione.
- 2) Le schede fornite dalla **ditta Lepè** facenti capo alle ditte produttrici: Aesculap, Reda, Scanlan e Codman facenti riferimento dettagliato ai lotti oggetto di richiesta del capitolato il parere di congruità si articola come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Q.tà
1	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 45° 18 cm. CONFORME	6
2	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 60° 18 cm. CONFORME	6
3	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 90° 18 cm. CONFORME	2
4	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 130° 18 cm. CONFORME	4
5	Forbici di Mayo SuperEdge da dissezione curve 23 cm. NON CONFORME	8
6	Forbici di Mayo-Stille rette 17 cm. CONFORME	8
7	Forbici di Mayo-Stille curve 17 cm. CONFORME	8
8	Forbici Metzenbaum curve 18 cm. CONFORME	10
9	Forbici Metzenbaum curve 23 cm. CONFORME	8
10	Forbici di Klinkenberg curve a "S" cm. 23 CONFORME	2
11	Forbici taglia filo metallico in tungsteno 12,5 cm. CONFORME	2
12	Pinza vascolare di DeBakey morso 1,6mm. 20 cm. CONFORME	4
13	Pinza vascolare di DeBakey morso 2mm. 20 cm. CONFORME	10
14	Pinza vascolare di DeBakey morso 2mm. 24 cm. CONFORME	4
15	Pinza chirurgica denti 1x2 18 cm. CONFORME	8
16	Pinza chirurgica di Resano 23 cm. CONFORME	6
17	Pinza emostatica di Pean curva 24 cm. CONFORME	6
18	Pinza emostatica Halstead-Mosquito curva 12 cm. CONFORME	30
19	Pinza emostatica di Crile curva 16 cm. CONFORME	16
20	Pinza passafili di Mixter 18 cm. NON CONFORME	8
21	Pinza passafili di Mixter 22 cm. NON CONFORME	4
22	Pinza di O'Schagnessy a "L" 20 cm. CONFORME	4
23	Pinza di O'Schagnessy curva 22 cm. CONFORME	2
24	Pinza di Guion-Stille 23 cm. CONFORME	2
25	Pinza Foerster anelli grandi zigrinati retta 25 cm. CONFORME	4
26	Pinza Foerster anelli piccoli zigrinati retta 24 cm. CONFORME	4
27	Pinza pressa-tubi di Mayo 18 cm. CONFORME	4
28	Pinza di Allis morso atraumatico 25 cm. CONFORME	4
29	Fermateli di Backhaus 13 cm. CONFORME	10
30	Uncino di Crile smusso angolato a 90° 21 cm. CONFORME	4
31	Microportaaggi di Jacobson con arresto a punte medie tungsteno 18 cm NON CONFORME	8
32	Microportaaggi con arresto a punte fini retto per ago 6/0 con punte diamantate 18 cm CONFORME	8
33	Microportaaggi con arresto a punte fini retto per ago 7/0 con punte diamantate 21 cm CONFORME	4


34	Portagli di Debakey Magnagrip diamantato 20 cm.	0
35	Portagli di Hegar in tungsteno 20 cm. CONFORME	12
36	Portagli di Hegar in tungsteno 25 cm. CONFORME	4
37	Portagli di Debakey in tungsteno 18 cm. CONFORME	4
38	Portagli di Debakey in tungsteno 20 cm. CONFORME	12
39	Portagli di Debakey in tungsteno 25 cm. CONFORME	4
40	Pinza Debakey x aneurisma aortico morso 7,5cm 27cm CONFORME	2
41	Pinza sgorbia Stille-Luer 3 art. curva 22 cm. CONFORME	2
42	Pinza tagliente Stille-Liston 3 art. curva 26 cm. CONFORME	2
43	Tenaglia di Semb per ossa morso angolato 20 cm. CONFORME	2
44	Costotomo di Stille-Giertz 25 cm. CONFORME	2
45	Periostotomo costale Doyen per adulti destro 17 cm. CONFORME	2
46	Periostotomo costale Doyen per adulti sinistro 17 cm. CONFORME	2
47	Periostotomo Maurer retto 12mm. 26 cm. CONFORME	2
48	Periostotomo Maurer molto curvo 12mm. 26 cm. CONFORME	2
49	Cucchiaio di Volkmann-Collin 19 cm. CONFORME	4
50	Clamp Cooley atraumatico retto 22,5 cm CONFORME	4
51	Clamp Cooley atraumatico retto 27 cm CONFORME	4
52	Clamp Debakey morso ang. a 60° da 40mm. 23 cm. CONFORME	4
53	Clamp Debakey morso ang. a 60° da 65mm. 25 cm. CONFORME	4
54	Clamp Debakey per occlusione tangenziale 35mm. 19,5 cm. CONFORME	4
55	Clamp Debakey per occl tangenziale 48mm. 26 cm. CONFORME	4
56	Clamp di Cooley morso angolato per arteria iliaca 25cm CONFORME	4
57	Clamp di Cooley per femorale angolata a 30° 17 cm. CONFORME	4
58	Clamp di Cooley per femorale angolata a 60° 16 cm. CONFORME	4
59	Clamp di Derra morso fine, piccolo 16 cm. CONFORME	4
60	Clamp di Derra morso fine, medio 17cm. CONFORME	4
61	Clamp di Derra morso fine, grande 18 cm. CONFORME	4
62	Clamp di Satinsky morso da 54 mm lunghezza 26,5 cm CONFORME	3
63	Clamp di Satinsky morso da 58 mm lunghezza 27,5 cm CONFORME	3
64	Clamp Cleveland Clinic sinistro "baby renal, extra-fine", morso 1.7 mm NON CONFORME	2
65	Clamp Cleveland Clinic destro "baby renal, extra-fine", morso 1.7 mm NON CONFORME	2
66	Clips vascolari da aneurisma cerebrale per clampaggio carotide interna NON CONFORME	8
67	Applicatore clips vascolari da aneurisma cerebrale NON CONFORME	2
68	Cannula aspirazione Debakey testa svitab. da 9mm. 30,5cm. CONFORME	8
69	Cannula aspirazione Frazier-Lempert diam. 4mm. CONFORME	4
70	Punch aortico diametro 4mm. 15 cm. CONFORME	1
71	Punch aortico diametro 5mm. 15 cm. CONFORME	1
72	Mandrino per Turniquet cardiovascolare di Rumel CONFORME	2
73	Bulldog di Senning a tensione regolabile NON CONFORME	4
74	Dilatatore vascolare Garret malleab. 3mm. 14 cm. CONFORME	4
75	Dilatatore vascolare Garret malleab. 1,5mm. 22 cm. CONFORME	4
76	Dilatatore vascolare Garret malleab. 2mm. 22 cm. CONFORME	4
77	Dissettore doppio olivecrona stretto 18 cm. CONFORME	4
78	Pinza Kartchner pediatrica atraum. per carotide 10mm16 cm NON CONFORME	4

79	<p>Divaricatore addominale tipo " Codman Omni-tract" con set di valve intercambiabili per chirurgia addominale con la configurazione come segue:</p> <p>Configurazione del divaricatore autostatico addominale:</p> <p>N. 1 braccio principale per ancoraggio al tavolo operatorio dotato di due morsetti al fine di permettere contemporaneamente il posizionamento di bracci per divaricazione addominale e sottosternale.</p> <p>N. 1 braccio secondario con due morsetti, i morsetti devono essere indipendenti per permettere il posizionamento in qualunque posizione del braccio.</p> <p>N. 1 coppia di bracci a doppia angolatura questi devono essere poter essere agganciati ai morsetti da entrambe le estremità.</p> <p>N. 8 morsetti ad aggancio rapido.</p> <p>N. 4 valve di Fritsch per parete addominale 60 x 50 mm</p> <p>N. 2 valve di Fritsch per parete addominale 80 x 80 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione Langenbeck malleabile 50 x 170 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione di Langenbeck malleabile con asta articolabile 50 x 170 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione renale con asta articolabile 25 x 150 mm</p> <p>N. 2 valve di retrazione di Deaver fenestrata malleabile 120 x 150 mm</p> <p>N. 2 valve di retrazione di Deaver fenestrata malleabile e asta articolabile 80 x 155 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione "Body Wall" 80 x 160 mm</p> <p>N. 1 container da sterilizzazione in alluminio anodizzato completo di due griglie interne. Dimensioni 600 x 285 x 200 mm</p> <p>NON CONFORME</p>	1
80	Divaricatore costale inox Finocchietto medio valve 45x63 ap.21,5 cm. CONFORME	2
81	Divaricatore costale inox Finocchietto grande valve 70x63 ap. 21,5cm CONFORME	2
82	Divaricatore di Cloward 25 cm	0
83	Coppia divaricatori di Farabeuf 15 cm. CONFORME	8
84	Coppia divaricatori di Mathieu 20 cm. CONFORME	8
85	Divaricatore addominale Leriche 260x60mm- 27 cm. CONFORME	4
86	Divaricatore addominale Leriche 300x45mm. 27 cm. CONFORME	4
87	Divaricatore Harrington polmonare 127x45 mm. 32 cm. CONFORME	2
88	Divaricatore Harrington polmonare 127x62 mm. 32 cm. CONFORME	2
89	Divaricatore di Adson 3x4 smusso 26 cm CONFORME	4
90	Divaricatore di Adson 4x4 smusso 30 cm NON CONFORME	4
91	Divaricatore di Weitlaner 3x4 smusso 16 cm CONFORME	4
92	Divaricatore di Weitlaner 3x4 smusso 20 cm CONFORME	4
93	Divaricatore Weitlaner-Beckmann snodato 3x4 smusso 16 cm. CONFORME	4
94	Divaricatore Weitlaner-Beckmann snodato 3x4 smusso 24 cm. CONFORME	4
95	Divaricatore Beckman-Eaton snodato 7x7 affilato 32 cm CONFORME	4
96	Ciotole in acciaio inox da 1,5 lt. CONFORME	4
97	Ciotole in acciaio inox da 1lt. CONFORME	4
98	Ciotole in acciaio inox da 750cc. CONFORME	4
99	Ciotole in acciaio inox da 1/2 lt. CONFORME	4
100	Ciotole in acciaio inox da 50 cc. CONFORME	4
101	Vassoio in acciaio inox dim. 520x260x50 mm. CONFORME	4


102	Set tunneling vascolare "tipo Martin" NON CONFORME	1
103	Uncino per vena Brom punta stretta CONFORME	4
104	Uncino per vena Brom punta larga CONFORME	4
105	Uncino tracheale Jackson doppio NON CONFORME	4

E nello specifico si articolano le mancate conformità come segue:

Lotto 5: lo strumento offerto è retto e differisce da quanto specificato

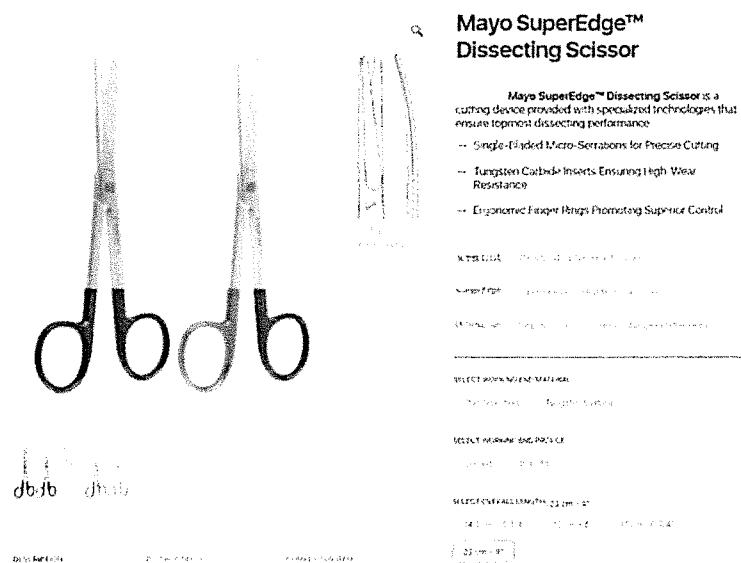

Lotto 20 – 21 gli strumenti di Mixter offerti sono pinze emostatiche e non passafili come richiesto, la differenza è importante in quanto le pinze emostatiche hanno una curvatura ampia che non si addice all'utilizzo quali passafili.

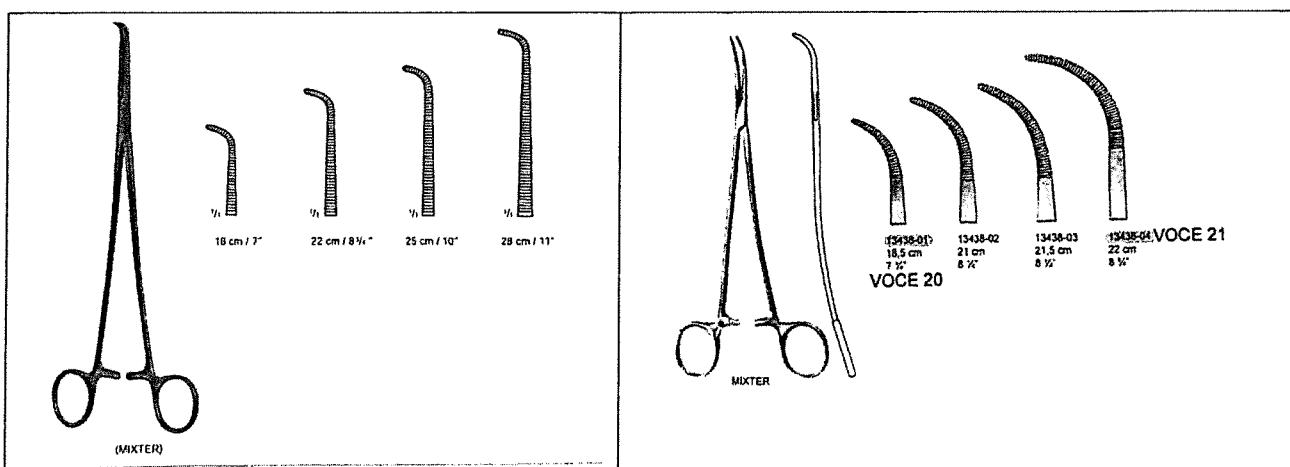

Lotto 31: lo strumento offerto differisce da quanto specificato in quanto le superfici di presa dell'ago non sono ricoperte da grip in tungsteno



Jacobson Micro Needle Holder

Jacobson Micro Needle Holder are specialized flat forceps that are ideal for grasping surgical needles during wound closures.

- Flat Handles With Outer Sensors For Secure Grasps
- Locking Mechanism Available To Offer Self-Retaining Manipulations
- Several Jaw Shapes Are Available To Suit Different Surgical Incisions

Standard Micro Needle Holders


EFFORT RETAINING SMOOTH JAWS

SELECTED PALE GREEN

13 cm - 21 cm - 27 cm


SELECTED PALE GREEN

24 cm - 27 cm

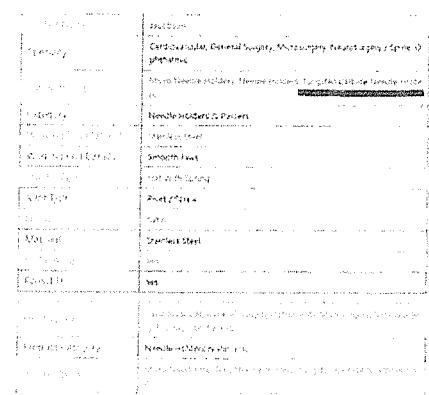


Lotto 64 – 65 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

inoltre la conformatore “sinistro” “destro” non è rilevabile

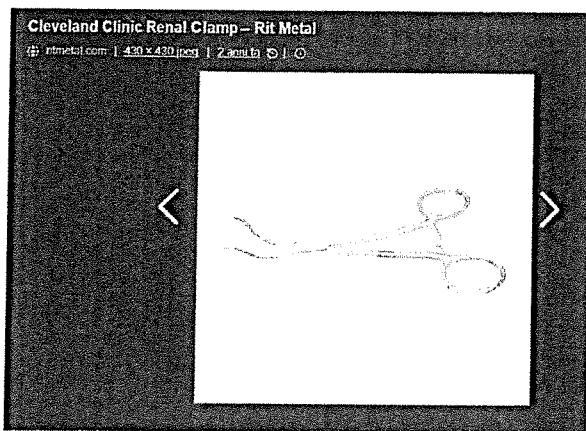


Lotto 66 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato


Clip chirurgico per aneurisma cerebrale
YASARGIL

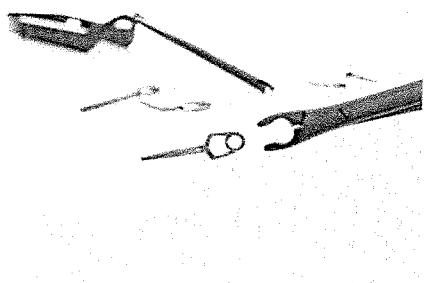


Lotto 67 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

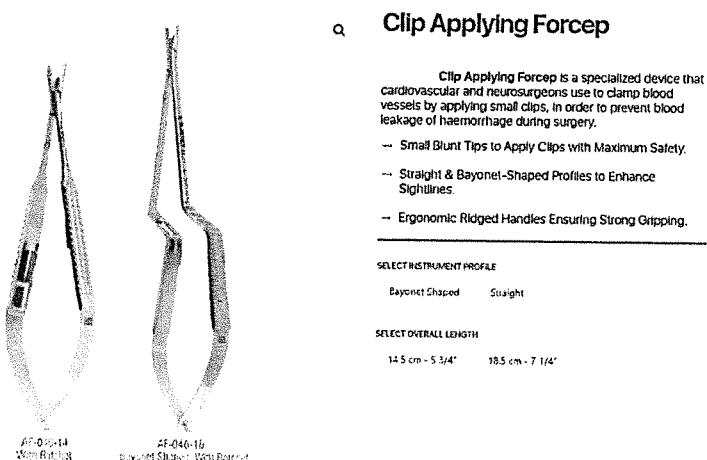

Lotto 73 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

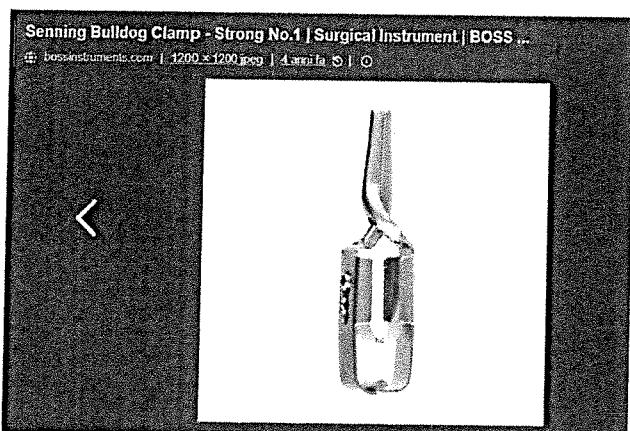

Lotto 78 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

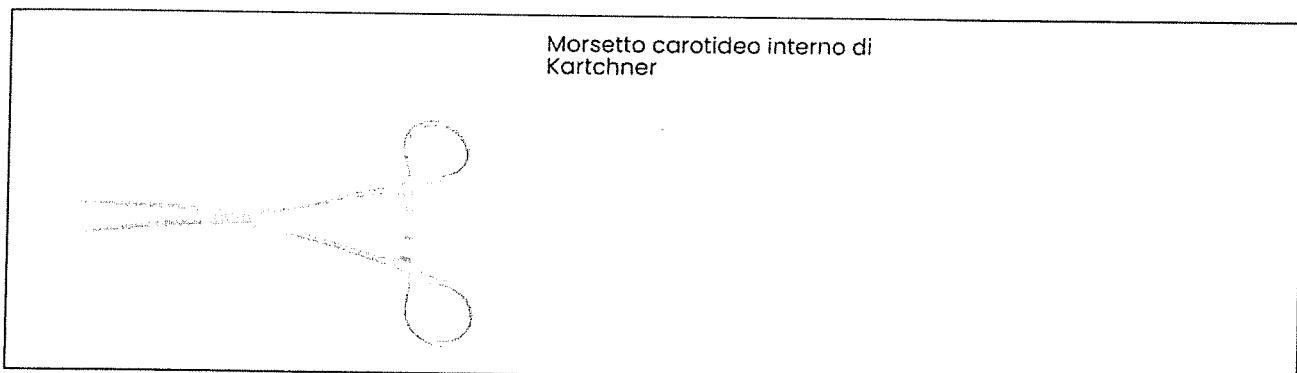

Gentile dr.ssa G. Petrucci,

dopo attenta revisione delle schede tecniche presentate dalle società concorrenti come da allegati forniti in data 25-11-2025 si fornisce il parere conseguente:

- 1) La scheda tecnica fornita dalla **ditta Axosan** è semplicemente l'elenco degli strumenti in capitolato della ditta produttrice Aesculap senza alcun riferimento ai lotti di inventario, inoltre tale scheda viene inoltrata, senza alcun apparente motivo, in triplice copia. Non è possibile esprimere alcuna valutazione.
- 2) Le schede fornite dalla **ditta Lepè** facenti capo alle ditte produttrici: Aesculap, Reda, Scanlan e Codman facenti riferimento dettagliato ai lotti oggetto di richiesta del capitolato il parere di congruità si articola come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Q.tà
1	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 45° 18 cm. CONFORME	6
2	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 60° 18 cm. CONFORME	6
3	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 90° 18 cm. CONFORME	2
4	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 130° 18 cm. CONFORME	4
5	Forbici di Mayo SuperEdge da dissezione curve 23 cm. NON CONFORME	8
6	Forbici di Mayo-Stille rette 17 cm. CONFORME	8
7	Forbici di Mayo-Stille curve 17 cm. CONFORME	8
8	Forbici Metzenbaum curve 18 cm. CONFORME	10
9	Forbici Metzenbaum curve 23 cm. CONFORME	8
10	Forbici di Klinkenberg curve a "S" cm. 23 CONFORME	2
11	Forbici taglia filo metallico in tungsteno 12,5 cm. CONFORME	2
12	Pinza vascolare di DeBakey morso 1,6mm. 20 cm. CONFORME	4
13	Pinza vascolare di DeBakey morso 2mm. 20 cm. CONFORME	10
14	Pinza vascolare di DeBakey morso 2mm. 24 cm. CONFORME	4
15	Pinza chirurgica denti 1x2 18 cm. CONFORME	8
16	Pinza chirurgica di Resano 23 cm. CONFORME	6
17	Pinza emostatica di Pean curva 24 cm. CONFORME	6
18	Pinza emostatica Halstead-Mosquito curva 12 cm. CONFORME	30
19	Pinza emostatica di Crile curva 16 cm. CONFORME	16
20	Pinza passafili di Mixter 18 cm. NON CONFORME	8
21	Pinza passafili di Mixter 22 cm. NON CONFORME	4
22	Pinza di O'Schagnessy a "L" 20 cm. CONFORME	4
23	Pinza di O'Schagnessy curva 22 cm. CONFORME	2
24	Pinza di Guion-Stille 23 cm. CONFORME	2
25	Pinza Foerster anelli grandi zigrinati retta 25 cm. CONFORME	4
26	Pinza Foerster anelli piccoli zigrinati retta 24 cm. CONFORME	4
27	Pinza pressa-tubi di Mayo 18 cm. CONFORME	4
28	Pinza di Allis morso atraumatico 25 cm. CONFORME	4
29	Fermateli di Backhaus 13 cm. CONFORME	10
30	Uncino di Crile smusso angolato a 90° 21 cm. CONFORME	4
31	Microportaaggi di Jacobson con arresto a punte medie tungsteno 18 cm NON CONFORME	8
32	Microportaaggi con arresto a punte fini retto per ago 6/0 con punte diamantate 18 cm CONFORME	8
33	Microportaaggi con arresto a punte fini retto per ago 7/0 con punte diamantate 21 cm CONFORME	4


34	Portagli di Debakey Magnagrip diamantato 20 cm.	0
35	Portagli di Hegar in tungsteno 20 cm. CONFORME	12
36	Portagli di Hegar in tungsteno 25 cm. CONFORME	4
37	Portagli di Debakey in tungsteno 18 cm. CONFORME	4
38	Portagli di Debakey in tungsteno 20 cm. CONFORME	12
39	Portagli di Debakey in tungsteno 25 cm. CONFORME	4
40	Pinza Debakey x aneurisma aortico morso 7,5cm 27cm CONFORME	2
41	Pinza sgorbia Stille-Luer 3 art. curva 22 cm. CONFORME	2
42	Pinza tagliente Stille-Liston 3 art. curva 26 cm. CONFORME	2
43	Tenaglia di Semb per ossa morso angolato 20 cm. CONFORME	2
44	Costotomo di Stille-Giertz 25 cm. CONFORME	2
45	Periostotomo costale Doyen per adulti destro 17 cm. CONFORME	2
46	Periostotomo costale Doyen per adulti sinistro 17 cm. CONFORME	2
47	Periostotomo Maurer retto 12mm. 26 cm. CONFORME	2
48	Periostotomo Maurer molto curvo 12mm. 26 cm. CONFORME	2
49	Cucchiaio di Volkmann-Collin 19 cm. CONFORME	4
50	Clamp Cooley atraumatico retto 22,5 cm CONFORME	4
51	Clamp Cooley atraumatico retto 27 cm CONFORME	4
52	Clamp Debakey morso ang. a 60° da 40mm. 23 cm. CONFORME	4
53	Clamp Debakey morso ang. a 60° da 65mm. 25 cm. CONFORME	4
54	Clamp Debakey per occlusione tangenziale 35mm. 19,5 cm. CONFORME	4
55	Clamp Debakey per occl tangenziale 48mm. 26 cm. CONFORME	4
56	Clamp di Cooley morso angolato per arteria iliaca 25cm CONFORME	4
57	Clamp di Cooley per femorale angolata a 30° 17 cm. CONFORME	4
58	Clamp di Cooley per femorale angolata a 60° 16 cm. CONFORME	4
59	Clamp di Derra morso fine, piccolo 16 cm. CONFORME	4
60	Clamp di Derra morso fine, medio 17cm. CONFORME	4
61	Clamp di Derra morso fine, grande 18 cm. CONFORME	4
62	Clamp di Satinsky morso da 54 mm lunghezza 26,5 cm CONFORME	3
63	Clamp di Satinsky morso da 58 mm lunghezza 27,5 cm CONFORME	3
64	Clamp Cleveland Clinic sinistro "baby renal, extra-fine", morso 1.7 mm NON CONFORME	2
65	Clamp Cleveland Clinic destro "baby renal, extra-fine", morso 1.7 mm NON CONFORME	2
66	Clips vascolari da aneurisma cerebrale per clampaggio carotide interna NON CONFORME	8
67	Applicatore clips vascolari da aneurisma cerebrale NON CONFORME	2
68	Cannula aspirazione Debakey testa svitab. da 9mm. 30,5cm. CONFORME	8
69	Cannula aspirazione Frazier-Lempert diam. 4mm. CONFORME	4
70	Punch aortico diametro 4mm. 15 cm. CONFORME	1
71	Punch aortico diametro 5mm. 15 cm. CONFORME	1
72	Mandrino per Turniquet cardiovascolare di Rumel CONFORME	2
73	Bulldog di Senning a tensione regolabile NON CONFORME	4
74	Dilatatore vascolare Garret malleab. 3mm. 14 cm. CONFORME	4
75	Dilatatore vascolare Garret malleab. 1,5mm. 22 cm. CONFORME	4
76	Dilatatore vascolare Garret malleab. 2mm. 22 cm. CONFORME	4
77	Dissettore doppio olivecrona stretto 18 cm. CONFORME	4
78	Pinza Kartchner pediatrica atraum. per carotide 10mm16 cm NON CONFORME	4

79	<p>Divaricatore addominale tipo " Codman Omni-tract" con set di valve intercambiabili per chirurgia addominale con la configurazione come segue:</p> <p>Configurazione del divaricatore autostatico addominale:</p> <p>N. 1 braccio principale per ancoraggio al tavolo operatorio dotato di due morsetti al fine di permettere contemporaneamente il posizionamento di bracci per divaricazione addominale e sottosternale.</p> <p>N. 1 braccio secondario con due morsetti, i morsetti devono essere indipendenti per permettere il posizionamento in qualunque posizione del braccio.</p> <p>N. 1 coppia di bracci a doppia angolatura questi devono essere poter essere agganciati ai morsetti da entrambe le estremità.</p> <p>N. 8 morsetti ad aggancio rapido.</p> <p>N. 4 valve di Fritsch per parete addominale 60 x 50 mm</p> <p>N. 2 valve di Fritsch per parete addominale 80 x 80 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione Langenbeck malleabile 50 x 170 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione di Langenbeck malleabile con asta articolabile 50 x 170 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione renale con asta articolabile 25 x 150 mm</p> <p>N. 2 valve di retrazione di Deaver fenestrata malleabile 120 x 150 mm</p> <p>N. 2 valve di retrazione di Deaver fenestrata malleabile e asta articolabile 80 x 155 mm</p> <p>N. 1 valva di retrazione "Body Wall" 80 x 160 mm</p> <p>N. 1 container da sterilizzazione in alluminio anodizzato completo di due griglie interne. Dimensioni 600 x 285 x 200 mm</p> <p>NON CONFORME</p>	1
80	Divaricatore costale inox Finocchietto medio valve 45x63 ap.21,5 cm. CONFORME	2
81	Divaricatore costale inox Finocchietto grande valve 70x63 ap. 21,5cm CONFORME	2
82	Divaricatore di Cloward 25 cm	0
83	Coppia divaricatori di Farabeuf 15 cm. CONFORME	8
84	Coppia divaricatori di Mathieu 20 cm. CONFORME	8
85	Divaricatore addominale Leriche 260x60mm- 27 cm. CONFORME	4
86	Divaricatore addominale Leriche 300x45mm. 27 cm. CONFORME	4
87	Divaricatore Harrington polmonare 127x45 mm. 32 cm. CONFORME	2
88	Divaricatore Harrington polmonare 127x62 mm. 32 cm. CONFORME	2
89	Divaricatore di Adson 3x4 smusso 26 cm CONFORME	4
90	Divaricatore di Adson 4x4 smusso 30 cm NON CONFORME	4
91	Divaricatore di Weitlaner 3x4 smusso 16 cm CONFORME	4
92	Divaricatore di Weitlaner 3x4 smusso 20 cm CONFORME	4
93	Divaricatore Weitlaner-Beckmann snodato 3x4 smusso 16 cm. CONFORME	4
94	Divaricatore Weitlaner-Beckmann snodato 3x4 smusso 24 cm. CONFORME	4
95	Divaricatore Beckman-Eaton snodato 7x7 affilato 32 cm CONFORME	4
96	Ciotole in acciaio inox da 1,5 lt. CONFORME	4
97	Ciotole in acciaio inox da 1lt. CONFORME	4
98	Ciotole in acciaio inox da 750cc. CONFORME	4
99	Ciotole in acciaio inox da 1/2 lt. CONFORME	4
100	Ciotole in acciaio inox da 50 cc. CONFORME	4
101	Vassoio in acciaio inox dim. 520x260x50 mm. CONFORME	4


102	Set tunneling vascolare "tipo Martin" NON CONFORME	1
103	Uncino per vena Brom punta stretta CONFORME	4
104	Uncino per vena Brom punta larga CONFORME	4
105	Uncino tracheale Jackson doppio NON CONFORME	4

E nello specifico si articolano le mancate conformità come segue:


Lotto 5: lo strumento offerto è retto e differisce da quanto specificato

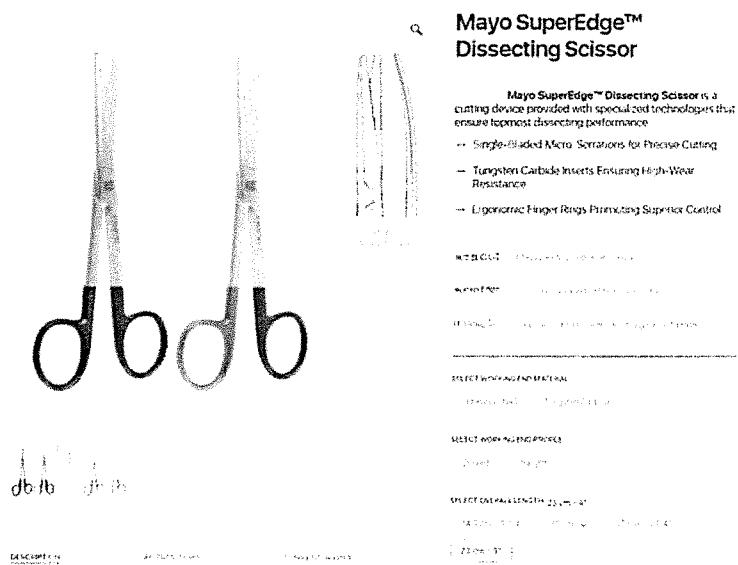

Lotto 20 – 21 gli strumenti di Mixter offerti sono pinze emostatiche e non passafili come richiesto, la differenza è importante in quanto le pinze emostatiche hanno una curvatura ampia che non si addice all'utilizzo quali passafili.

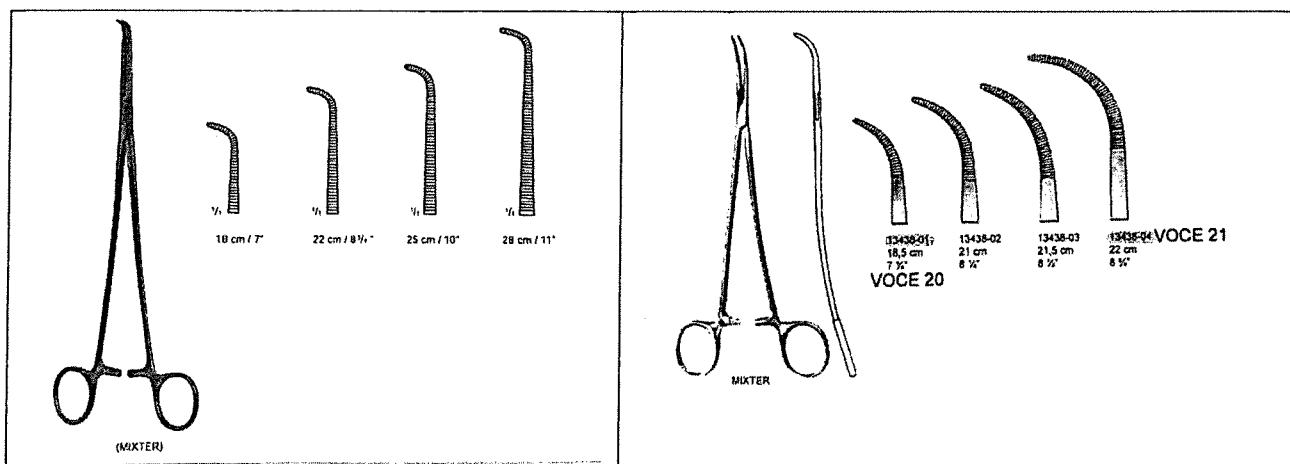


Lotto 31: lo strumento offerto differisce da quanto specificato in quanto le superfici di presa dell'ago non sono ricoperte da grip in tungsteno

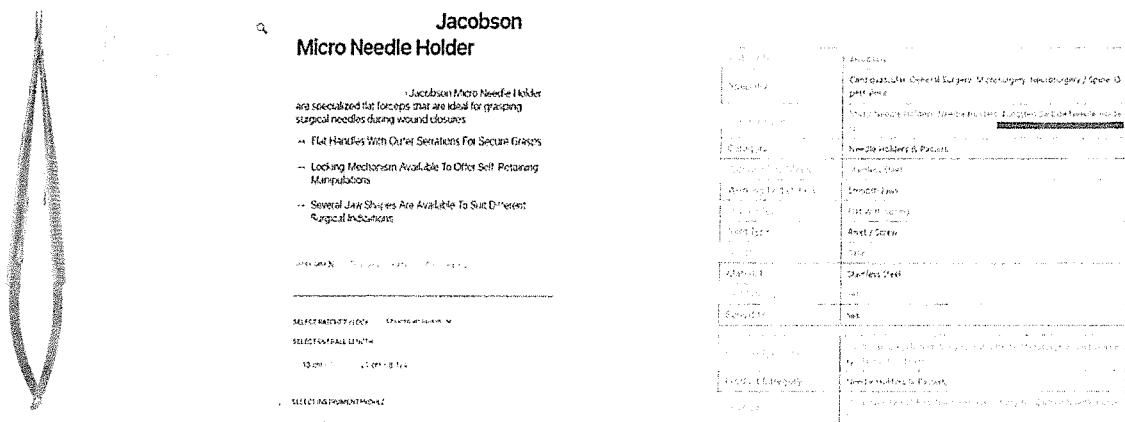


Lotto 64 – 65 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

inoltre la conformazione "sinistro" "destro" non è rilevabile

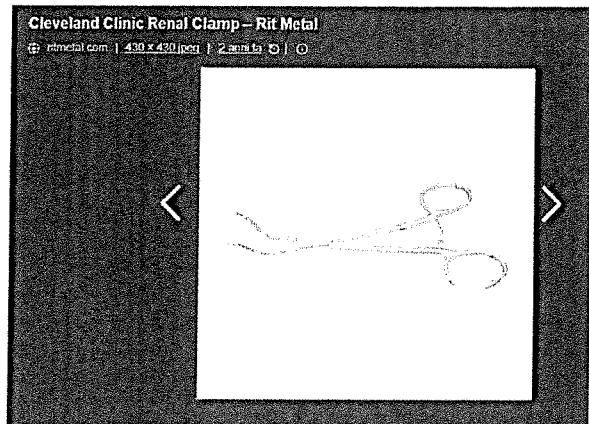


Lotto 66 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato


Clip chirurgico per aneurisma cerebrale YASARGIL

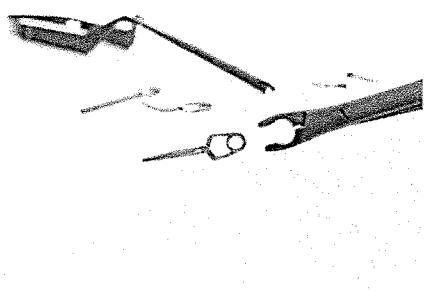


Lotto 67 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

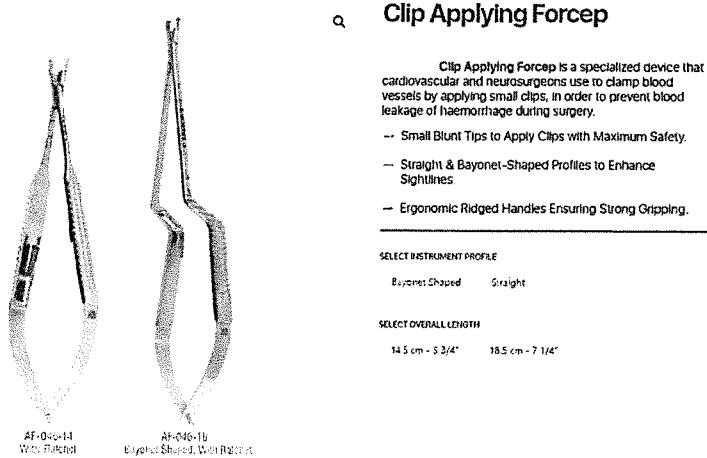

Lotto 73 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

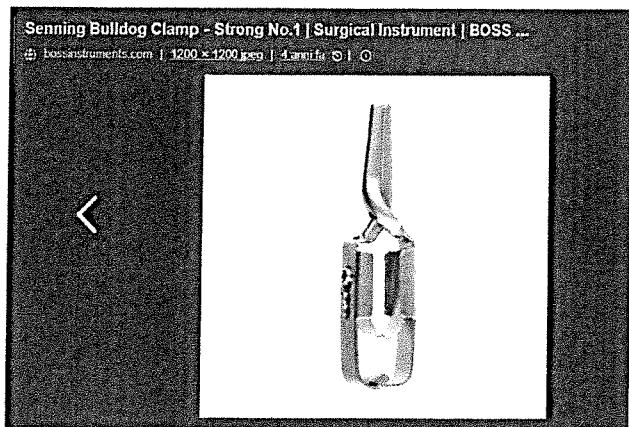


Lotto 78 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato

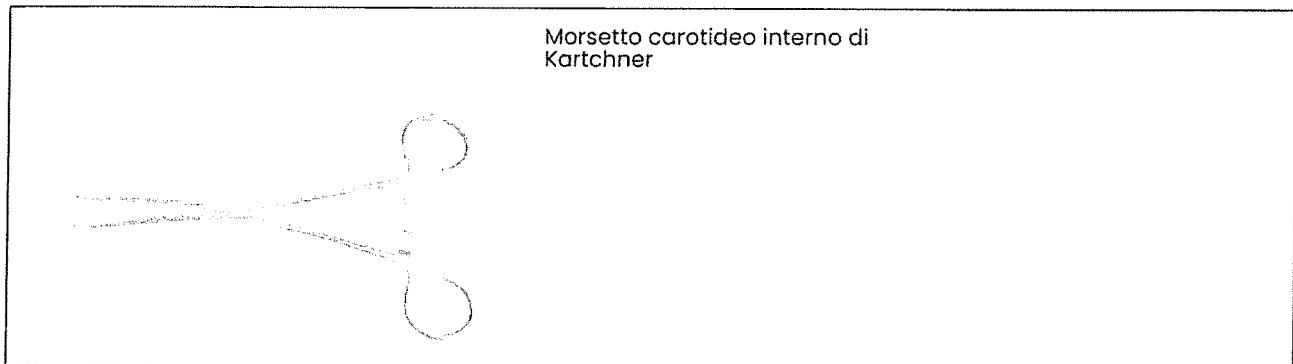

Lotto 79 nel capitolato del divaricatore " Codman Omni-tract", come è possibile rilevare dai codici allegati nell'elenco specifico, esistono le seguenti criticità:

- Manca il braccio di estensione (cod. 11050 o 11070) necessario al montaggio del divaricatore.
- Al posto della valva di Langenbeck con asta articolabile viene offerta una valva solamente girevole (cod. 3774) differente da quanto richiesto.
- Al posto della valva Deaver fenestrata viene offerta interamente chiusa cod. (3121R) differente da quanto richiesto.
- Al posto della valva Deaver fenestrata ed articolata viene offerta valva interamente chiusa e con asta rigida e non articolabile (cod. 3784) differente da quanto richiesto.

Lotto 90 Il divaricatore offerto è del tipo snodato differente da quanto richiesto.

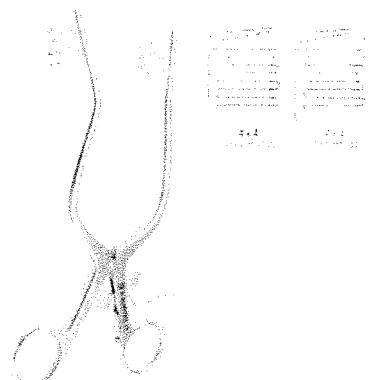

Anderson-Adson Self Retaining Retractor


Anderson-Adson Self Retaining Retractor is a specialized instrument commonly used to pry open medium sized incisions. It is frequently used during general surgery as well as neuro and spinal surgeries to access deeper structures.

- Long Jaws For Better Access To Tissues
- Hooked Ends For Secure Grip
- Light Weight For Comfortable Handling

Set Contents

1 - Self Retaining Retractor

Lotto 102 lo strumento offerto tratta di un tunnellizzatore della lunghezza di cm 30 per l'impiego sottocutaneo per fistole artero-venose che peraltro prevede l'utilizzo di guaine monouso da acquistare separatamente quale materiale di consumo con carattere di esclusività, differisce quindi totalmente da quanto specificato.

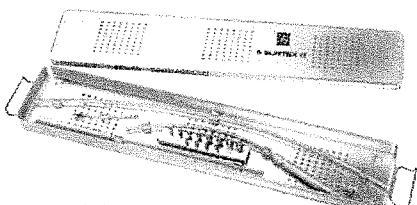

Martin Vascular Tunneling Set


Martin Vascular Tunneling Set is a specialized surgical instrument set that is commonly used during cardiovascular surgeries. The long shafts act as guides in vessel grafts allowing the surgeon to accurately attach the two ends to the appropriate vessels.

- Solid Round Handle For Secure Grip
- Long Shaft For Deep Access To the Vessel
- Streamlined Design For Comfortable Handling

Set Contents

- 1 - Handle for Tunneling Set
- 2 - Long End Shafts x 3
- 3 - Tunneling Tip x 4 (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)
- 4 - Vial Tip x 1
- 5 - End Adapter
- 6 - Martin Curve Suture

Lotto 105 lo strumento offerto differisce totalmente da quanto specificato



Jackson Tracheal Hook

Jackson Tracheal Hook assists surgeons to lift the trachea during tracheotomy incisions. This facilitates a better view for the tracheal incision and a clear surgical access during critical interventions.

- Flat Central Handle For Non-slip Grips.
 - Slender Shafts For A Clear Field Of Vision.
 - Two Blades For Convenient Dissections.
-

In attesa di cortese riscontro pongo,

Cordiali Saluti



Outlook

R: Comunicazione -procedura di gara per acquisto ferri chirurgici - RDO n. 5785931

Da Salvatore Alberto Turiano <salvatore.turiano@aspag.it>

Data gio 8/1/26 13:58

A Giusy Petrucci <giusy.petrucci@aspag.it>

Buongiorno. Si prende visione delle note inoltrate, si osserva che non vengono fornite note relative tutti i lotti di mancata conformità. Con la presente comunicazione confermo il capitolato tecnico relativo alla procedura di gara per acquisto ferri chirurgici già indicato.
In attesa di cortese riscontro, porgo
Cordiali Saluti

Da: Giusy Petrucci <giusy.petrucci@aspag.it>

Inviato: giovedì 8 gennaio 2026 11:06


A: Salvatore Alberto Turiano <salvatore.turiano@aspag.it>

Oggetto: Comunicazione -procedura di gara per acquisto ferri chirurgici - RDO n. 5785931

Buongiorno, come da intese per le vie brevi, con la presente si comunica che in data 12/12/2025 è stata data comunicazione di conformità tecnica, per le voci 5,20,21,31,64,65,66,67,73,78,79,90,102,e 105 , (giuste motivazioni di cui alla Sua relazione custodita agli atti), alla società Lepè Srl .

In ordine a tale comunicazione ,la sopracitata società, in data 29/12/2025, ha presentato una nota, di osservazioni ,che si allega in uno alla presente.

Fermo restando che rimane confermata non conformità, (stante che possono essere prese in considerazione soluzioni in alternativa) e, considerato che dovrà essere indetta nuova proceduta di gara, alla luce delle osservazioni presentate, si chiede alla SV. di confermare e/o modificare il capitolato tecnico relativo all'acquisto di che trattasi.
Si rimane in attesa di riscontro.

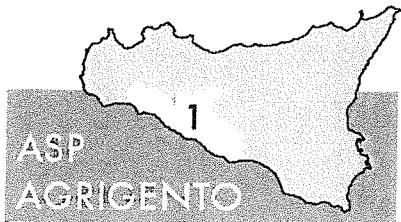

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C - SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407645
Fax 0922407119 – 211
Email – forniture@aspag.it

Prot. n. del

A SOCIETÀ
DIVERSE

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di “Ferri Chirurgici” (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc) da destinare alla U.O.C. Chirurgia vascolare del P.O. di Agrigento -

Con deliberazione n. del è stata autorizzata l’indizione di Procedura Negoziata, per la fornitura di Strumentario Chirurgico (pinze anatomiche, forbici, divaricatori ecc) da destinare alla U.O.C. Chirurgia vascolare del P.O. di Agrigento - ai sensi del combinato disposto dell’art.50 comma 1 lettera e) del D.lgs. 36/ 2023

L’appalto è costituito da un unico lotto

Importo a base d’asta € 215.000,00

In merito alla presenza di rischi da interferenze ex art 26, comma3 bis. D.lgs 81/08, e ss.mm. ii, si precisa che non è stato predisposto D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi ambientali da interferenze da valutare stante che la fornitura sarà eseguita in orari di chiusura e, comunque senza la presenza di terzi.

Gli oneri della Sicurezza sono, pertanto pari a zero.

Restano comunque immutati gli obblighi a carico della ditta aggiudicataria in merito alla sicurezza sul lavoro.

La fornitura sarà aggiudicata, per il singolo lotto, ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale art. 94 e 95 D.LGS. 36/2023, e non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs.n. 165/2001 in presenza di offerta valida secondo il criterio del minor prezzo, previo giudizio di conformità tecnica, così come previsto da capitolato tecnico, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in applicazione

Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.

LA DITTA DOVRÀ PRODURRE QUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) Copia della presente lettera invito firmata per accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa contenute.
- 2) DGUE debitamente compilato e firmato
- 3) l’assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e l’indicazione del codice NSO

- 4) di accettare le comunicazioni art. 96 D.lgs 36/2023 attinenti alla presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma MePA e tramite PEC indicando il relativo indirizzo
- 5) Ricevuta di pagamento del contributo dovuto all'ANAC

LA DITTA DOVRÀ PRODURRE QUALE DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- ✓ Manuale d'uso, depliants illustrativi del prodotto offerto, (se previsti) redatte in lingua italiana/inglese, rese in originale o in copia conforme.
- ✓ Certificazione attestante la conformità alla normativa CE

Relativamente alla presentazione delle schede tecniche si precisa quanto segue: la nuova rimodulazione del sistema MePA /CONSID ad oggi, non consente alle ditte partecipanti la creazione della busta tecnica nel caso di RDO evoluta e/o semplice.

Pertanto, sarà accettata la presentazione della documentazione tecnica dei prodotti offerti in uno alla documentazione Amministrativa, fermo restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 101 del Digs 36/2023.

Per il lotto messo a gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una scheda tecnica, per ciascun prodotto offerto, redatta esclusivamente in lingua italiana/inglese in originale o copia conforme all'originale, contenente le seguenti informazioni:

- ✓ il numero del lotto di riferimento
- ✓ Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerto, da parte di Istituti o servizi ufficiali incaricati secondo la normativa vigente
- ✓ Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione
- ✓ Produzione conforme alle norme CE in vigore e successive modificazioni
- ✓ Destinazione d'uso del prodotto
- ✓ Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell'organismo notificato
- ✓ Processo di sterilizzazione se adottato
- ✓ Caratteristiche del confezionamento (primario e secondario) e del materiale impiegato per esso
- ✓ Eventuali avvertenze per l'uso e lo stoccaggio
- ✓ Quant'altro si renda necessario per la valutazione tecnica,

La società aggiudicataria dovrà produrre a garanzia della regolare esecuzione del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore totale del contratto da costituirsi tramite fideiussione bancaria o assicurativa resa nei modi stabiliti dall'art. 117 del D.lgs 36/2023.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera d'invito si rimanda a quanto previsto nell'allegato Capitolato tecnico che qui si intende ripetuto e trascritto, così come accettato ed approvato.

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche e i relativi quantitativi presunti sono espressamente indicati nel capitolato tecnico.

I quantitativi indicati nel sopra citato capitolato tecnico devono intendersi quale dato di previsione dei consumi, quindi sono da considerare meramente indicativi, gli stessi possono variare in più o in meno, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle reali necessità, senza che la ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazione del prezzo offerto.

Gli articoli devono essere in possesso del marchio "CE"

I prodotti dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed Europea per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Gli articoli dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 7153-1 e successivi aggiornamenti ed essere rispondenti a tutte le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico, dovranno essere dotati di garanzia sul mal funzionamento e corrosione per un periodo di almeno anni quattro e nel caso si verificassero i suddetti difetti la ditta aggiudicataria si impegna, senza oneri aggiuntivi, a provvedere alla sostituzione durante tutto il periodo di garanzia.

La società aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione e alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura, nonché quelle che possono essere emanate in materia da parte della autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Per tutti i prodotti dovrà essere indicata la CND di appartenenza e l'iscrizione nel repertorio Nazionale dei DM, se dovuta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 del D.M del 21/12/2009- Ministero della salute.

Il prezzo offerto valido per almeno un anno dalla data di stipula del contratto si intende compreso del trasporto, scarico facchinaggio e consegna presso le U.O. destinatarie dei beni e che saranno indicati nell'ordinativo.

LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA:

Le forniture dovranno essere effettuate, franco di ogni e qualsiasi spesa, entro 60 giorni dal ricevimento della commessa d'ordine, presso il magazzino Farmacia che sarà indicato nell'ordine, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, di tutti i giorni feriali.

Per le eventuali consegne anomale, effettuate dai corrieri, presso terzi, fuori orario, in piani o servizi diversi come meglio specificato nell'ordine, sarà ritenuta responsabile la ditta, che a proprie spese, dovrà provvedere tempestivamente al ritiro e contestuale sostituzione della merce.

All'atto della consegna, la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità, del tipo e con riferimento agli estremi dell'ordinazione.

Qualora i prodotti consegnati dovessero risultare inaccettabili qualitativamente, la ditta aggiudicataria è tenuta all'immediata sostituzione senza ulteriori oneri aggiuntivi; nel caso di inadempienza, l'Azienda avrà facoltà di acquistare altrove i prodotti a spese della società.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'incaricato presso il magazzino della Farmacia che sarà specificato nell'ordine, non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità in ordine ai difetti ed imperfezioni, vizi apparenti o occulti, dei prodotti consegnati e non potuti accettare all'atto della consegna, ma accertati e contestati successivamente.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibile, in lingua italiana la descrizione tecnico-quantitativa del contento, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra utile informazione utile al loro riconoscimento.

I prodotti da fornire saranno ordinati da questo Servizio Provveditorato e dovranno essere consegnati entro 15 giorni (15) dalla data dell'ordine presso la sede/i che saranno indicate nell'ordinativo previa verifica di conformità

La fornitura in conformità all'art. 116 del Dlgs 36/2023 sarà sottoposta a verifica di conformità, per accettare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore.

Dopo la comunicazione dell'esito positivo di conformità previa dichiarazione da parte del soggetto incaricato dall'A.S.P. di detta verifica, la ditta potrà emettere fattura - codice univoco ufficio TIDFX - questa U.O.C. procederà alla liquidazione e pagamento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico e alle caratteristiche dichiarate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara.

In caso di diffidenza tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'A.S.P. richiederà nota di credito all'operatore economico fornitore con interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 comma 12 D.lgs 36/2023

Le somme pagate graveranno sui fondi ordinari del bilancio aziendale

REQUISITI NECESSARI

Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed essere corrispondenti alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico.

È ammessa una tolleranza massima del 5% sulle misure indicate nella descrizione tecnica

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera d'invito si rimanda a quanto previsto nell'allegato capitolato tecnico che qui si intende ripetuto e trascritto, così come accettato ed approvato.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art. 101 D.lgs. 36/2023.

In ogni caso non sarà possibile sanare carenze afferenti all'offerta tecnica ed economica, come anche, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Oltre alla formulazione dell'offerta economica generata dal Sistema l'operatore economico, per il lotto/i per il quale partecipa dovrà formulare la propria offerta economica conformemente allo schema offerta allegato A
La mancanza di una singola voce all'interno del lotto per il quale si partecipa determina l'esclusione dalla gara.

Le Ditte potranno svincolarsi dalla propria offerta soltanto dopo 180 giorni dalla data di effettuazione della gara, qualora entro tale termine non intervenga l'aggiudicazione definitiva.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare, in caso di Ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, per il lotto per il quale si partecipa

In caso di raggruppamento di imprese già costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal mandatario a cui i mandanti hanno conferito il mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, e dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

La società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma quadro "Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena recesso del contratto, a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.)

È, inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

Questa Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto pari all' 1% per ogni giorno naturale o successivo di ritardo e nella misura del 5% per la mancata consegna.


Le penali sono cumulabili e verranno applicate direttamente trattenendo le somme dai pagamenti.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere.

La ditta dovrà restituire la presente firmata per accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa contenute.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Direttore F.F. U.O.C Servizio Provveditorato
Dott.ssa Rosalia Calà

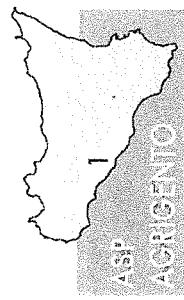

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
SEDE LEGALE : VIALE DELLA VITTORIA, 321 - AGRIGENTO
P. IVA 02570930848

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER UOC CHIRURGIA VASCOLARE DEL
PO SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO - RDO

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA "A"

Q.TA'	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CND	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
6	FORBICI DI DIETRICH PUNTE ACUTE ANGOLATE A 45° 18 CM				
6	FORBICI DI DIETRICH PUNTE ACUTE ANGOLATE A 60° 18 CM				
2	FORBICI DI DIETRICH PUNTE ACUTE ANGOLATE A 90° 18 CM				
4	FORBICI DI DIETRICH PUNTE ACUTE ANGOLATE A 130° 18 CM				
8	FORBICI DI MAYO SUPEREDGE DA DISSEZIONE CURVE 23 CM				
8	FORBICI DI MAYO - STILLE RETTE 17 CM				
8	FORBICI DI MAYO - STILLE CURVE 17 CM				
10	FORBICI METZENBAUM CURVE 18 CM				
8	FORBICI METZENBAUM CURVE 23 CM				
2	FORBICI DI KLINKENBERG CURVE A "S" CM 23				

2	FORBICI TAGLIA FILO METALLICO IN TUNGSTENO 12,5		
4	PINZA VASCOLARE DI DEBAKEY MORSO 1,6 MM. 20 CM		
10	PINZA VASCOLARE DI DEBAKEY MORSO 2 MM. 20 CM		
4	PINZA VASCOLARE DI DEBAKEY MORSO 2 MM. 24 CM		
8	PINZA CHIRURGICA DENTI 1X2 18 CM		
6	PINZA CHIRURGICA DI RESANO 23 CM		
6	PINZA EMOSTATICA DI PEAN CURVA 24 CM		
30	PINZA EMOSTATICA HALSTEAD - MOSQUITO CURVA 12 CM		
16	PINZA EMOSTATICA DI CRILE CURVA 16 CM		
8	PINZA PASSAFILI DI MIXTER 18 CM		
4	PINZA PASSAFILI DI MIXTER 22 CM		
4	PINZA DI O'SCHAGNESSY A "L" 20 CM		
2	PINZA DI O'SCHAGNESSY CURVA 22 CM		
2	PINZA DI GUINON-STILLE 23 CM		
4	PINZA FOERSTER ANELLI GRANDI ZIGRINATI RETTA 25 CM		
4	PINZA FOERSTER ANELLI PICCOLI ZIGRINATI RETTA 24 CM		
4	PINZA PRESA-TUBI DI MAYO 18 CM		
4	PINZA DI ALLIS MORSO ATRAUMATICO 25 CM		
10	FERMATELLI DI BACKHAUS 13 CM		
4	UNCINO DI CRILE SMUSSO ANGOLATO A 90 ° 21 CM		
8	MICROPORTAAGHI DI JACOBSON CON ARRESTO A PUNTE MEDIE TUNGSTENO 18 CM		
8	MICROPORTAAGHI CON ARRESTO A PUNTE FINI RETTO PERAGO 6/0 CON PUNTE DIAMANTATE 18 CM		
4	MICROPORTAAGHI CON ARRESTO A PUNTE FINI RETTO PERAGO 7/0 CON PUNTE DIAMANTATE 21 CM		

12	PORTAGHI DI HEGAR IN TUNGSTENO 20 CM		
4	PORTAGHI DI HEGAR IN TUNGSTENO 25 CM		
4	PORTAGHI DI DEBAKEY IN TUNGSTENO 18 CM		
12	PORTAGHI DI DEBAKEY IN TUNGSTENO 20 CM		
4	PORTAGHI DI DEBAKEY IN TUNGSTENO 25 CM		
2	PINZA DEBAKEY X ANEURISMA AORTICO MORSO 7,5 CM 27 CM		
2	PINZA SGORBIA STILLE-LUER 3 ART. CURVA 22 CM		
2	PINZA TAGLIENTE STILLE-LISTON 3 ART. CURVA 26 CM		
2	TENAGLIA DI SEMB PER OSSA MORSO ANGOLATO 20 CM		
2	COSTOTOMO DI STILLE-GIERZ 25 CM		
2	PERIOSTOTOMO COSTALE DOYEN PER ADULTI DESTRO 17 CM		
2	PERIOSTOTOMO COSTALE DOYEN PER ADULTI SINISTRO 17 CM		
2	PERIOSTOTOMO MAURER RETTO 12MM 26 CM		
2	PERIOSTOTOMO MAURER MOLTO CURVO 12MM 26 CM		
4	CUCCHIAIO DI VOLKMANN- COLLIN 19 CM		
4	CLAMP COOLEY ATRAUMATICO RETTA 22,5 CM		
4	CLAMP COOLEY ATRAUMATICO RETTA 27 CM		
4	CLAMP DEBAKEY MORSO ANG. A 60 ° DA 40 MM 23 CM		
4	CLAMP DEBAKEY MORSO ANG. A 60 ° DA 65 MM 25 CM		
4	CLAMP DEBAKEY PER OCCLUSIONE TANGENZIALE 35 MM 19,5 CM		

4	CLAMP DEBAKEY PER OCCL TANGENZIALE 48 MM 26 CM			
4	CLAMP DI COOLEY MORSO ANGOLATO PER ARTERIA ILLIACA 25 CM			
4	CLAMP DI COOLEY PER FEMORALE ANGOLATA A 30° 17 CM			
4	CLAMP DI COOLEY PER FEMORALE ANGOLATA A 60° 16 CM			
4	CLAMP DI DERRA MORSO FINE, PICCOLO 16 CM			
4	CLAMP DI DERRA MORSO FINE, PICCOLO 17 CM			
4	CLAMP DI DERRA MORSO FINE, PICCOLO 18 CM			
3	CLAMP DI SATINSKY MORSO DA 54 MM LUNGHEZZA 26,5 CM			
3	CLAMP DI SATINSKY MORSO DA 58 MM LUNGHEZZA 27,5 CM			
2	CLAMP CLEVELAND CLINIC SINISTRO “BABY RENAL, EXTRA-FINE”, MORSO 1,7 MM			
2	CLAMP CLEVELAND CLINIC DESTRO “BABY RENAL, EXTRA-FINE”, MORSO 1,7 MM			
8	CLIPS VASCOLARI DA ANEURISMA CEREBRALE PER CLAMPAGGIO CAROTIDE INTERNA			
2	APPLICATORE CLIPS VASCOLARI DA ANEURISMA CEREBRALE			
8	CANNULA ASPIRAZIONE DEBAKEY TESTA SVITAB. DA 9 MM 30,5 CM			
4	CANNULA ASPIRAZIONE FRAIZER- LEMPERT DIAM. 4 MM			
1	PUNCH AORTICO DIAMETRO 4 MM 15 CM			
1	PUNCH AORTICO DIAMETRO 5 MM 15 CM			
2	MANDRINO PER TURNIQUET CARDIOVASCOLARE DI RUMEL			

4	BULLDOG DI SENNING A TENSIONE REGOLABILE		
4	DILATATORE VASCOLARE MALLEAB. 3 MM 14 CM	GARRET	
4	DILATATORE VASCOLARE MALLEAB. 1,5 MM 22 CM	GARRET	
4	DILATATORE VASCOLARE MALLEAB. 2 MM 22 CM	GARRET	
4	DISSEZTORE DOPPIO OLIVECRONA STRETTO 18 CM		
4	PINZA KARTCHNER PEDIATRICA ATRAUM. PER CAROTIDE 10MM 16 CM		
1	DIVARICATORE ADDOMINALE TIPO "CODMAN OMNI-TRACT" CON SET DI VALVE INTERCambiABILI PER CHIRURGIA ADDOMINALE CON LA CONFIGURAZIONE COME SEGUENTE: CONFIGURATORE DEL DIVARICATORE AUTOSTATICO ADDOMINALE;		
	N. 1 BRACCIO PRINCIPALE PER ANCORAGGIO AL TAVOLO OPERATORIO DI DUE MORSETTI AL FINE DI PERMETTERE CONTEMPORANEAMENTE IL POSIZIONAMENTO DI BRACCI PER DIVARICAZIONE ADDOMINALE E SOTOSTERNALE.		
	N. 1 BRACCIO SECONDARIO CON DUE MORSETTI, I MORSETTI DEVONO ESSERE INDIPENDENTI PER PERMETTERE IN QUALUNQUE POSIZIONA DEL BRACCIO.		
	N. 1 COPPIA DI BRACCI A DOPPIA ANGOLATURA QUESTI DEVONO POTERE ESSERE AGGANCIAZI AI MORSETTI DA ENTRAMBE LE ESTREMITÀ.		
	N. 8 MORSETTI AD AGGANCIO RAPIDO		
	N. 4 VALVA DI FRITSCH PER PARETE ADDOMINALE 60X50 MM		
	N. 2 VALVE DI FRITSCH PER PARETE		

ADDOMINALE 80X80 MM N. VALVA DI RETRAZIONE LAGENBECK MALLEABILE 50X170 MM	N. 1 VALVA DI RETRAZIONE DI LAGENBECK MALLEABILE 50X170 MM N. 1 VALVA DI RETRAZIONE RENALE CON ASTA ARTICOLAZIONE 25X150 MM N. 2 VALVE DI RETRAZIONE DI DEAVER FENESTRATA MALLEABILE 120X150 MM
N. 2 VALVE DI RETRAZIONE DI DEAVER FENESTRATA MALLEABILE E ASTA ARTICOLABILE 80X155 MM	N. 1 VALVA DI RETRAZIONE "BODY WALL" 80X160 MM
N. 1 CONTAINER DA STERILIZZAZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO COMPLETO DI DUE GRIGLIE INTERNE. DIMENSIONE 600X285X200 MM	N. 1 CONTAINER DA STERILIZZAZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO COMPLETO DI DUE GRIGLIE INTERNE. DIMENSIONE 600X285X200 MM
2 DIVARICATORE COSTALE FINOCCHIETTO MEDIO VALVE AP.21,5 CM	2 DIVARICATORE COSTALE INOX FINOCCHIETTO MEDIO VALVE AP.21,5 CM
2 COPPIA DIVARICATORI DI FARABEUF 15 CM	2 COPPIA DIVARICATORI DI FARABEUF 15 CM
8 COPPIA DIVARICATORI DI MATHEU 20 CM	8 COPPIA DIVARICATORI DI MATHEU 20 CM
4 DIVARICATORE ADDOMINALE LERICHE 260X260 MM - 27 CM	4 DIVARICATORE ADDOMINALE LERICHE 300X45 MM. 27 CM
4 DIVARICATORE ADDOMINALE LERICHE 300X45 MM. 27 CM	2 DIVARICATORE HERRINGTON POLMONALE 127X45 MM. 32 CM
2 DIVARICATORE HERRINGTON POLMONALE 127X62 MM. 32 CM	2 DIVARICATORE HERRINGTON POLMONALE 127X62 MM. 32 CM
4 DIVARICATORE DI ADSON 3X4 SMUSSO 26 CM	4 DIVARICATORE DI ADSON 3X4 SMUSSO 26 CM

4	DIVARICATORE DI ADSON 4X4 SMUSSO 30 CM				
4	DIVARICATORE DI WEITLANER 3X4 SMUSSO 16 CM				
4	DIVARICATORE DI WEITLANER 3X4 SMUSSO 20 CM				
4	DIVARICATORE DI WEITLANER - BECKMANN SNODATO 3X4 SMUSSO 16 CM				
4	DIVARICATORE DI WEITLANER - BECKMANN SNODATO 3X4 SMUSSO 24 CM				
4	DIVARICATORE BECKMAN - EATON SNODATO 7X7 AFFILATO 32 CM				
4	CIOTOLE IN ACCIAIO INOX DA 1,5 LT				
4	CIOTOLE IN ACCIAIO INOX DA 1 LT				
4	CIOTOLE IN ACCIAIO INOX DA 1 LT				
4	CIOTOLE IN ACCIAIO INOX DA 750 CC				
4	CIOTOLE IN ACCIAIO INOX DA ½ LT				
4	CIOTOLE IN ACCIAIO INOX DA 50 CC				
4	VASSOIO IN ACCIAIO INOX DIM. 520X260X50 MM				
1	SET TUNNELING VASCOLARE "TIPO MARTIN"				
4	UNCINO PER VENA BROM PUNTA STRETTA				
4	UNCINO PER VENA BROM PUNTA LARGA				
4	UNCINO TRACHEALI JACKSON DOPPIO				

**CAPITOLATO TECNICO STRUMENTARIO CHIRURGICO PER CHIRURGIA
VASCOLARE**

	DESCRIZIONE	Q.tà
1	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 45° 18 cm.	6
2	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 60° 18 cm.	6
3	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 90° 18 cm.	2
4	Forbici di Dietrich punte acute angolate a 130° 18 cm.	4
5	Forbici di Mayo SuperEdge da dissezione curve 23 cm.	8
6	Forbici di Mayo-Stille rette 17 cm.	8
7	Forbici di Mayo-Stille curve 17 cm.	8
8	Forbici Metzenbaum curve 18 cm.	10
9	Forbici Metzenbaum curve 23 cm.	8
10	Forbici di Klinkenberg curve a "S" cm. 23	2
11	Forbici taglia filo metallico in tungsteno 12,5 cm.	2
12	Pinza vascolare di DeBakey morso 1,6mm. 20 cm.	4
13	Pinza vascolare di DeBakey morso 2mm. 20 cm.	10
14	Pinza vascolare di DeBakey morso 2mm. 24 cm.	4
15	Pinza chirurgica denti 1x2 18 cm.	8
16	Pinza chirurgica di Resano 23 cm.	6
17	Pinza emostatica di Pean curva 24 cm.	6
18	Pinza emostatica Halstead-Mosquito curva 12 cm.	30
19	Pinza emostatica di Crile curva 16 cm.	16
20	Pinza passafili di Mixter 18 cm.	8
21	Pinza passafili di Mixter 22 cm.	4
22	Pinza di O'Schagnessy a "L" 20 cm.	4
23	Pinza di O'Schagnessy curva 22 cm.	2
24	Pinza di Guion-Stille 23 cm.	2
25	Pinza Foerster anelli grandi zigrinati retta 25 cm.	4
26	Pinza Foerster anelli piccoli zigrinati retta 24 cm.	4
27	Pinza pressa-tubi di Mayo 18 cm.	4
28	Pinza di Allis morso atraumatico 25 cm.	4
29	Fermateli di Backhaus 13 cm.	10
30	Uncino di Crile smusso angolato a 90° 21 cm.	4
31	Microportaaggi di Jacobson con arresto a punte medie tungsteno 18 cm	8
32	Microportaaggi con arresto a punte fini retto per ago 6/0 con punte diamantate 18 cm	8
33	Microportaaggi con arresto a punte fini retto per ago 7/0 con punte diamantate 21 cm	4
34	Portagli di Debakey Magnagrip diamantato 20 cm.	0
35	Portagli di Hegar in tungsteno 20 cm.	12
36	Portagli di Hegar in tungsteno 25 cm.	4
37	Portagli di Debakey in tungsteno 18 cm.	4
38	Portagli di Debakey in tungsteno 20 cm.	12
39	Portagli di Debakey in tungsteno 25 cm.	4
40	Pinza Debakey x aneurisma aortico morso 7,5cm 27cm	2
41	Pinza sgorbia Stille-Luer 3 art. curva 22 cm.	2
42	Pinza tagliente Stille-Liston 3 art. curva 26 cm.	2
43	Tenaglia di Semb per ossa morso angolato 20 cm.	2
44	Costotomo di Stille-Giertz 25 cm.	2

CAPITOLATO TECNICO STRUMENTARIO CHIRURGICO PER CHIRURGIA
VASCOLARE

45	Periostotomo costale Doyen per adulti destro 17 cm.	2
46	Periostotomo costale Doyen per adulti sinistro 17 cm.	2
47	Periostotomo Maurer retto 12mm. 26 cm.	2
48	Periostotomo Maurer molto curvo 12mm. 26 cm.	2
49	Cucchiaio di Volkmann-Collin 19 cm.	4
50	Clamp Cooley atraumatico retto 22,5 cm	4
51	Clamp Cooley atraumatico retto 27 cm	4
52	Clamp Debakey morso ang. a 60° da 40mm. 23 cm.	4
53	Clamp Debakey morso ang. a 60° da 65mm. 25 cm.	4
54	Clamp Debakey per occlusione tangenziale 35mm. 19,5 cm.	4
55	Clamp Debakey per occl tangenziale 48mm. 26 cm.	4
56	Clamp di Cooley morso angolato per arteria iliaca 25cm	4
57	Clamp di Cooley per femorale angolata a 30° 17 cm.	4
58	Clamp di Cooley per femorale angolata a 60° 16 cm.	4
59	Clamp di Derra morso fine, piccolo 16 cm.	4
60	Clamp di Derra morso fine, medio 17cm.	4
61	Clamp di Derra morso fine, grande 18 cm.	4
62	Clamp di Satinsky morso da 54 mm lunghezza 26,5 cm	3
63	Clamp di Satinsky morso da 58 mm lunghezza 27,5 cm	3
64	Clamp Cleveland Clinic sinistro "baby renal, extra-fine", morso 1.7 mm	2
65	Clamp Cleveland Clinic destro "baby renal, extra-fine", morso 1.7 mm	2
66	Clips vascolari da aneurisma cerebrale per clampaggio carotide interna	8
67	Applicatore clips vascolari da aneurisma cerebrale	2
68	Cannula aspirazione Debakey testa svitab. da 9mm. 30,5cm.	8
69	Cannula aspirazione Frazier-Lempert diam. 4mm.	4
70	Punch aortico diametro 4mm. 15 cm.	1
71	Punch aortico diametro 5mm. 15 cm.	1
72	Mandrino per Turniquet cardiovascolare di Rumel	2
73	Bulldog di Senning a tensione regolabile	1
74	Dilatatore vascolare Garret malleab. 3mm. 14 cm.	4
75	Dilatatore vascolare Garret malleab. 1,5mm. 22 cm.	4
76	Dilatatore vascolare Garret malleab. 2mm. 22 cm.	4
77	Dissettore doppio olivecrona stretto 18 cm.	4
78	Pinza Kartchner pediatrica atraum. per carotide 10mm16 cm	4
79	Divaricatore addominale tipo " Codman Omni-tract" con set di valve intercambiabili per chirurgia addominale con la configurazione come segue: Configurazione del divaricatore autostatico addominale: N. 1 braccio principale per ancoraggio al tavolo operatorio dotato di due morsetti al fine di permettere contemporaneamente il posizionamento di bracci per divaricazione addominale e sottosternale. N. 1 braccio secondario con due morsetti, i morsetti devono essere indipendenti per permettere il posizionamento in qualunque posizione del braccio. N. 1 coppia di bracci a doppia angolatura questi devono essere poter essere agganciati ai morsetti da entrambe le estremità. N. 8 morsetti ad aggancio rapido.	11

**CAPITOLATO TECNICO STRUMENTARIO CHIRURGICO PER CHIRURGIA
VASCOLARE**

	N. 4 valve di Fritsch per parete addominale 60 x 50 mm N. 2 valve di Fritsch per parete addominale 80 x 80 mm N. 1 valva di retrazione Langenbeck malleabile 50 x 170 mm N. 1 valva di retrazione di Langenbeck malleabile con asta articolabile 50 x 170 mm N. 1 valva di retrazione renale con asta articolabile 25 x 150 mm N. 2 valve di retrazione di Deaver fenestrata malleabile 120 x 150 mm N. 2 valve di retrazione di Deaver fenestrata malleabile e asta articolabile 80 x 155 mm N. 1 valva di retrazione "Body Wall" 80 x 160 mm N. 1 container da sterilizzazione in alluminio anodizzato completo di due griglie interne. Dimensioni 600 x 285 x 200 mm	
80	Divaricatore costale inox Finocchietto medio valve 45x63 ap.21,5 cm.	2
81	Divaricatore costale inox Finocchietto grande valve 70x63 ap. 21,5cm	2
82	Divaricatore di Cloward 25 cm	0
83	Coppia divaricatori di Farabeuf 15 cm.	8
84	Coppia divaricatori di Mathieu 20 cm.	8
85	Divaricatore addominale Leriche 260x60mm- 27 cm.	4
86	Divaricatore addominale Leriche 300x45mm. 27 cm.	4
87	Divaricatore Harrington polmonare 127x45 mm. 32 cm.	2
88	Divaricatore Harrington polmonare 127x62 mm. 32 cm.	2
89	Divaricatore di Adson 3x4 smusso 26 cm	4
90	Divaricatore di Adson 4x4 smusso 30 cm	4
91	Divaricatore di Weitlaner 3x4 smusso 16 cm	4
92	Divaricatore di Weitlaner 3x4 smusso 20 cm	4
93	Divaricatore Weitlaner-Beckmann snodato 3x4 smusso 16 cm.	4
94	Divaricatore Weitlaner-Beckmann snodato 3x4 smusso 24 cm.	4
95	Divaricatore Beckman-Eaton snodato 7x7 affilato 32 cm	4
96	Ciotole in acciaio inox da 1,5 lt.	4
97	Ciotole in acciaio inox da 1lt.	4
98	Ciotole in acciaio inox da 750cc.	4
99	Ciotole in acciaio inox da 1/2 lt.	4
10		
0	Ciotole in acciaio inox da 50 cc.	4
10		
1	Vassoio in acciaio inox dim. 520x260x50 mm.	4
10		
2	Set tunneling vascolare "tipo Martin"	1
10		
3	Uncino per vena Brom punta stretta	4
10		
4	Uncino per vena Brom punta larga	4
10		
5	Uncino tracheale Jackson doppio	4



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

1) Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

2) Immediatamente esecutiva dal 29.01.2026

Agrigento, li 29.01.2026

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi