

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 613 DEL 26 MAR 2026

**OGGETTO:** Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando a mezzo RDO MePA ai sensi dell'art.76 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per l'acquisto di "n.1 strumentazione - Irradiatore a raggi x serie RADGIL2 completo di accessori + fornitura in somministrazione per anni due di materiale di consumo"  
- Approvazione atti ed autorizzazione a contrarre

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 740 DEL 26-3-2026

Il Funzionario Istruttore

Il Direttore F.F. U.O.C Provveditorato  
Dott.ssa Rosalia Calà

[Signature]  
Collaboratore Amministrativo P.le  
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:  
( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ C.E. C.P. Conti diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C.F. e P.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
E PATRIMONIALE  
Dr. Beatrice Salvato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 26 MAR 2026

L'anno duemilaventisei il giorno VENTISEI del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ORE 17:30

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante SABRINA TETRASI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PREMESSO CHE:

- con nota prot. 138725 del 04/09/2025, che si allega al presente atto, il dr. Pasquale Gallerano - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, ha richiesto, con apposito capitolato tecnico, che si allega al presente atto, la fornitura di n. 1 strumentazione "Irradiatore a raggi x di emocomponenti, completo di accessori destinato alla prevenzione della "transfusion associated graft versus host disease (GVDH) – (malattia del trapianto contro l'ospite);
- con nota prot. n. 152092 del 30/09/2025, che si allega al presente atto, il richiamato Direttore motivava le ragioni della richiesta di fornitura della strumentazione "Irradiatore a raggi x di emocomponenti, completo di accessori, e sulla stessa, giusta sua annotazione apposta a margine, il Direttore Generale di questa A.S.P. esprimeva parere favorevole all'acquisto;
- in data 10/10/2025, il dr. Pasquale Gallerano - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, ritrasmetteva la nota prot. n.138725 del 04/09/2025, in uno con la dichiarazione di unicità della società Gilardoni quale produttrice e distributrice dell'irradiatore a raggi x modello Radgil 2;
- per le vie brevi, trattandosi di strumentazione aventi caratteristiche di unicità, veniva richiesto al dr. Gallerano, di predisporre e trasmettere alla U.O.C. Servizio Provveditorato, l'apposito modello Allegato C, (così come previsto con delibera n. 496 de23/03/2022 avente ad oggetto "Approvazione regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni in regime di infungibilità ed esclusività di cui all'art. 63 del codice degli appalti D.lgs. 50/2016 e s.m.i), lo stesso, che si allega alla presente, veniva trasmesso in data 22/10/2025, regolarmente sottoscritto dallo stesso e munito di espresso parere favorevole del Direttore Sanitario pro tempore del P.O. di Sciacca.
- in ragione di quanto precede al fine di verificare l'esclusività o meno della suddetta fornitura, in data 07/11/2025 con nota prot. n.175286, che si allega al presente atto, sul sito web aziendale è stato pubblicato avviso di volontaria trasparenza, avente valore di interpello al mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso da questa Azienda, vi fossero altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura sopra descritta;
- In pari data con nota prot. n. 175433 alla società Gilardoni si richiedeva il preventivo di spesa necessario per determinare la base d'asta per procedere all'acquisto;
- In esito al superiore avviso di volontaria trasparenza nota pec del 11/11/2025, ha manifestato interesse la società Best Medical Italy Srl che, in uno alle schede tecniche ha comunicato con apposita dichiarazione di essere anch'essa produttrice e distributrice di irradiatori raggi x di emocomponenti di diverse dimensioni e caratteristiche;
- In data 12/11/2026, via e-mail sono state trasmesse ad - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, le schede tecniche e la dichiarazione presentata dalla società Best Medical Italy Srl per il necessario riscontro.
- In data 27/11/2025, con nota prot. n. 186921 il dr. Pasquale Gallerano - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, ha riscontrato nel merito, dichiarando le schede tecniche presentate dalla sopraccitata società non conformi (non conformità sostanziali rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara), motivo per il quale, è risultato opportuno, per il tramite della Direzione Amministrativa, avere un confronto con il dr. Gallerano al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno determinato le motivazioni di non conformità date dallo stesso avvenuto in data 19/12/2025
- nel suddetto incontro il Dr.Gallerano, ha esplicitato e motivato ulteriormente le ragioni della non conformità data alle schede tecniche presentate dalla società Best Medical Italy Srl, confermando quanto in precedenza relazionato – giusta nota con nota prot. n. 186921 del 27/11/2025, (non conformità sostanziali rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara),
- conseguentemente, le motivazioni di non conformità, sono state comunicate con nota prot. n. 8645 del 15/01/2026 a mezzo pec alla società Best Medical Italy Srl, a seguito di tale comunicazione non è stata presentata nessuna nota di osservazione.
- In ragione di quanto precede con nota prot. n. 21490 del 04/02/2026 si trasmetteva al dr. Gallerano, il preventivo di spesa in uno con le schede tecniche presentate dalla società Gilardoni, con nota pec del 10/11/2025, ciò nella considerazione del fatto che dal sopraccitato preventivo, risultavano essere esclusi e per i quali si poteva richiedere una quotazione a quanto di seguito:
  - ✓ interfacciamenti di qualsiasi tipo con qualsiasi software disponibile nel luogo d'installazione.
  - ✓ ogni eventuale mezzo di sollevamento per portare la merce al piano o comunque a destinazione con invito a verificare se come da capitolato tecnico erano da considerarsi obbligatori gli interfacciamenti di qualsiasi tipo con qualsiasi software disponibile nel luogo d'installazione, e su quale piano doveva essere installata la strumentazione "Irradiatore a raggi x di emocomponenti," si chiedeva altresì se l'attrezzatura

di che trattasi per il suo funzionamento necessitava di materiale di consumo dedicato ed in caso affermativo di comunicarne il relativo fabbisogno annuo.

- Con nota prot. n. 27354 del 11/02/2026 che si allega al presente atto, il dr. Gallerano nel riscontrare quanto richiesto con la nota sopracitata, allegava alla stessa nuovo capitolato tecnico, rivisitato ed aggiornato alla data del 11/02/2026, dichiarando al contempo che l'offerta economica presentata dalla società Gilardoni doveva includere:
  - ✓ le spese di posizionamento dell'attrezzatura
  - ✓ installazione e interfacciamento con il gestionale in uso presso la struttura trasfusionale
  - ✓ consumabili per irradiare circa 500 unità/anno e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria full risk
- conseguentemente con nota prot. n. 35033 del 24/02/2026 è stato richiesto, alla società Gilardoni, la presentazione di un nuovo preventivo comprensivo di tutte le voci così come dichiarato dal dr. Gallerano e specificamente:
  - ✓ spese di posizionamento dell'attrezzatura
  - ✓ installazione e interfacciamento con il gestionale in uso presso la struttura trasfusionale
  - ✓ consumabili per irradiatore circa 500 unità/anno
  - ✓ servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria full risk
- Con nota e-mail del 27/02/2026 la società Gilardoni, avuto riguardo alla richiesta di preventivo sopra citata, richiedeva una proroga del termine ultimo per l'invio dell'offerta per la seguente motivazione:  
*"la scrivente Ditta sta infatti attendendo l'offerta dal gestore del sistema informativo della struttura trasfusionale per potere garantire l'interfacciamento dell'apparecchiatura con il sistema in uso"*.
- In data 06/03/2026 la società Gilardoni ha presentato il preventivo relativo all'acquisto di che trattasi;
- Con nota prot. n. 42983 del 09/03/2026 la U.O.C. Provveditorato trasmetteva al dr. Gallerano il preventivo presentato dalla società Gilardoni, per il necessario riscontro, comunicando allo stesso che salvo diverse determinazioni, avrebbe provveduto alla istruzione dagli atti propedeutici all'indizione di gara;
- In riscontro alla nota sopracitata, il dr. Gallerano con nota prot. n. 43874 del 09/03/2026, custodita agli atti, comunicava la conformità dell'offerta economica presentata dalla società Gilardoni rispetto alle specifiche richieste dichiarando *"si ritiene possibile procedere agli atti propedeutici all'indizione di gara stante la conformità dell'offerta trasmessa"*

#### VISTO:

- l'annotazione apposta a margine, della nota prot. n. 152092 del 30/09/2025, con la quale il Direttore Generale di questa A.S.P esprimeva parere favorevole all'acquisto della strumentazione di che trattasi;
- la dichiarazione, che si allega al presente atto, presentata dalla società Gilardoni nella quale dichiara che:
  - ✓ Gilardoni Raggi X è l'unico produttore europeo di irradiatori raggi x
  - ✓ Gilardoni Raggi X produce e commercializza in esclusiva l'irradiatore a raggi x modello RADGIL2
  - ✓ Gilardoni Raggi X è dotata di una rete di manutenzione capillare che comprende anche due sedi in Sicilia con la presenza di n. 5 tecnici specializzati dipendenti
- l'art. 76 comma 2, lettera b, D.lgs 36/2023 che consente, nel caso in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici che il contratto possa essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso dell'acquisto diretto;

#### RILEVATO:

- che al fine di evadere la richiesta prot. 138725 del 04/09/202, allegata al presente atto, ove veniva specificato che la fornitura di n. 1 strumentazione "Irradiatore a raggi x di emocomponenti, completo di accessori è destinato alla prevenzione della "transfusion associated graft versus host disease (GVHD) – (malattia del trapianto contro l'ospite) e possibile procedere all' acquisto a mezzo RDO MePA di "n.1 strumentazione "Irradiatore a raggi di emocomponenti, ai sensi dell'art dell'art.76 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023

**CHE:**

- a tal fine sono stati redatti i seguenti atti:
  - ✓ capitolato tecnico a firma del Direttore richiedente
  - ✓ lettera invito
  - ✓ allegato "A" e "B" prospetto per la formulazione dell'offerta economica
- in ragione della tipologia della fornitura richiesta l'appalto è costituito da un unico lotto per un importo complessivo a base d'asta in € 220.990,00 IVA esclusa, + € 4.418,00 2% di competenze interne di funzioni tecniche ex art 45 del D.lgs. 36/2023;
- che la base d'asta per l'acquisto di che trattasi pari a € 220.900,00 IVA esclusa, è stata determinata, sulla base del preventivo di spesa presentato dalla società Gilardoni, in data 06/03/2026, custodito agli atti;

**PRECISARE:**

- che le risorse economiche complessivamente necessarie per l'esecuzione della fornitura ammontano complessivamente ad € 199.887,50 oltre IVA, + competenze interne ex art 45 D.lgs 36/2023 (2% dell'importo di gara, pari ad € 4.418,00 di cui lo 1,60 per funzioni tecniche e lo 0,40 per quota fondo innovazione) ed € 292.40 per IRAP come quadro economico che di seguito si riporta:

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando a mezzo RDO MePA ai sensi dell'art. 76 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per l'acquisto di di n. 1 strumentazione "Irradiatore a raggi x di emocomponenti, completo di accessori destinato alla prevenzione della "transfusion associated graft versus host disease (GVDH) – (malattia del trapianto contro l'ospite) + fornitura in somministrazione per anni due di materiale di consumo	€ 220.900,00
Iva aliquota 22%	€ 48.598,00
Competenze interne ex art 45 Dlgs.36/2023	€ 4.418,00 di cui: € 3.534,00 (80% per funzioni tecniche ex art 45 Dlgs.36/2023) - C516040606 € 883,00 20% per quota fondo innovazione ex art 45 Dlgs.36/2023) - <del>P202050607</del> C 516040607
IRAP	€ 300,39 (8,5 % sulle funzioni tecniche)
Totale	€ 274.261,39

**DARE ATTO:**

- che la spesa complessiva nascente dall'adozione del presente atto è pari ad € 269.498,00 IVA inclusa + € 4.300,00 per competenze interne ex art 45 D.lgs 36/2023 + € 300,39 per IRAP deve essere imputata conti economici come di seguito indicato:  
 € 267.302,00 IVA compresa sul conto economico P201020704 – Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in C/Esercizio da Regione – Investimenti futuri di cui alla Delibera DG n..722 del 21/10/2025  
 € 300,39 sul conto economico C901010101 per IRAP bilancio d'esercizio 2026  
 € 4.418,00 sul conto economico C516040606 e P202050601 bilancio d'esercizio 2026  
 €1.098,00 sul conto economico C501010702 bilancio d'esercizio 2026  
 €1.098,00 sul conto economico C501010702 bilancio d'esercizio 2027

- che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale interessato ex art 45 D.lgs 36/2023 e nel rispetto del regolamento aziendale come da ordine di servizio prot. n. 54434 del 26/03/2026, custodito agli atti;

#### **RITENUTO:**

- di dover nominare ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 responsabile unico del progetto la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C.) - punto istruttore Consip/MePA ;
- di individuare, altresì, quale direttore esecutivo del contratto (DEC) il dr. Pasquale Gallerano - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art. 8 comma 4 all.to 1.2. e dall'art. 32 commi 2e3 all.to II.14 del D.lgs. 36/2023 *“per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento “ ;*

#### **PROPONE**

Per le argomentazioni esposte in premessa:

- 1) **PRENDERE ATTO** della nota prot. 138725 del 04/09 /2025, che si allega al presente atto, con la quale il dr. Pasquale Gallerano - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, ha richiesto, con apposito capitolato tecnico, che si allega al presente atto, la fornitura di n. 1 strumentazione “Irradiatore a raggi x di emocomponenti, completo di accessori destinato alla prevenzione della “transfusion associated graft versus host disease (GVDH) – (malattia del trapianto contro l'ospite);
- 2) **PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 152092 del 30/09/2025, allegata al presente atto, con la quale il dr. Gallerano - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, motivava le ragioni della richiesta di fornitura della strumentazione “Irradiatore a raggi di emocomponenti, completo di accessori, e sulla stessa, giusta sua annotazione apposta a margine, il Direttore Generale di questa A.S.P esprimeva parere favorevole all'acquisto;
- 3) **AUTORIZZARE** la Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando a mezzo RDO MePA ai sensi dell'art. 76 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per l'acquisto di di n. 1 strumentazione “Irradiatore a raggi x di emocomponenti, completo di accessori destinato alla prevenzione della “transfusion associated graft versus host disease (GVDH) – (malattia del trapianto contro l'ospite) + fornitura in somministrazione per anni due di materiale di consumo
- 4) **DARE ATTO** che l'appalto è costituito da un unico lotto
- 5) **APPROVARE** i seguenti atti:
  - ✓ capitolato tecnico (a firma del Direttore richiedente)
  - ✓ lettera invito
  - ✓ allegato “A” e “B” prospetto per la formulazione dell'offerta economica
- 6) **DARE ATTO** che la spesa complessiva nascente dall'adozione del presente atto è pari ad € 269.498,00 IVA inclusa + € 4.300,00 per competenze interne ex art 45 D.lgs 36/2023 + € 300,39 per IRAP deve essere imputata conti economici come di seguito indicato:
  - € 267.302,00 IVA compresa sul conto economico P201020704 – Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in C/Esercizio da Regione – Investimenti futuri di cui alla Delibera DG n..722 del 21/10/2025
  - € 300,39 sul conto economico C901010101 per IRAP bilancio d'esercizio 2026
  - € 4.418,00 sul conto economico C516040606 e P202050601 bilancio d'esercizio 2026
  - €1.098,00 sul conto economico C501010702 bilancio d'esercizio 2026
  - €1.098,00 sul conto economico C501010702 bilancio d'esercizio 2027
- 7) **DARE ATTO** che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale interessato ex art 45 D.lgs 36/2023 e nel rispetto del regolamento aziendale come da ordine di servizio prot. n. 54434 del 26/03/2026, custodito agli atti;
- 8) **NOMINARE** ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 responsabile unico del progetto la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C.) - punto istruttore Consip/MePA e quale

direttore esecutivo del contratto (DEC) il dr. Pasquale Gallerano - Direttore dell'U.O.C. Centro Trasfusionale - del P.O. di Sciacca, come previsto nei casi di cui al combinato disposto dall'art. 8 comma 4 all.to 1.2. e dall'art. 32 commi 2e3 all.to II.14 del D.lgs. 36/2023 "per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";

9) **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse.

10) **CURERÀ** l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato, ed il S.E.F. ognuno per le proprie competenze; *che si dichiara immediatamente esecutivo*

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Rosalia Calà

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere FAVOREVOLE

Data 26/03/2026

Parere Favorevole

Data 25/03/2026

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore F.F. della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Rosalia Calà Direttore F.F. della U.O.C. Provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Giuseppe Capodièci

Il Segretario verbalizzante

Sig.ra SABRINA TERRASI

Collaboratore Amm. Professionale

*S. Terrasi*



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Distretto Ospedaliero AG 2  
"Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca"  
Unità Operativa di Medicina Trasfusionale  
DIRETTORE DOTT. PASQUALE GALLERANO

Prot 138725 del 04.09.2025

Al Direttore UOC Provveditorato  
ASP AGRIGENTO

**Oggetto: richiesta di IRRADIATORE A RAGGI X DI EMOCOMPONENTI  
per la prevenzione della "transfusion associated graft versus host disease (ta-gvhd)"**

Per la Banca del Sangue Cordonale si richiede l'attrezzatura irradiatore a raggi X con i seguenti requisiti minimi:

L'apparecchiatura deve essere automatica, semplice all'utilizzo, dotata di sistemi di sicurezza affidabili e in grado di trattare simultaneamente almeno 5 sacche di emazie concentrate o di piastrine concentrate.

Le sacche devono essere caricate in un cestello radiotrasparente (in carbonio), ROTANTE per assicurare una migliore omogeneità della dose su tutto il volume da irradiare.

La sorgente di alimentazione del tubo a raggi X deve generare un rateo di dose non inferiore a 5Gy/min, misurati con cestello completo di simulanti di acqua solida. Il tempo massimo per fornire una dose di 30 Graynon deve superare i 7 minuti.

Il fornitore deve fornire un protocollo di dosimetria periodica e la strumentazione necessaria per le misure (elettrometro e simulanti in acqua solida), completo di IQ/OQ, in modo tale da consentire una facile verifica delle prestazioni della macchina. Il sistema deve garantire una dose non inferiore a 25Gy e non superiore a 50Gy sull'intero volume disponibile, indipendentemente dal numero di sacche caricate e come previsto dalle Linee Guida Europee.

Il sistema deve includere una verifica automatica del flusso di raggi X, affinché nel tempo non si discosti dal valore di fabbrica e in caso di variazioni rilevanti (oltre il 15%), il sistema dovrà segnalarlo e NON permettere il proseguo dell'irradiazione. La macchina deve garantire continuità di lavoro senza riposo e per minimo 20 cicli consecutivi.

#### INTERFACCIA UTENTE

L'accesso all'interfaccia utente deve essere protetto da password con almeno tre livelli di autorizzazione in funzione dei diversi privilegi degli utilizzatori. Le impostazioni dovranno consentire all'amministratore di avere accesso completo ai parametri macchina, all'operatore di poter utilizzare l'attrezzatura senza possibilità di modifiche oltre al tecnico di assistenza che dovrà avere totale accesso al sistema. L'interfaccia Utente deve essere intuitiva e completa preferibilmente con monitor touch-screen. Inoltre, il sistema deve prevedere un sistema di protezione dei dati e della configurazione di sistema protetto da UPS (batteria tampone) anche in caso di black-out elettrico.


#### SALVATAGGIO E TRASFERIMENTO DEI DATI

Il sistema deve prevedere la tracciabilità delle informazioni inerenti ogni singola sacca trattata e includere almeno un allarme in caso si tenti di irradiare una sacca già irradiata in precedenza.

L'apparecchiatura deve almeno includere:

- Un lettore di codici a barre in grado di leggere almeno tre etichette barcode per ogni sacca (CDM, Tipo emocomponente, lotto delle etichette dosimetriche di avvenuto irradiazione);
- Una stampante in grado di produrre delle etichette adesive contenenti i dati essenziali di ogni ciclo di irradiazione: dose, seriale della macchina, ID dell'operatore, data, irradiazione completata SI/NO;
- Un database interno, popolato e aggiornato costantemente;





Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Distretto Ospedaliero AG 2  
"Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca"  
Unità Operativa di Medicina Trasfusionale  
DIRETTORE DOTT. PASQUALE GALLERANO

Prot n 152092 del 30.09.2025

Al Direttore Generale  
Direttore Sanitario  
Direttore Amministrativo  
Direttore UOC Provveditorato  
ASP AGRIGENTO

Oggetto: richiesta irradiatore a raggi x di emocomponenti - motivazioni per l'acquisto

Con riferimento all'oggetto e alla nota Prot 138725 del 04.09.2025 con la quale si richiede il noleggio / acquisto di un IRRADIATORE A RAGGI X DI EMOCOMPONENTI destinato alla prevenzione della "transfusion associated graft versus host disease (GVDH)" si espongono di seguito le motivazioni per le quali tale acquisizione risulta necessaria e vantaggiosa per l'Azienda Asp di Agrigento.

Attualmente l'azienda Asp di Agrigento, non dispone di un irradiatore a raggi x per emocomponenti, sebbene l'irradiazione rappresenti una procedura obbligatoria prevista dalle linee guida nazionali e internazionali ( SIMTI, AABB, EHA, WHO) per la prevenzione, nei pazienti fragili, della GVDH post Trasfusionale.

Le unità necessarie ai pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'Asp di Agrigento attualmente sono trasfuse non irradiate se urgenti (con possibili rischi derivanti dalla mancata irradiazione) o trasferite presso le altre strutture regionali con conseguenti costi e ritardi nelle trasfusioni .

Tale procedura è indispensabile per la tutela dei pazienti fragili immunocompromessi (pazienti trapiantati, oncologici, ematologici, neonati prematuri, etc) al fine di prevenire una complicanza ad alto tasso di mortalità e non sussiste nessun altro dispositivo/ attrezzatura in grado di poter sostituire l'irradiazione.

Inoltre, l'Asp di Agrigento rappresenta un polo di eccellenza per la disponibilità di emocomponenti innovativi derivanti dal sangue cordonale poiché nel suo territorio insiste la Banca del sangue Cordonale, Centro di riferimento della Regione Siciliana per i requisiti posseduti e l'attività svolta.

Come è noto, con il supporto della Direzione Strategica , tale struttura è in procinto di intraprendere un trial clinico che prevede la trasfusione con globuli rossi da sangue cordonale a favore dei neonati prematuri, ricoverati presso le UTIN del territorio siciliano, che rappresentano per eccellenza i pazienti piu' fragili nel panorama sanitario: in tali casi , l'irradiazione degli emocomponenti è requisito indispensabile e non differibile.

In mancanza di tale attrezzatura, all'attivazione del trial clinico, sarà necessario predisporre quotidianamente il trasporto di tali unità verso un centro che puo' effettuare tale trattamento con i relativi costi di trasporto e per l'attività richiesta al centro che dispone di tale attrezzatura e che effettuerà la prestazione.

Ad oggi, per irradiare le unità necessarie alla tutela di tale tipologia di pazienti, è necessario trasferire ogni unità necessaria presso altri Centri regionali ( a Catania presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale S. Marco o a Palermo presso il Centro Trasfusionale di Villa Sofia e la Casa di Cura la Maddalena) con conseguenti tempi di attesa , costi aggiuntivi di trasporto e possibili rischi clinici derivanti dal ritardo delle trasfusioni.

L'acquisto/noleggio di un irradiatore a raggi x consentirebbe invece:

- di ridurre i costi di trasporto e i rischi organizzativi legati alla dipendenza da altri centri;
- di rafforzare il ruolo dell'Asp di Agrigento come polo di eccellenza e di poter diventare centro fornitore di servizi di irraggiamento di unità per le Asp vicine quali Caltanissetta, Enna, Trapani etc
- di rafforzare il ruolo della Banca del Sangue Cordonale in grado di poter fornire emocomponenti già irradiati e pronti alla trasfusione.

A fronte di quanto sopra, pur prevedendo un investimento iniziale (pari a circa 50.000, 00 euro per 5 anni in caso di noleggio con riscatto al termine) i benefici economici e clinici derivanti dall'uso in sede dell'apparecchiatura risultano superiori ai costi, sia per la riduzione delle spese che per la prevenzione delle complicanze gravi e onerose nei pazienti. In conclusione , l'acquisto dell'irradiatore a raggi x per emocomponenti si configura come necessario , urgente e strategico per l'Asp di Agrigento sia per garantire la sicurezza trasfusionale che per consolidare il ruolo dell'Azienda quale Centro di riferimento di eccellenza

Dott Pasquale Gallerano

*per il presidente per acquisto*

IL DIRETTORE GENERALE  
ASP AGRIGENTO  
Dott. Giuseppe Capodice

**RICHIESTA ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI, PRESIDI MEDICI CHIRURGICI, DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE O ALTRI MATERIALI SANITARI DA UN PRODUTTORE/FORNITORE PREDETERMINATO (INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI)**

Unità operativa richiedente: UOC MEDICINA TRASFUSIONALE PO GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA

Prodotto e caratteristiche tecniche: dispositivo medico che utilizza un flusso di raggi X ad alta intensità per irradiare emocomponenti in sacche di plastica, quando è indicata la prevenzione della TA-GvHD (Transfusion Associated-Graft versus Host Disease).

Codice repertorio nazionale : \_\_\_\_\_

Esigenze che stabiliscono l'acquisto presso operatore determinato:

X NEL REPERTORIO AZIENDALE NON SONO DISPONIBILI I PRODOTTI CON CARATTERISTICHE CHE GARANTISCONO SOLUZIONI EQUIVALENTI IN TERMINI DI PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI FATTE SALVE LE VARIABILITÀ INDIVIDUALI;

I PRODOTTI PRESENTI IN REPERTORIO EQUIVALENTI HANNO REQUISITI FUNZIONALI CHE COMPORTANO INCOMPATIBILITÀ O DIFFICOLTÀ TECNICHE SPROPORZIONATE PER IL LORO IMPIEGO;

DETTAGLIARE LA MOTIVAZIONE: L'APPARECCHIATURA IRRADIATORE PER EMOCOMPONENTI E' INDISPENSABILE PER EFFETTUARE LA TRASFUSIONE NEI NEONATI PREMATURI E NEI PAZIENTI FRAGILI (PAZIENTI IN CHEMIOTERAPIA O IN ATTESA DI TRAPIANTO). IN SICILIA ESISTONO SOLO TRE APPARECCHIATURE PER IRRADIARE LE UNITA' (CATANIA E PALERMO) E TALE BENE DA ACQUISIRE RISULTA VANTAGGIOSO PER LAZIENDA ASP AGRIGENTO

PRODUTTORE : GILARDONI SPA

Società Distributrice: GILARDONI SPA


Costo preventivato per l'acquisto : circa € 190.000,00

Stima dei consumi annuali : costi per manutenzione ordinaria e straordinaria da quantificare se non inclusi in garanzia


**DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITÀ**

I sottoscritti consapevoli delle conseguenti responsabilità di natura disciplinare e deontologica, amministrativo-contabile per danno erariale e penale, dichiarano che per le indicazioni sopra specificate nel repertorio nazionale, non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali.

data 22-10-25

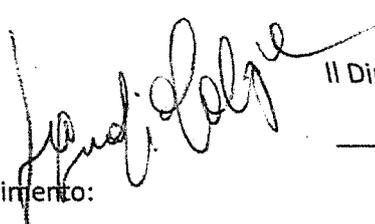

Il Direttore dell'Unità Operativa richiedente

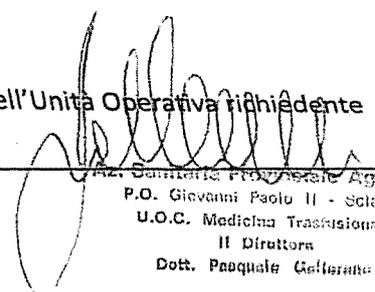

PARERE del Direttore del P.O di riferimento:

Favorevole con restrizione di impiego

Azi. Sanitaria Provinciale Agrigento  
P.O. Giovanni Paolo II - Sciacca  
U.O.C. Medicina TrASFusionale  
Il Direttore  
Dott. Pasquale Galliano

Favorevole subordinato alla definizione di schede di monitoraggio e/o raccomandazioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle strumentazioni proposte

sospensione del parere con richiesta di approfondimenti e/o ulteriore documentazione

CONTRARIO (MOTIVARE): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data 22-10-2025

Firma \_\_\_\_\_  
Il Direttore Sanitario D.R.  
Ospedale Giovanni Paolo II Sciacca  
Dr. Ignazio Galizia

PARERE direttore U.O.C Farmacia Ospedaliera:

FAVOREVOLE       CONTRARIO

Data 22/10/2025

ASP AG 1 - DISTRETTO AG 2 SCIACCA  
U. O. DI FARMACIA  
Direttore Farmacista  
Dott.ssa Lilly Russo  
Firma \_\_\_\_\_



**U.O.C. Medicina Trasfusionale**  
**P.O. Giovanni Paolo II Sciacca**  
**ASP 1 AGRIGENTO**  
**Direttore: dott. P.Gallerano**

Prot. n. 27354 del 11.02.2026

Al Direttore  
U.O.C. Provveditorato  
ASP Agrigento

Oggetto: Acquisizione irradiatore – richiesta integrazione offerta economica Ditta Gilardoni

Con riferimento alla nota Prot. n. 21490 del 04.02.2026, preso atto della conformità tecnica dell'attrezzatura proposta, si chiede di voler richiedere alla Ditta Gilardoni S.p.A. l'integrazione dell'offerta economica relativa all'acquisizione dell'irradiatore, includendo:

- trasporto e posizionamento dell'attrezzatura presso i locali individuati al piano terra della struttura;
- installazione e collaudo dell'apparecchiatura;
- interfacciamento con il gestionale in uso presso il Servizio Trasfusionale;
- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria full risk per tutto il periodo di garanzia, con possibilità di estensione dello stesso per gli anni successivi.
- Materiale di consumo ( indicatori di Irradiazione) per 500 unità/anno

Si allega alla presente capitolato con requisiti minimi per Irradiatore Emocomponenti rivisitato ed aggiornato alla data odierna.

Cordiali saluti.

Sciacca, 11.02.2026

Il Direttore  
U.O.C. Medicina Trasfusionale  
Dott. Pasquale Gallerano



**U.O.C. Medicina Trasfusionale**  
**P.O. Giovanni Paolo II Sciacca**  
**ASP 1 AGRIGENTO**  
**Direttore: dott. P.Gallerano**

**Al Direttore**

**U.O.C. Provveditorato**

**ASP Agrigento**

**Oggetto: richiesta di IRRADIATORE A RAGGI X DI EMOCOMPONENTI per la prevenzione della "transfusion associated graft versus host disease (ta-gvhd)"**

Per la Banca del Sangue Cordonale si richiede l'attrezzatura irradiatore a raggi X con i seguenti requisiti minimi:

L'apparecchiatura deve essere automatica, semplice all'utilizzo, dotata di sistemi di sicurezza affidabili e in grado di trattare simultaneamente almeno 5 sacche di emazie concentrate o di piastrine concentrate.

Le sacche devono essere caricate in un cestello radiotrasparente (in carbonio), ROTANTE per assicurare una migliore omogeneità della dose su tutto il volume da irradiare.

La sorgente di alimentazione del tubo a raggi X deve generare un rateo di dose non inferiore a 5Gy/min, misurati con cestello completo di simulanti di acqua solida. Il tempo massimo per fornire una dose di 30 Gray non deve superare i 7 minuti.

Il fornitore deve fornire un protocollo di dosimetria periodica e la strumentazione necessaria per le misure (elettrometro e simulanti in acqua solida), completo di IQ/OQ, in modo tale da consentire una facile verifica delle prestazioni della macchina. Il sistema deve garantire una dose non inferiore a 25Gy e non superiore a 50Gy sull'intero volume disponibile, indipendentemente dal numero di sacche caricate e come previsto dalle Linee Guida Europee.

Il sistema deve includere una verifica automatica del flusso di raggi X, affinché nel tempo non si discosti dal valore di fabbrica e in caso di variazioni rilevanti (oltre il 15%), il sistema dovrà segnalarlo e NON permettere il proseguo dell'irradiazione. La macchina deve garantire continuità di lavoro senza riposo e per minimo 20 cicli consecutivi.

#### **INTERFACCIA UTENTE**

L'accesso all'interfaccia utente deve essere protetto da password con almeno tre livelli di autorizzazione in funzione dei diversi privilegi degli utilizzatori. Le impostazioni dovranno consentire all'amministratore di avere accesso completo ai parametri macchina, all'operatore di poter utilizzare l'attrezzatura senza possibilità di modifiche oltre al tecnico di assistenza che dovrà avere totale accesso al sistema. L'interfaccia Utente deve essere intuitiva e completa preferibilmente con monitor touch-screen. Inoltre, il sistema deve prevedere un sistema di protezione dei dati e della configurazione di sistema protetto da UPS (batteria tampone) anche in caso di blackout elettrico.

#### **SALVATAGGIO E TRASFERIMENTO DEI DATI**

Il sistema deve prevedere la tracciabilità delle informazioni inerenti ogni singola sacca trattata e includere almeno un allarme in caso si tenti di irradiare una sacca già irradiata in precedenza.

L'apparecchiatura deve almeno includere:

- Un lettore di codici a barre in grado di leggere almeno tre etichette barcode per ogni sacca (CDM, Tipo emocomponente, lotto delle etichette dosimetriche di avvenuto irradiazione);

- Una stampante in grado di produrre delle etichette adesive contenenti i dati essenziali di ogni ciclo di irradiazione: dose, seriale della macchina, ID dell'operatore, data, irradiazione completata SI/NO;
- Un database interno, popolato e aggiornato costantemente;
- I dati contenuti nel database devono essere facilmente esportabili tramite penna USB o connessione Ethernet, in un formato facilmente gestibile come.csv, txt, XLM.
- Preferibilmente il sistema dovrà essere fornito di computer direttamente collegabile all'irradiatore, completo di software in grado di elaborare i dati provenienti dal sistema RADGIL2 e di generare REPORT personalizzabili per periodi di tempo, ID operatore e ID sacca ai fini dell'archiviazione informatica e cartacea delle procedure di irradiazione: il software deve anche poter inoltrare copia del file di trasferimento, in uno dei formati già citati, all'interno di una qualsiasi percorso fornito dall'IT

#### **ALIMENTAZIONE ELETTRICA E INGOMBRI MASSIMI**

400 VAC, 50Hz, trifase

Dimensioni massime 2000H x 1500L x 900P mm

#### **RAFFREDDAMENTO DEL SISTEMA**

Ad acqua con consumo non superiore a 6 L/min.

In alternativa, proporre sistema di raffreddamento autonomo (water chiller) con capacità sufficiente per garantire un utilizzo continuativo dell'apparecchiatura.

#### **MARCATURA CE**

Dispositivo Medico di Classe IIB, registrato nel Repertorio del Ministero della Salute.

Obbligatoria la presenza di tecnici certificati in zona con centri di assistenza tecnica regionale da dichiarare.

Si richiede manutenzione full risk assistenza tecnica, chiamate illimitate e tutti pezzi di ricambio con tempi di intervento di 36 ore max per tutto il periodo di garanzia.


Si richiedono inoltre Indicatori di Irradiazione per 500 unità/anno

Il Direttore

U.O.C. Medicina Trasmfusionale

Dott. Pasquale Gallerano

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: U.O.C. Medicina Trasmfusionale, U.O.C. Medicina Trasmfusionale, and Dott. Pasquale Gallerano. The signature is written in a cursive style.

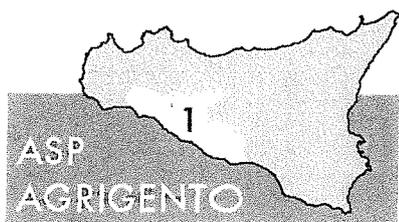

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**  
**Tel. 0922407645 -**  
**Email – [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)**

Prot. n.            del

Alla Società Gilardoni S.p.A.  
Via Arturo Gilardoni 1,  
23826 Mandello del Lauro (LC)

**OGGETTO:** Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando a mezzo RDO MePA ai sensi dell'art 76 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per l'acquisto di "n.1 strumentazione - Irradiatore a raggi x serie RADGIL2 completo di accessori + fornitura in somministrazione per anni due di materiale di consumo"

Con deliberazione n.            del            è stata autorizzata la trattativa diretta ai sensi dell'art. 76, comma2, lettera b, del D.lgs 36/2023 per l'acquisto di n. 1 strumentazione "Irradiatore a raggi x serie RADGIL2 completo di accessori + fornitura in somministrazione per anni due di materiale di consumo".

Caratteristiche tecniche: come da capitolato tecnico

L'appalto è costituito da un unico lotto

Importo a base d'asta € 220.900,00 IVA esclusa

In merito alla presenza di rischi da interferenze ex art 26, comma3 bis. D.lgs 81/08, e ss.mm. ii, si precisa che non è stato predisposto D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi ambientali da interferenze da valutare stante che la fornitura sarà eseguita in orari di chiusura e, comunque senza la presenza di terzi. Gli oneri della Sicurezza sono, pertanto pari a zero.

Restano comunque immutati gli obblighi a carico della società aggiudicataria in merito alla sicurezza sul lavoro.

La fornitura, costituita da un unico lotto, sarà aggiudicata, ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023, in presenza di offerta valida, secondo il criterio del minor prezzo, previo giudizio di conformità tecnica.

la consegna della strumentazione completa di accessori dovrà essere effettuata, franco di ogni e qualsiasi spesa, presso la sede che verrà indicata nell'ordine, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ordinativo.

La società aggiudicataria si impegna a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo, a garantire il trasporto al piano, l'installazione della strumentazione, la formazione del personale per un corretto e sicuro utilizzo della macchina e il contestuale ritiro degli imballi a collaudo ultimato.

Il collaudo dovrà effettuarsi entro 30gg. dalla data di installazione.

Il collaudo relativo alla strumentazione di che trattasi (completa di accessori), previa verifica di conformità in ossequio all'art.116 del D.lgs 36/2023 dovrà essere effettuato con la redazione di apposito verbale firmato da entrambe le parti contraenti, nel verbale di collaudo si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda.

La strumentazione offerta dovrà avere una garanzia per vizi e difetti derivanti dal processo di fabbricazione Full risk che possano manifestarsi in un periodo minimo di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data di collaudo, senza oneri a carico di questa A.S.P. periodo entro il quale dovrà essere garantito il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria full risk, con l'obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica.

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere effettuati entro 24 ore dalla chiamata telefonica e completati entro 36 ore max.

Dovrà altresì essere garantito l'interfacciamento dell'apparecchiatura con il sistema in uso presso Servizio Trasfusionale del P.O. di Sciacca.

Le forniture relative al materiale di consumo dovranno essere effettuate, franco di ogni e qualsiasi spesa, entro 7 giorni dal ricevimento della commessa d'ordine, presso la sede che verrà indicata nell'ordine, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, di tutti i giorni feriali, nei quantitativi che saranno specificati di volta in volta negli ordinativi. Nei casi di emergenza, le consegne dovranno essere effettuate tempestivamente.

E' obbligo della ditta aggiudicataria la formazione al personale medico, sanitario e tecnico che utilizzerà tale apparecchiatura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione

La strumentazione da fornire completa di accessori ed il relativo materiale di consumo sono espressamente indicati nel capitolato tecnico che forma parte integrante della presente lettera invito.

Im merito al materiale di consumo si precisa che i quantitativi indicati nel sopra citato capitolato tecnico devono intendersi quale dato di previsione dei consumi, (fabbisogno annuo) quindi sono da considerare meramente indicativi, gli stessi possono variare in più o in meno, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle reali necessità, senza che la ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazione del prezzo offerto.

Codesta società dovrà produrre quale documentazione amministrativa:

- 1) Copia della presente lettera invito firmata in uno con il capitolato tecnico per accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa contenuto
- 2) DGUE debitamente compilato e firmato
- 3) l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., e l'indicazione del codice NSO
- 4) di accettare le comunicazioni art 96 d.lgs.36/2023 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma Me.PA. e tramite PEC indicando il relativo indirizzo
- 5) 5)dichiarazione del produttore di esclusiva produzione e della commercializzazione e/o distribuzione in capo a questa ditta del materiale richiesto
- 6) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del Contributo dovuto all'ANAC -

Codesta società altresì dovrà presentare quale documentazione tecnica:

- 1) documentazione tecnica, e dépliant illustrativi, redatte/i in lingua italiana e/o inglese, in originale o dalle quali evincere il possesso delle caratteristiche richieste
- 2) certificati di conformità alle norme e alle Direttive CE in originale o copia conforme all'originale

Quant'altro la ditta ritenga indispensabile o utile fornire per il buon funzionamento del sistema proposto o per dimostrare la corrispondenza alle caratteristiche richieste per il lotto come da capitolato tecnico.

In merito alla presentazione delle schede tecniche si precisa quanto segue:

La nuova rimodulazione del sistema MePA /CONSIP ad oggi, non consente alle ditte partecipanti la creazione della busta tecnica nel caso di T.D. RDO evoluta e/o semplice.

Pertanto, sarà accettata la presentazione della documentazione tecnica dei prodotti offerti in uno alla documentazione Amministrativa, fermo restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 101 del Dlgs 36/2023.

Oltre alla formulazione dell'offerta economica generata dal Sistema l'operatore economico, per il lotto/i per il quale/i partecipa dovrà formulare la propria offerta economica conformemente allo schema di offerta allegato "A" e "B" compilato di dati e costi richiesti.

Il prezzo unitario offerto per ogni singolo prodotto indicato nel lotto, espresso in cifre e in lettere, potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due cifre decimali, in cifre e lettere, I.V.A. esclusa;

Nel caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente.

Il totale del lotto espresso in cifre e in lettere, iva esclusa per il quale la società intende partecipare.

La mancanza di una singola voce all'interno del lotto per il quale si partecipa determina l'esclusione dalla gara.

Non saranno prese in considerazione le offerte alla pari o in aumento rispetto alla base d'asta indicata.

La società potrà svincolarsi dalla propria offerta soltanto dopo 180 giorni dalla data di effettuazione della gara, qualora entro tale termine non intervenga l'aggiudicazione definitiva.

L'offerta economica, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare, in caso di Ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, per il lotto per il quale si partecipa. In caso di raggruppamento di imprese già costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal mandatario a cui i mandanti hanno conferito il mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, e dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

La società aggiudicataria dovrà produrre a garanzia della regolare esecuzione del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 5% del valore totale del contratto da costituirsi tramite fidejussione bancaria o assicurativa resa nei modi stabiliti dall'art. 117 del D.lgs 36/2023

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera d'invito si rimanda a quanto previsto nell'allegato capitolato tecnico che qui si intende ripetuto e trascritto, così come accettato ed approvato.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art.101 del D.lgs. 36/2023.

In ogni caso non sarà possibile sanare carenze afferenti all'offerta tecnica ed economica, come anche, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari altresì, si impegna collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art. 8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana").

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione di contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata

È inoltre causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dall'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula del contratto n. 1410 del 09/02/2009.

Questa Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale sul valore del contratto nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto pari all'1% dell'importo contrattualizzato per ogni g giorno naturale o successivo di ritardo nella misura del 5% per la mancata consegna, fino alla concorrenza del 10% sull'imponibile

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con i fondi -Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in C/Esercizio da Regione – Investimenti futuri di cui alla Delibera DG n..722 del 21/10/2025.

Il pagamento delle fatture inerenti alla fornitura di che trattasi, avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa, in conformità al D.lgs.231/2002, come modificato dal d.lgs.192/2012, previa attestazione sulla regolarità della fornitura, la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa A.S.P. ed al corrispondente documento di trasporto.

Nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto verrà applicata una penale pari all' 1% del valore dell'ordine per ogni giorno naturale o successivo di ritardo, nel caso in cui l'ordine sia stato evaso solo parzialmente, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque, restituito con spese a carico del fornitore.

Le penali sono cumulabili e verranno applicate direttamente trattenendo le somme dai pagamenti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del fornitore. Ove i crediti non bastassero, si provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera d'invito si rimanda a quanto previsto nell'allegato capitolato tecnico che qui si intende ripetuto e trascritto, così come accettato ed approvato

Ad avvenuto collaudo e formazione del personale la società aggiudicataria potrà emettere fattura al codice univoco TIDFDX - la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art.120 comma 12 del D.lgs 36/2023, l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito.

In caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'A.S.P. richiederà nota di credito all'operatore economico fornitore con interruzione dei termini di pagamento.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare senza che codesta ditta abbia nulla a che pretendere.

per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente esclusivamente il foro di Agrigento.

Il Direttore F.F. U.O.C Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Rosalia Calà









### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- 1) Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 26 MAR 2026

Agrigento, li

26 MAR 2026

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*Sabrina Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi